



	Embalagem com 1g. Libera flúor, Apresenta menor viscosidade, Ambos possuem pontas aplicadoras superfina em ângulo que facilitam o controle a extrusão. Bio compatível: A baixa solubilidade do Conseal f à água minimiza a quebra do selante no meio oral. Altamente Resistente: é composto por 7% de substância submicrons com tamanho de 0.04 micron para suportar o desgaste da superfície; Fotopolimerizável.			128,24	
270	Cunha Anatômica de Madeira, Embalagem com 100 unidades. Sortida. As cunhas são feitas de madeira sicômoro, livre de farpas; Estão disponíveis em 5 modelos diferentes codificados por cores; Cunhas anatômicas com excelente acabamento e que não soltam farpas. Menos agressão a gengiva maior facilidade no procedimento e conforto para o paciente; Otimização formato anatômico ideal com lado côncavo para adaptar-se à morfologia interdental. Cores: Turquesa, laranja, branca, verde e amarela. Validade 2 anos.	EMBALAGEM	60	R\$ 59,97	R\$ 3.598,20
271	Resina Microhíbrida Cor B2, Composição: BisGMA, TEGDMA, Bisfenol A polietileno glicol diéter dimetacrilato, UDMA, Cerâmica silanizada tratada e sílica tratada de silano; Resina microhíbrida com nanopartículas; Validade: 3 anos, Seringa com 4g.	UND	50	R\$ 25,65	R\$ 1.282,50
272	Escudo Facial Standard Transparente, Embalagem com 1 unidade. Proteção até as orelhas; É fechado na cabeça, protegendo contra aerossóis contaminados suspensos; Ergonômico para uso contínuo sem provocar dores de cabeça; Área de contato lisa e de fácil assepsia; Reutilizável- Visor resistente, protegido e cristal de 0,50mm; Mantém ser fixo a cabeça sem soltar-se, com tira de ajuste passível de assepsia e para diferentes tamanhos de cabeça; Dimensões: 31x20x24.	UND	35	R\$ 25,65	R\$ 897,75
273	Pedra para Afiar Arkansas, Embalagem com 1 unidade. Dimensões: 10 cm x 2.5 cm x .6 cm. Lubrificar a pedra com óleo. Qualidade, durabilidade e eficiência na realização de procedimentos odontológicos; Pedra natural, ao ser extraída pode sair com varias tonalidades.	UND	24	R\$ 765,22	R\$ 18.365,28
274	Filme Radiográfico, Caixa com 150 unidades. Tamanho 3x4. Compatível com todos os aparelhos de raios-X do mercado, pode ser processado com qualquer químico padrão (revelador e fixador), de maneira manual ou automática. Plástico extra macio,	CX	80	R\$ 608,73	R\$ 48.698,40



	resistente à saliva e desinfectável; Velocidade E; Cor azul; Validade: 2 anos após sua fabricação.				
275	Fita Para Autoclave; A Fita Autoclave é composta de papel crepado branco; Fácil manuseio; Tinta termoreativa e adesivo á base de borracha natural e resina acrílica; Dimensões 19mmX30m; Validade: 5 anos.	UND	250	R\$ 10,15	R\$ 2.537,50
276	Lâmina de Bisturi de Aço Carbono Estéril 15; Embalagem com 100 unidades. Lâmina de bisturi descartável de aço carbono. Validade: 5 anos após a data de fabricação.	PCT	15	R\$ 83,69	R\$ 1.255,35
277	Lamina de bisturi nº 12. Embalagem com 100 unidades. Lâmina de bisturi descartável de aço carbono. Validade: 5 anos após a data de fabricação.	PCT	10	R\$ 83,69	R\$ 836,90
278	Bobina Papel Grau Cirúrgico 150mm x 100 metros: Bobinas lisas, produzidas em papel grau cirúrgico e filme laminado (Poliéster/Polipropileno). Indicado para esterilização em autoclave a vapor ou óxido de etileno; Permeável ao vapor e ao ar, impermeável a microorganismo, resistentes ao calor, livres de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos. A alta transparência do filme azul permite a visualização do material embalado; Possui selagem tripla Multilínea que proporciona maior segurança ao material esterilizado; Dotado de indicadores químicos que mudam de cor após o processo de esterilização; Possui indicador de sentido correto de abertura na embalagem; Toda a impressão do envelope situa-se na área externa de esterilização evitando assim a migração de tinta ao conteúdo a ser esterilizado; Apresentação em bobinas com 100 metros de comprimento.	UND	100	R\$ 163,13	R\$ 16.313,00
279	Bobina Papel Grau Cirúrgico 200mm x 100 metros: Bobinas lisas, produzidas em papel grau cirúrgico e filme laminado (Poliéster/Polipropileno); Indicado para esterilização em autoclave a vapor ou óxido de etileno; Permeável ao vapor e ao ar, impermeável a microorganismo, resistentes ao calor, livres de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos; A alta transparência do filme azul permite a visualização do material embalado; Possui selagem tripla Multilínea que proporciona maior segurança ao material esterilizado; Dotado de indicadores químicos que mudam de cor após o processo de esterilização; Possui indicador de sentido correto de abertura na	UND	180	R\$ 244,98	R\$ 44.096,40



	embalagem; Toda a impressão do envelope situa-se na área externa de esterilização evitando assim a migração de tinta ao conteúdo a ser esterilizado; Apresentação em bobinas com 100 metros de comprimento.				
280	Bobina Papel Grau Cirúrgico 300mm x 100 metros: Bobinas lisas, produzidas em papel grau cirúrgico e filme laminado (Poliéster/Polipropileno); Indicado para esterilização em autoclave a vapor ou óxido de etileno; Permeável ao vapor e ao ar, impermeável a microorganismo, resistentes ao calor, livres de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos; A alta transparência do filme azul permite a visualização do material embalado; Possui selagem tripla Multilínea que proporciona maior segurança ao material esterilizado; Dotado de indicadores químicos que mudam de cor após o processo de esterilização; Possui indicador de sentido correto de abertura na embalagem; Toda a impressão do envelope situa-se na área externa de esterilização evitando assim a migração de tinta ao conteúdo a ser esterilizado; Apresentação em bobinas com 100 metros de comprimento.	UND	100	R\$ 356,42	R\$ 35.642,00
281	Bobina Papel Grau Cirúrgico 100mm x 100 metros: Bobinas lisas, produzidas em papel grau cirúrgico e filme laminado (Poliéster/Polipropileno); Indicado para esterilização em autoclave a vapor ou óxido de etileno; Permeável ao vapor e ao ar, impermeável a microorganismo, resistentes ao calor, livres de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos; A alta transparência do filme azul permite a visualização do material embalado; Possui selagem tripla Multilínea que proporciona maior segurança ao material esterilizado; Dotado de indicadores químicos que mudam de cor após o processo de esterilização; Possui indicador de sentido correto de abertura na embalagem; Toda a impressão do envelope situa-se na área externa de esterilização evitando assim a migração de tinta ao conteúdo a ser esterilizado; Apresentação em bobinas com 100 metros de comprimento.	UND	100	R\$ 133,00	R\$ 13.300,00
					R\$ 13.141.156,89



ANEXO II



MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS - ELETRÔNICA

Conforme sistema da Bolsa Brasileira de Mercadorias no sítio eletrônico www.bbmnetlicitacoes.com.br (Bolsa Brasileira de Mercadorias - BBMNET)

Local de Data

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
BOA VIAGEM/CE

Prezados Senhores,

Apresentamos a Vossas Senhorias nossa proposta de preços, conforme planilha abaixo, referente ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2022.03.03.001, cujo objeto é a Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de equipamentos e materiais médico hospitalares, odontológicos, leites e suplementos alimentares para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Boa Viagem/CE, conforme especificações em anexo, parte integrante deste processo.

Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento do objeto desta licitação, que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	MARCA	QTD	UNIT	TOTAL
1	Abaixador de língua - Abaixador de língua (espátula de madeira) descartável, formato convencional liso, superfície e bordas perfeitamente acabadas, espessura e largura uniforme em toda a sua extensão, medindo aproximadamente 14 cm de comprimento, 1,4 cm de largura, 0,5 mm de espessura.	UND		24000	R\$ -	R\$ -
2	Ácido acético 2% glacial 1000ml - Usado na prevenção do câncer ginecológico - detecção de lesões precursoras.	UND		500	R\$ -	R\$ -
3	Água destilada 10ml injetável - Estéril e apirogênica, seu uso objetiva a diluição e solubilização de medicamentos injetáveis.	UND		2400	R\$ -	R\$ -
4	Água oxigenada 10 vol. 1000ml - Antisséptico tópico, utilizado para assepsia de ferimentos e em gargarejos ou bochechos. Cada 10 ml contém: - peróxido de hidrogênio = 3,0g; - veículo qsp = 1000ml.	UND		300	R\$ -	R\$ -
5	Agulha descartável 20x5,5 - A agulha hipodérmica descartável foi desenvolvida para aplicação de soluções em diferentes vias injetáveis de administração: endovenosa, intramuscular, subcutânea e intradérmica Possui canhão identificado por código de cores de acordo com a ISO, que permite o acoplamento nas seringas de bico luer slip e	UND		12000	R\$ -	R\$ -

PREFEITURA DE BOA VIAGEM

CNPJ Nº 07.963.515/0001-36 | CGF Nº 06.920.307-5

Praça Monsenhor José Cândido, 100 | Centro | Boa Viagem/CE | CEP 63.870-000

Tel.: 88 3427-7001 | E-mail: pmbv_oficial@boaviagem.ce.gov.br | Site: www.boaviagem.ce.gov.br



	luer lock. Cânula com bisel tri facetado em aço inoxidável, siliconada, permitindo um deslize suave e perfeito.cx/ com 100und.				
6	Agulha descartável 25x7 - A agulha hipodérmica descartável foi desenvolvida para aplicação de soluções em diferentes vias injetáveis de administração: endovenosa, intramuscular, subcutânea e intradérmica.Possui canhão identificado por código de cores de acordo com a que permite o acoplamento nas seringas de bico luer slip e luer lock. Cânula com bisel tri facetado em aço inoxidável, siliconada, permitindo um deslize suave e perfeito.cx/ com 100und.	UND	12000	R\$ -	R\$ -
7	Agulha descartável 25x8 - A agulha hipodérmica descartável foi desenvolvida para aplicação de soluções em diferentes vias injetáveis de administração: endovenosa, intramuscular, subcutânea e intradérmica.Possui canhão identificado por código de cores de acordo com a que permite o acoplamento nas seringas de bico luer slip e luer lock. Cânula com bisel tri facetado em aço inoxidável, siliconada, permitindo um deslize suave e perfeito.cx/ com 100und.	UND	12000	R\$ -	R\$ -
8	Agulha descartável 40x12 - A agulha hipodérmica descartável foi desenvolvida para aplicação de soluções em diferentes vias injetáveis de administração: endovenosa, intramuscular, subcutânea e intradérmica.Possui canhão identificado por código de cores de acordo com a que permite o acoplamento nas seringas de bico luer slip e luer lock. Cânula com bisel tri facetado em aço inoxidável, siliconada, permitindo um deslize suave e perfeito.cx/ com 100und.	UND	12000	R\$ -	R\$ -
9	Agulha descartável p/ insulina 13x4,5 - Agulha hipodérmica descartável 22g 1 1/2 - 13x0,45mm Desenvolvidas para aplicação de soluções e medicamentos em diferentes vias de administração: endovenosa, intramuscular, intradérmica e subcutânea. Estéril; fabricada em aço inoxidável; possui canhão identificado por código de cores universal.	UND	24000	R\$ -	R\$ -
10	Agulha p/ insulina com caneta curta comprimento 8mm (5/16") Calibre 0,25mm(31g) - Agulha para caneta de aplicação de insulina, Caixa com 100 unidades, Agulha 8mm (5/16") x 0,25mm(31g) Compatível com todas as agulhas Lacre e protetores externos e internos da agulha garantem a esterilidade,Rosca no cone externo, proporciona adaptação e fixação	UND	12000	R\$ -	R\$ -



	segura na caneta com maior capacidade de penetração, Agulha integralmente siliconizada, deslizamento suave e contínuo, reduz a dor e o desconforto.					
11	Álcool 70% 1000ml - O álcool líquido 70° de uso geral elaborado especialmente para limpar superfícies fixas em geral, como fórmica, plástico, vidro, metais e etc. Atrelado ao seu poder de limpeza, seu poder higienizante e saneante são os diferenciais na eficácia do combate às bactérias e vírus do dia-dia. Embalagem: frasco com 1000 ml.	UND		15600	R\$ -	R\$ -
12	Álcool absoluto 99,5% 1000ml - Produto para uso profissional, destinado à assistência à saúde, usado em testes laboratoriais e limpeza de superfícies. Álcool absoluto 99,5° INPM embalagem: 1000l	UND		1200	R\$ -	R\$ -
13	Álcool gel 1 litro - Feito com álcool etílico hidratado a 70, Álcool etílico hidratado 70° INPM higienizante, Antisséptica limpeza uso geral multiuso.	UND		5600	R\$ -	R\$ -
14	Algodão hidrófilo 500g - O algodão hidrófilo indicado para uso hospitalar, na higienização da pele, em curativos, na absorção de líquidos, limpeza de bebês, assepsia, e em procedimentos médicos e dentários.	UND		1700	R\$ -	R\$ -
15	Atadura de crepom 10x4 cm - Modelo: 13 fios por centímetro quadrado (alta elasticidade), larguras: 10 cm (vide título do anúncio) comprimento: 1,80 metros (padrão ABNT) composição de 90 por cento algodão / 9 por cento poliéster / 1 por cento elastano	UND		21200	R\$ -	R\$ -
16	Atadura de crepom 15cm - Atadura de crepom 15cm x 1,8m 13 fios, Utilização em terapia compressiva. Aplicações ortopédicas como imobilizações e enfaixamentos. Fixação de curativos. Prevenção de contusões em atividades esportivas.	UND		21200	R\$ -	R\$ -
17	Atadura de crepom 20x3 cm - Atadura de crepom 20cm x 1,8m 13 fios Utilização em terapia compressiva. Aplicações ortopédicas como imobilizações e enfaixamento. Fixação de curativos. Prevenção de contusões em atividades esportivas	UND		21200	R\$ -	R\$ -
18	Aspirador Cirúrgico - O Aspirador Cirúrgico é um aparelho eletromecânico que possui como elemento principal uma bomba de vácuo com acionamento elétrico, acoplada a dispositivos mecânicos, que em funcionamento permite gerar uma pressão negativa proporcionando a formação de vácuo no interior de um recipiente, conectado a um tubo de sucção e a entrada da bomba de vácuo.	UND		100	R\$ -	R\$ -
19	Avental TNTPT c/10 - 100% polipropileno,	UND		20000	R\$ -	R\$ -



	Atóxico, Não estéril, Hipoalérgico, Uso individual e descartável, Uso individual e descartável, TNT semipermeável não é de uso cirúrgico. Tem elástico nos punhos, duas fitas p amarrar atrás, Indicado para área da estética, serviços de saúde, indústria alimentícia, refeitórios e serviços em geral que necessitem de proteção de contato.					
20	Bolsa coletora sistema aberto - Coletor de urina sistema aberto não estéril 2000ml c/100 und. Utilizado para o sistema de coleta de urina de pacientes com incontinência urinaria. Uso adulto	UND		30000	R\$ -	R\$ -
21	Bolsa de colostomia (caixa com 20) - Bolsa de colostomia 4009 com placa integrada, BGDM 003 Caixa com 20 UND com Adesivo micro poroso, Pré-cortada em 19 mm, Recortável de 25 a 70 mm, Com filtro de carvão ativado (diminui odores), Transparente e opaca, Bolsa transparente com forro de perfurado, Bolsa opaca com forro de TNT, Bolsa com placa integrada (sistema de uma peça) Bolsa drenável (sistema aberto), Fechamento por clipe, Acompanha régua de medida de abertura de estoma, Selo com número do lote	CX		450	R\$ -	R\$ -
22	Bolsa Colostomia e Ileostomia PEDIÁTRICA Peça DRENÁVEL TRANSPARENTE Recorte 10-35mm CX c/100 UND - Bolsa Colostomia e Ileostomia PEDIÁTRICA DRENÁVEL TRANSPARENTE Recorte 10-35mm é indicada para cuidado de estoma em bebês e crianças	CX		350	R\$ -	R\$ -
23	Coletor de urina infantil feminino - Coletor de urina transparente feminino em PEDB indicado para coleta de urina em unidades de saúde. O coletor de urina infantil feminino é confeccionado com abertura no formato elíptico (3,8cm de comprimento x 2,3cm de largura superior x 1,2cm de largura inferior) e possui uma fita adesiva antialérgica garantindo segurança para o usuário. Contém campo para preenchimento de identificação de pacientes. Produto não estéril, atóxico e apirogênico. Possui capacidade de 100ml. O coletor possui tamanho único (17x10cm) e marcações aproximadas com intervalos graduais de 10ml até 100 ml. Atóxico; - adesivo dupla face antialérgico; - capacidade de 100ml; - tamanho único	UND		1500	R\$ -	R\$ -
24	Coletor de urina infantil masculino - Coletor infantil masculino com furo redondo, com fita adesiva dupla face, hipoalérgica, resistente e que não desprende do conjunto, Ação/ativos: composto por saco com comprimento de 17 cm	UND		1000	R\$ -	R\$ -



	e largura de 10 cm, com um furo pré-cortado e com película protetora não aderente e destacável. A parte adesiva não se desprende do coletor e não deixa resíduo na pele do usuário. Confeccionadas em polietileno de baixa densidade, transparente, atóxico e maleável com capacidade para 100ml; com selagem de alta resistência nas bordas assegurando a integridade do saco para que não provoquem lesão ao paciente ou vazamento.				
25	Coletor de urina sistema fechado - Sistema fechado com válvula anti refluxo. Com capacidade para 2000ml e graduada a cada 100ml. Com capacidade para 2000ml e graduada a cada 100ml. Tamanho: altura 29,5 cm e largura 22cm, possui suporte de fixação com haste rígida e com alça cordão. Pinça contra fluxo do tipo clamp. Tubo extensor em PVC de 120cm, transparente, atóxico, flexível e sem efeito memória, conector universal com ajuste para sondas vesicais, com tampa protetora. Esterilizado por óxido de etileno. Produto látex-free	UND	2000	R\$ -	R\$ -
26	Copo p/ escarro - Coletor de universal 80ml com tampa - estéril. finalidade: indicados para coleta de amostras de fezes, urina, escarro e esperma. Sem pá individual.	UND	4000	R\$ -	R\$ -
27	Cuba cirúrgica - Indicado para assepsia. Características: cuba para assepsia em aço inoxidável; dimensões: 9x5cm; capacidade: 200 ml; material: aço inoxidável.	UND	50	R\$ -	R\$ -
28	Cuba rim - Indicações utilizadas para acondicionamento de medicação, resíduos, soro, álcool iodado, etc. Características: composição do aço: aço-inox 304 (18/8); composição do aço: aço-inox 304 (18/8); cuba rim medindo: 26 x 12 cm - capacidade 740ml.	UND	50	R\$ -	R\$ -
29	Eletrodos - Indicado para eletrocardiograma e monitorização cardíaca em UTIS, procedimentos cirúrgicos, serviços de emergência e testes ergométricos; Procedimentos em hospitais, consultórios, clínicas e laboratórios.	UND	50	R\$ -	R\$ -
30	Equipo macro gotas com rig. P/ soro - Desenvolvido para administração de medicamentos e soluções pela via endovenosa em hospitais e clínicas. Possui a finalidade de entremear a ligação do dispositivo venosos periférico (ligado ao paciente) ao recipiente que contém líquido a ser infundido (que pode ter ou não medicação), fabricado em PVC flexível e	UND	2000	R\$ -	R\$ -



	incolor; provido de pinça rolete, injetor lateral com membrana auto cicatrizante, câmara gotejadora com dispositivo para entrada de ar com filtro hidrófobo e bacteriológico e filtro de partículas de 15µm; conector luer slip universal; tubo com 1,5m com ponta perfurante e tampa protetora; atóxico e apirogênico; descartável e de uso único; estéril.					
31	EQUIPO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL - O Equipamento para nutrição enteral possui ponta perfurante e conector escalonado com conexões universais. Regulador de fluxo, tipo pinça rolete, com excelente precisão no controle do gotejamento e tubo flexível atóxico na cor azul (específico para nutrição enteral).	UND	10000	R\$ -	R\$ -	
32	Escova cervical descartável - Escova descartável cervical não estéril - pacote com 100 unidades, ideal para coleta de material endocervical, sem traumatismos e falsos trajetos, cabo em poliestireno com eixo sustentável em aço inoxidável, altamente resistente à trações, formato cônico com microcerdas macias, em nylon.	UND	20000	R\$ -	R\$ -	
33	Esfigmomanômetro c/ estetoscópio adulto - Aparelho de pressão esfigmomanômetro com estetoscópio simples para a medição da pressão arterial, braçadeira com manguito em PVC; recomendado para uso doméstico e hospitalar; acompanha estojo para viagem, verificado e aprovado pelo Imetro; - acompanha braçadeira com fecho em velcro.	UND	500	R\$ -	R\$ -	
34	Esfigmomanômetro c/ estetoscópio adulto grande para obeso - Esfigmomanômetro aneróide adulto obeso. O esfigmomanômetro é um equipamento de alta precisão, indicado para a medição da pressão arterial sanguínea. É um aparelho de extrema qualidade e fácil de usar, indispensável no dia-a-dia daquelas pessoas que se preocupam em cuidar da saúde. A pressão arterial é registrada em duas medidas: a mais alta chama-se sistólica (medida quando o coração está bombeando), a mais baixa chama-se diastólica (medida quando o coração está relaxado). Alguns fatores podem causar uma elevação na pressão arterial, como por exemplo, ansiedade, nervosismo, etc. Para prever alguns riscos, deve-se monitorar constantemente os níveis de pressão arterial, pois, deste modo, será possível diagnosticar o mais cedo a hipertensão arterial, que poderá oferecer, sérios riscos à saúde como derrames e ataques cardíacos prematuros. Para a medição da pressão arterial, manômetro de alta precisão com tecnologia japonesa, braçadeira	UND	70	R\$ -	R\$ -	



	com manguito em PVC (circunferência de 35 até 51 cm, braçadeira grande em nylon com fecho de velcro na cor azul marinho, recomendado para uso doméstico hospitalar. Conteúdo da embalagem: 01 manômetro 0 - 300 mmhg, 01 braçadeira, 01 válvula de deflação, 01 Pêra, 01 estojo para viagem, 01 esteto.					
35	Esfigmomanômetro c/ estetoscópio infantil - Esfigmomanômetro para criança infantil com estetoscópio esfigmomanômetro infantil com estetoscópio braçadeira 10 x 18 centímetros. O kit esfigmomanômetro infantil com estetoscópio é indicado para a medição e acompanhamento da pressão arterial sanguínea no ambiente hospitalar, clínicas, triagem de pronto atendimentos, consultórios e no uso residencial. São livres de látex e com excelente durabilidade. É ideal para a monitorização da pressão arterial, arritmia cardíaca e para auscultação de sons cardiorrespiratórios. Extremamente importante no controle da hipertensão e outras doenças do coração e pulmão. Indicado para profissionais da saúde, estudantes e para se ter em casa.	UND		70	R\$ -	R\$ -
36	Esparadrão 10 x 4,5 cm - Esparadrão impermeável - branco, esparadrão de tecido 100% algodão com tratamento acrílico, adesivo branco à base de borracha natural e resina de ótima aderência e extra flexível. Linha hospitalar: 10 cm x 4,5 m flexível, largura 10 cm, comprimento 4,5 m.	UND		12100	R\$ -	R\$ -
37	Espátula de Ayres c/100 - Espátula de ayre de madeira, resistentes, pontas arredondadas descartáveis utilizadas para coleta de exames ginecológicos, medindo 18 cm de comprimento, embalagem em pacote contendo 100 unidades.	PCT		2000	R\$ -	R\$ -
38	Espéculo descartável tamanho g - O espéculo g vaginal. Com o parafuso inserido, facilitando a realização do exame	UND		7000	R\$ -	R\$ -
39	Espéculo descartável tamanho m - O espéculo m vaginal. Com o parafuso inserido, facilitando a realização do exame	UND		7000	R\$ -	R\$ -
40	Espéculo descartável tamanho p - O espéculovaginal. Com o parafuso inserido, facilitando a realização do exame	UND		7000	R\$ -	R\$ -
41	Éter sulfúrico 1lt - Éter sulfúrico 50% removedor de curativos, acondicionado em frasco. Especificação: acondicionado em frasco de vidro cor âmbar com tampa de rosca. 1 LT	LT		100	R\$ -	R\$ -
42	Fio CATGUT 2.0 - Material: colágeno derivado de gado bovino. Comprimento do fio: 70 cm / 75 cm / 90 cm (agulhado) ou 1,5 m (sem agulha). Diâmetro do fio/número cirúrgico: 2-0, material	CX		10	R\$ -	R\$ -



	da agulha: aço inox, descrição da agulha: 3/8 circ. Cilíndrica, indicação: cirurgias em geral; - ginecologia/obstetrícia; - aparelho digestivo; - urologia; - cirurgias veterinárias.					
43	Fio CATGUT 3.0 - Material: colágeno derivado de gado bovino. Comprimento do fio: 70 cm / 75 cm / 90 cm (agulhado) ou 1,5 m (sem agulha). Diâmetro do fio/número cirúrgico: 3-0, material da agulha: aço inox, descrição da agulha: 3/8 circ. Cilíndrica, indicação: cirurgias em geral; - ginecologia/obstetrícia; - aparelho digestivo; - urologia; - cirurgias veterinárias.	CX		10	R\$ -	R\$ -
44	FRASCO PARA DIETA ENTERAL (ETEROFIX) - FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL 300ML, Artigo médico-hospitalar de uso único, não estéril e higiênico, indicado para alimentação enteral para pacientes impossibilitados de deglutir o alimento. O material empregado na fabricação dos frascos e tampas é o polietileno (PE). Os frascos possuem graduação de 10 em 10 ml, facilitando na utilização de pequenos volumes ou de acordo com a necessidade e individualidade do paciente. As tampas possuem membranas perfuráveis, adaptáveis aos equipo de nutrição entera	UND		10000	R\$ -	R\$ -
45	Fita cirúrgica microporosa 5 cm x 10 - Fita micro porosa da hipalérgica, composta de não tecido a base de fibras de viscosse com adesivo acrílico. Isento de látex.	UND		1200	R\$ -	R\$ -
46	Fita p/ autoclave - Utilizada para fechamento de pacotes de papel e de pano que serão esterilizados em autoclave. É um instrumento indicador de que a esterilização foi efetuada em condições ideais de pressão, temperatura e tempo, através da mudança de coloração das listras de cor amarela para a cor preta. 19mm x 30m.	UND		4000	R\$ -	R\$ -
47	Gaze hidrófila em pacote - Gaze compressa de gaze 13 fios 7,5x7,5cm para curativos, não estéril, pacote c/ 500 unidades, compressa cirúrgica de gaze hidrófila	PCT		12000	R\$ -	R\$ -
48	Gaze hidrófila em rolo - A gaze em rolo, indicada para curativos ou procedimentos operatórios, inclusive no tratamento de queimaduras, devido a sua composição 100% algodão 9 fios. Possui um alto poder de absorção de sangue e outras secreções, procedimentos em geral como higiene, assepsia e curativo além da confecção de gazes vaselinadas ou fracionadas e chumaços de algodão (revestimento). Não estéril. Branqueada e livre de impurezas.	RL		500	R\$ -	R\$ -
49	Gel p/ ultrassom de 5000g - É um gel	UND		100	R\$ -	R\$ -



	especialmente recomendado para uso como meio de contato para transmissão ultra-sônica, em aparelhos de ultrassonografia, ecógrafos e dopplers				
50	Glicerina - Ação hidratante e deslizante; para usos estéticos e em fisioterapia; sensação de conforto em qualquer temperatura.	UND	100	R\$ -	R\$ -
51	Kit p/ aerosol adulto - Micro nebulizador (cabeçote, anteparo e recipiente); 01 máscara adulto, 01 tubo de ar 2,5 MTS; 01 elástico	UND	100	R\$ -	R\$ -
52	Kit p/ aerosol infantil - Micro nebulizador (cabeçote, anteparo e recipiente); 01 máscara adulto, 01 tubo de ar 2,5 MTS; 01 elástico	UND	100	R\$ -	R\$ -
53	Lâmina de prevenção ponta fosca 26x76 - Fabricada em vidro especial, com espessura de 1,0 a 1,2 mm, caixa revestida por embalagem plástica selada a vácuo. Contém seda entre as lâminas.	CX	600	R\$ -	R\$ -
54	Lâmina p/ bisturi nº 11 - As lâminas para bisturi descartáveis são indicadas para cortar tecidos do corpo humano durante procedimentos médicos, clínicos e/ou cirúrgicos e outros procedimentos aplicáveis. Especificações do item nome técnico: lâminas de bisturi descartáveis, composição: aço carbono t10, modelo: aço carbono - número 11, método de esterilização: esterilidade garantida por raios gama.	UND	10000	R\$ -	R\$ -
55	Lâmina p/ bisturi nº 15 - As lâminas para bisturi descartáveis são indicadas para cortar tecidos do corpo humano durante procedimentos médicos, clínicos e/ou cirúrgicos e outros procedimentos aplicáveis. Especificações do item, nome técnico: lâminas de bisturi descartáveis, composição: aço carbono t10, modelo: aço carbono - número 15, método de esterilização: esterilidade garantida por raios gama.	UND	10000	R\$ -	R\$ -
56	Lâmina p/ bisturi nº 22 - As lâminas para bisturi descartáveis são indicadas para cortar tecidos do corpo humano durante procedimentos médicos, clínicos e/ou cirúrgicos e outros procedimentos aplicáveis. Especificações do item: nome técnico: lâminas de bisturi descartáveis, composição: aço carbono t10, modelo: aço carbono - número 22, método de esterilização: esterilidade garantida por raios gama.	UND	10000	R\$ -	R\$ -
57	Lâmina para microscópio - Kit 100 lâminas + 100 lamínulas 24 x 24mm para microscopia, As lâminas são ideais para processos de microscopia, Características: lapidada, ponta fosca, embaladas a vácuo, intercaladas com papel lenço com tratamento antifúngico.	CX	150	R\$ -	R\$ -




58	Luva cirúrgica estéril 7.0 - Luva cirúrgica estéril com pó 7.0, desenvolvida para proteção do profissional da saúde em geral durante procedimentos cirúrgicos em geral e procedimento invasivos. Fabricada em látex, estéril, atóxica e apirogênica, com pó bioabsorvível, formato anatômico, antiderrapante, aprovada pelo inmetro, aprovada pelo ministério do trabalho (C.A), descartável e de uso único, pares embalados individualmente.	UND	2000	R\$ -	R\$ -
59	Luva cirúrgica estéril 7.5 - Luva cirúrgica estéril com pó 7.0, desenvolvida para proteção do profissional da saúde em geral durante procedimentos cirúrgicos em geral e procedimento invasivos. Fabricada em látex, estéril, atóxica e apirogênica com pó bioabsorvível, formato anatômico, antiderrapante, aprovada pelo inmetro, aprovada pelo ministério do trabalho (C.A), descartável e de uso único, pares embalados individualmente.	UND	2000	R\$ -	R\$ -
60	Luva cirúrgica estéril 8.0 - Luva cirúrgica estéril com pó 8.0, desenvolvida para proteção do profissional da saúde em geral durante procedimentos cirúrgicos em geral e procedimento invasivos. Fabricada em látex, estéril, atóxica e apirogênica, com pó bioabsorvível, formato anatômico, antiderrapante, aprovada pelo inmetro, aprovada pelo ministério do trabalho (C.A), descartável e de uso único, pares embalados individualmente.	UND	2000	R\$ -	R\$ -
61	LUVA DE PROCEDIMENTO P C/ 100 UND - Com pó bioabsorvível, superfície lisa, ambidestra, não estéril. Tamanhos pequeno, CX com 100 UND	CX	2000	R\$ -	R\$ -
62	LUVA DE PROCED. XP C/ 100 UND - Com pó bioabsorvível, superfície lisa, ambidestra, não estéril, Tamanhos XP, CX com 100 UND	CX	2000	R\$ -	R\$ -
63	LUVA P/ PROCED. G C/ 100 UND - Com pó bioabsorvível, superfície lisa, ambidestra, não estéril, Tamanhos G, CX com 100 UND	CX	2000	R\$ -	R\$ -
64	LUVA P/ PROCED. M C/ 100 UND - Com pó bioabsorvível, superfície lisa, ambidestra, não estéril, Tamanhos M, CX com 100 UND	CX	2000	R\$ -	R\$ -
65	Máscara descartável C/ 50 UND - Máscara tipo cirúrgica possui clipe nasal para ajuste e segurança, hipoalergênico, antisséptico, isenta de fibra de vidro, sem látex, uso único e descartável, - atóxica e não estéril, especificações: 17,5cm x 9,5cm, pode ser usada em hospitais, laboratórios, clínicas, consultórios dentários e médicos, Indústrias	CX	14150	R\$ -	R\$ -



	químicas, farmacêuticas e alimentícias, área estética e gastronômica.				
66	Máscara n95 (bico de pato) - Máscaras kn95, 5 camadas, n95, pff2, bico de pato.	UND	12200	R\$ -	R\$ -
67	Nylon nº 2.0 c/ agulha 3cm cortante - Fio nylon 2-0 com agulha 3/8 3cm TRG 45cm	CX	120	R\$ -	R\$ -
68	Nylon nº 3.0 c/ agulha 3cm cortante - Fio nylon 3-0 com agulha 3/8 3cm TRG 45cm	CX	120	R\$ -	R\$ -
69	Nylon nº 4.0 c/ agulha 3cm cortante - Fio nylon 4-0 com agulha 3/8 3cm TRG 45cm	CX	120	R\$ -	R\$ -
70	Nylon nº 5.0 c/ agulha 3cm cortante - Fio nylon 5-0 com agulha 3/8 3cm TRG 45cm	CX	120	R\$ -	R\$ -
71	Nylon nº 6.0 c/ agulha 3cm cortante - Fio nylon 6-0 com agulha 3/8 3cm TRG 45cm	CX	120	R\$ -	R\$ -
72	Otoscópio - Otoscópio para diagnósticos médicos, indicado para avaliar tanto a parte interna quanto a parte externa do ouvido. Iluminação branca e de alto brilho, com excelente nitidez da imagem. Conexão para pera de insuflação, possibilita avaliar a mobilidade da membrana timpânica (pera opcional). Espéculos disponíveis em diversos tamanhos e modelos. Fácil substituição da lâmpada ou LED, cabo em metal recartilhado para melhor ergonomia e segurança durante o exame, reostato para controle de intensidade da luz, alimentação através de 2 pilhas alcalinas tipo C. Não contém látex.	UND	100	R\$ -	R\$ -
73	Óculos de proteção - Óculos de proteção EPI confeccionados em policarbonato óptico, com armação em polipropileno e hastes com 4 posições de regulação para melhor ajuste.	UND	2000	R\$ -	R\$ -
74	Papel crepado 30x30 c/100 - Produto não estéril, primeira geração, compatível e resistente às condições físicas de esterilização. Permite penetração e remoção do agente esterilizante. Não gera partículas, seguro e atóxico, repelência a líquidos. Caixa c/500 UNDS.	CX	500	R\$ -	R\$ -
75	Pinça anatômica para curativo - Pinça anatômica dissecação 16cm, Utilizada para prender e afastar o tecido. Também usada em dissecação, produzido em aço inoxidável. Possui ponta serrilhada.	UND	100	R\$ -	R\$ -
76	Pinça cheron descartável - Auxiliar nos exames ginecológicos (colposcopia), biópsias e coleta de material para o exame preventivo do câncer de colo de útero), exames em cavidades estreitas como o endocérvice e retirada de pólipos.	UND	25000	R\$ -	R\$ -
77	Pinça dente de rato - Pinça anatômica dente de rato 16cm, Pinça com função de promover a fixação dos tecidos durante a divisão e/ou sutura. Os dentes evitam que a pele escape da pinça.	UND	50	R\$ -	R\$ -



78	Pinça kelly - Pinça kelly reta 14cm é usada para pinçamento (hemostasia). - Produto confeccionado em aço inoxidável aisi-420; - ponta reta, com serrilha.	UND	50	R\$ -	R\$ -
79	Pinça maynihan - Pinça moynihan 20cm para hysterectomia.	UND	50	R\$ -	R\$ -
80	Pinça pean de aço (usada para sonda vesical de demora) - A pinça pean é fabricada em aço inoxidável. Utilizada em procedimentos cirúrgicos para travar vasos sanguíneos. Ainda tem função de prender gazes para a realização de antissepsia.	UND	50	R\$ -	R\$ -
81	Preservativo masculino sem lubrificante - Preservativo masculino não lubrificado destina-se a recobrir as sondas de aparelhos de ultrassonografia transvaginal. Esse procedimento reduz a propagação de doenças infecciosas entre as pacientes que fazem seu uso. Proteção total para procedimentos médicos.	UND	3000	R\$ -	R\$ -
82	Preservativo masculino com lubrificante - Indicado como método contraceptivo.	UND	30000	R\$ -	R\$ -
83	PVPI degermante 1000ml - PVPI degermante odopolividona degermante solução a 10%, é um antisséptico indicado para antissepsia da pele, mãos e antebraços.	UND	100	R\$ -	R\$ -
84	PVPI tópico 10% 1000ml - PVPI solução com tensoativos ou degermante é um antisséptico à base de PVPI solução com tensoativos ou degermante é um antisséptico à base de antissepsia das mãos e antebraços da equipe cirúrgica e descontaminação do campo operatório.	UND	2000	R\$ -	R\$ -
85	Propes p.c. C/100 - As sapatilhas propé descartáveis são fabricadas em 100% polipropileno atóxico, no tipo soldado, com acabamento em elástico na borda superior que permite melhor fixação no pé do usuário. Possui a finalidade de cobrir e envolver o calçado em ambientes hospitalares, ambulatoriais e clínicas médicas, evitando o desprendimento de partículas de sujeira em áreas especiais e restritas que tenham a necessidade de total controle sobre a higienização, visando a prevenção de infecção hospitalar durante os procedimentos cirúrgicos diversos. A caixa acompanha 100 unidades, com a gramatura 20, sendo descartável, de uso único e individual.	PCT	1000	R\$ -	R\$ -
86	Protetor facial - O protetor facial é um equipamento de proteção individual, ajustável e reutilizável. Evita o contato com gotículas, salive e fluidos nasais que possam atingir o rosto, o nariz, a boca e os olhos prevenindo o contágio e outras contaminações. Oferece	UND	300	R\$ -	R\$ -



	proteção e conforto aliados a um design moderno facilitando a conversação e entendimento de forma clara, sem causar ruídos no som da voz.					
87	Sabão líquido neutro 1000ml - Produto ideal para limpeza da pele.Retira sujeiras e outros resíduos. Com sua fórmula balanceada, possui PH neutro e componentes suaves que não irritam a pele, podendo ser utilizado também por profissionais da saúde.	UND		500	R\$ -	R\$ -
88	Saco coletor sistema aberto - Produto destinado ao controle de fluxo de drenagem, quando se requer um controle aproximado na diurese do paciente. Não estéril.	UND		30000	R\$ -	R\$ -
89	Scalp nº 19 - Scalp número 19 caixa com 100und. Descrição: estéril,fabricado em aço inoxidável e PVC,tubo translúcido com 30 cm. De comprimento possui asas que auxiliam a venipuntura coloridas que identificam os calibres atóxico e apirogênico, Descartável e de uso único.	UND		1200	R\$ -	R\$ -
90	Scalp nº 21 - Scalp número 21 caixa com 100und. Descrição: estéril,fabricado em aço inoxidável e PVC,tubo translúcido com 30 cm. De comprimento possui asas que auxiliam a venipuntura coloridas que identificam os calibres, atóxico e apirogênico, Descartável e de uso único.	UND		5000	R\$ -	R\$ -
91	Scalp nº 23 - Scalp número 23 caixa com 100und. Descrição: estéril,fabricado em aço inoxidável e PVC,tubo TRANslúcido com 30 cm. De comprimento possui asas que auxiliam a venipuntura coloridas que identificam os calibres, atóxico e apirogênico,Descartável e de uso único.	UND		5000	R\$ -	R\$ -
92	Scalp nº 25 - Scalp número 25 caixa com 100und. Descrição: estéril,fabricado em aço inoxidável e PVC,tubo TRANslúcido com 30 cm. De comprimento possui asas que auxiliam a venipuntura coloridas que identificam os calibres, atóxico e apirogênico,Descartável e de uso único.	UND		5000	R\$ -	R\$ -
93	Scalp nº 27 - Scalp número 25 caixa com 100und.Descrição: estéril,fabricado em aço inoxidável e PVC,tubo TRANslúcido com 30 cm. De comprimento possui asas que auxiliam a venipuntura coloridas que identificam os calibres, atóxico e apirogênico, Descartável e de uso único.	UND		5000	R\$ -	R\$ -
94	Seringa descartável 01 ml insulina c/ medidor - Seringa de insulina 1 ml com agulha 8 x 0,30mm. A seringa de insulina 1 ml foi desenvolvida para aplicação de insulina em	UND		10000	R\$ -	R\$ -




	pacientes portadores de diabetes pela via subcutânea em clínicas, hospitais, laboratórios, farmácias e domicílios.				
95	Seringa descartável - 03 ml c/ agulha - Seringa descartável 03 ml com agulha 25 x 7 bicos slip. Detalhes do produto: seringa de uso único, corpo lubrificado, com escala externa precisa e visível. Possui formato anatômico para apoio dos dedos, vem com anel de retenção de borracha que evita a entrada de ar. Para segurança é embalada individualmente, a selagem garante a integridade e a esterilização do produto. A seringa é destinada a infusão e coleta de líquidos em procedimentos médico-hospitalares e injeção de líquidos.	UND	20000	R\$ -	R\$ -
96	Seringa descartável - 05 ml sem agulha - Utilizada para inserir substâncias líquidas por via intravenosa, intramuscular, intra-cardíaca, subcutânea, intradérmica, intra-articular; retirar sangue; ou ainda, realizar uma punção aspirativa em um paciente.	UND	20000	R\$ -	R\$ -
97	Seringa descartável - 10 ml sem agulha - Utilizada para inserir substâncias líquidas por via intravenosa, intramuscular, intra-cardíaca, subcutânea, intradérmica, intra-articular; retirar sangue; ou ainda, realizar uma punção aspirativa em um paciente.	UND	20000	R\$ -	R\$ -
98	Seringa descartável - 20 ml sem agulha - Utilizada para inserir substâncias líquidas por via intravenosa, intramuscular, intra-cardíaca, subcutânea, intradérmica, intra-articular; retirar sangue; ou ainda, realizar uma punção aspirativa em um paciente.	UND	20000	R\$ -	R\$ -
99	Solução de lugol 2,0 % 1000ml - Solução para teste colposcópico para pesquisa de células displásicas ou carcinomatosas de colo uterino, servindo como diagnóstico de neoplasias uterinas.	UND	600	R\$ -	R\$ -
100	Sonda de aspiração traqueal nº 10 - Indicado aos pacientes impossibilitados de eliminar as secreções do pulmão	UND	24000	R\$ -	R\$ -
101	Sonda de aspiração traqueal nº 12 - Indicado aos pacientes impossibilitados de eliminar as secreções do pulmão	UND	24000	R\$ -	R\$ -
102	Sonda de aspiração traqueal nº 04 - Indicado	UND	12000	R\$ -	R\$ -



COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 617
@


	aos pacientes impossibilitados de eliminar as secreções do pulmão					
103	Sonda de aspiração traqueal nº 06 - Indicado aos pacientes impossibilitados de eliminar as secreções do pulmão	UND		12000	R\$ -	R\$ -
104	Sonda de aspiração traqueal nº 08 - Indicado aos pacientes impossibilitados de eliminar as secreções do pulmão	UND		12000	R\$ -	R\$ -
105	Sonda de aspiração traqueal nº 06 - Indicado aos pacientes impossibilitados de eliminar as secreções do pulmão	UND		12000	R\$ -	R\$ -
106	Sonda de aspiração traqueal nº 16 - Indicado aos pacientes impossibilitados de eliminar as secreções do pulmão	UND		12000	R\$ -	R\$ -
107	Sonda de aspiração traqueal nº 18 - Indicado aos pacientes impossibilitados de eliminar as secreções do pulmão	UND		12000	R\$ -	R\$ -
108	Sonda de aspiração traqueal nº 22 - Indicado aos pacientes impossibilitados de eliminar as secreções do pulmão	UND		12000	R\$ -	R\$ -
109	Sonda de aspiração traqueal nº 20 - Indicado aos pacientes impossibilitados de eliminar as secreções do pulmão	UND		12000	R\$ -	R\$ -
110	Sonda de aspiração traqueal nº 24 - Indicado aos pacientes impossibilitados de eliminar as secreções do pulmão	UND		12000	R\$ -	R\$ -
111	Sonda de foley nº 10 de 02 vias c/10 - A sonda foley é utilizada para procedimentos de drenagem no canal da uretra, permitindo o esvaziamento da urina que está na bexiga.	CX		150	R\$ -	R\$ -
112	Sonda de foley nº 12 de 02 vias c/10 - A sonda foley é utilizada para procedimentos de drenagem no canal da uretra, permitindo o esvaziamento da urina que está na bexiga.	CX		150	R\$ -	R\$ -
113	Sonda de foley nº 14 de 02 vias c/10 - A sonda foley é utilizada para procedimentos de drenagem no canal da uretra, permitindo o esvaziamento da urina que está na bexiga.	CX		150	R\$ -	R\$ -
114	Sonda de foley nº 16 de 02 vias c/10 - A sonda foley é utilizada para procedimentos de drenagem no canal da uretra, permitindo o esvaziamento da urina que está na bexiga.	CX		150	R\$ -	R\$ -
115	Sonda de foley nº 18 de 02 vias c/10 - A sonda foley é utilizada para procedimentos de drenagem no canal da uretra, permitindo o esvaziamento da urina que está na bexiga.	CX		150	R\$ -	R\$ -
116	Sonda de foley nº 20 de 02 vias c/10 - A sonda foley é utilizada para procedimentos de drenagem no canal da uretra, permitindo o esvaziamento da urina que está na bexiga.	CX		150	R\$ -	R\$ -
117	Sonda de foley nº 22 de 02 vias c/10 - A sonda foley é utilizada para procedimentos de drenagem no canal da uretra, permitindo o esvaziamento da urina que está na bexiga.	CX		150	R\$ -	R\$ -




118	Sonda nasogástrica nº 06 longa - A sonda é usada para remover líquidos e gases do trato gastrointestinal superior em adultos, obter uma amostra do conteúdo gástrico para estudos laboratoriais e administrar alimentos e medicamentos diretamente no trato gastrintestinal.	UND	2000	R\$ -	R\$ -
119	Sonda nasogástrica nº 14 longa - A sonda é usada para remover líquidos e gases do trato gastrointestinal superior em adultos, obter uma amostra do conteúdo gástrico para estudos laboratoriais e administrar alimentos e medicamentos diretamente no trato gastrintestinal.	UND	2000	R\$ -	R\$ -
120	Sonda nasogástrica nº 16 longa - A sonda é usada para remover líquidos e gases do trato gastrointestinal superior em adultos, obter uma amostra do conteúdo gástrico para estudos laboratoriais e administrar alimentos e medicamentos diretamente no trato gastrintestinal.	UND	2000	R\$ -	R\$ -
121	Sonda uretral nº 10 - Indicado quando ocorre a obstrução do trato urinário ou quando o paciente é incapaz de urinar e no pós-cirúrgico para drenar a urina retida ou promover uma forma de monitorizar o débito urinário horário em pacientes em estado crítico.	UND	2000	R\$ -	R\$ -
122	Sonda uretral nº 12 - Indicado quando ocorre a obstrução do trato urinário ou quando o paciente é incapaz de urinar e no pós-cirúrgico para drenar a urina retida ou promover uma forma de monitorizar o débito urinário horário em pacientes em estado crítico.	UND	25000	R\$ -	R\$ -
123	Sonda uretral nº 14 - Indicado quando ocorre a obstrução do trato urinário ou quando o paciente é incapaz de urinar e no pós-cirúrgico para drenar a urina retida ou promover uma forma de monitorizar o débito urinário horário em pacientes em estado crítico.	UND	24000	R\$ -	R\$ -
124	Sonda uretral nº 06 - Indicado quando ocorre a obstrução do trato urinário ou quando o paciente é incapaz de urinar e no pós-cirúrgico para drenar a urina retida ou promover uma forma de monitorizar o débito urinário horário em pacientes em estado crítico.	UND	24000	R\$ -	R\$ -
125	FISIOLOGICO 0,9 10 ML CX 200 UND - Solução Injetável, Cloreto de Sódio 0,9%; também utilizado para inalação, limpeza de pele e outros fins.	UND	2000	R\$ -	R\$ -
126	SONDA GTT N ° 12 - Solução Injetável, Cloreto de Sódio 0,9%; também utilizado para inalação, limpeza de pele e outros fins.	UND	20	R\$ -	R\$ -
127	SONDA GTT N ° 14 - Solução Injetável, Cloreto de Sódio 0,9%; também utilizado para inalação,	UND	20	R\$ -	R\$ -




	limpeza de pele e outros fins.				
128	SONDA GTT N° 16 - Solução Injetável, Cloreto de Sódio 0,9%; também utilizado para inalação, limpeza de pele e outros fins.	UND	20	R\$ -	R\$ -
129	SONDA GTT N° 18 - Solução Injetável, Cloreto de Sódio 0,9%; também utilizado para inalação, limpeza de pele e outros fins.	UND	20	R\$ -	R\$ -
130	SONDA GTT N° 20 - Solução Injetável, Cloreto de Sódio 0,9%; também utilizado para inalação, limpeza de pele e outros fins.	UND	20	R\$ -	R\$ -
131	SONDA GTT N° 22 - Solução Injetável, Cloreto de Sódio 0,9%; também utilizado para inalação, limpeza de pele e outros fins.	UND	20	R\$ -	R\$ -
132	SONDA GTT N° 24 - Solução Injetável, Cloreto de Sódio 0,9%; também utilizado para inalação, limpeza de pele e outros fins.	UND	20	R\$ -	R\$ -
133	Termômetro clínico digital - Indicado para medir a temperatura e suas variações em situações patológicas. Funciona por contato direto com a pele, utilizando a ponta do sensor para medição.	UND	50	R\$ -	R\$ -
134	Termômetro digital para geladeira - Indicado para medir a temperatura de ambiente, como balcões frigoríficos, câmaras frias, adegas, armários, gabinetes, terrários, choçadeiras, depósitos, armazéns, escritórios, veículos, estufas, piscinas, aquários, e outras superfícies ou espaços relacionados.	UND	50	R\$ -	R\$ -
135	Termômetro interno para geladeira - Para ambientes que precisam ter uma certa regularidade em suas temperaturas, o termômetro para freezer ou geladeira ganha destaque por medir condições térmicas em qualquer espaço fechado, sendo um dos mais usados nessas especificações.	UND	50	R\$ -	R\$ -
136	Touca descartável PCTO C/100 - Touca sanfonada descartável TNT branca 10g com 100 unidades segurança e higiene tanto para o profissional quanto para o paciente.	PCT	8000	R\$ -	R\$ -
137	Tubo de látex com 15m (garrote) - Os tubos de látex são indicados para: procedimentos cirúrgicos e não cirúrgicos. Ação/ativos: os tubos de látex são utilizados principalmente como extensores de passagens para procedimentos de aspirações de fluidos. 100% látex liso e não estéril.	UND	50	R\$ -	R\$ -
138	Kit 10 Macacão Impermeável Proteção - Tecido: TNT Sintético, 100% Polipropileno, Atóxico (não tecido de polipropileno laminado com película impermeável) - Tecido Impermeável que repele líquido e fluidos corporais, Gramatura: Entre 45gm- b2 e 50gm-b2; Produzido de acordo com a ABNT; Manga com punho em elástico; Fechamento frontal fácil por contato; Ajuste do	UND	100	R\$ -	R\$ -



	capuz por amarração; Tamanho p				
139	Kit 10 Macacão Impermeável Proteção - Tecido: TNT Sintético, 100% Polipropileno, Atóxico (não tecido de polipropileno laminado com película impermeável) - Tecido Impermeável que repele líquido e fluidos corporais, Gramatura: Entre 45gm- b2 e 50gm-b2; Produzido de acordo com a ABNT; Manga com punho em elástico; Fechamento frontal fácil por contato; Ajuste do capuz por amarração; Tamanho M	UND	100	R\$ -	R\$ -
140	Kit 10 Macacão Impermeável Proteção - Tecido: TNT Sintético, 100% Polipropileno, Atóxico (não tecido de polipropileno laminado com película impermeável) - Tecido Impermeável que repele líquido e fluidos corporais Gramatura: Entre 45gm- b2 e 50gm-b2; Produzido de acordo com a ABNT; Manga com punho em elástico; Fechamento frontal fácil por contato; Ajuste do capuz por amarração; Tamanho G	UND	120	R\$ -	R\$ -
141	Suplementos para alimentação enteral adulto/idoso - Fórmula de dieta enteral 1,2 kcal dieta enteral líquida nutricionalmente completa, polimérica, isenta de sacarose, lactose e glúten, com 1,2 kcal/ml e 4,0 a 4,5 gramas de proteína a cada 100 ml, osmolaridade de 230 a 360 mosm/kg de água (sistema aberto), deve atingir 100% daidr em 1400 ml de dieta. apresentação em embalagem com 1 litro. Enteral, classificação fórmula dieta enteral 1,2 kcal.	FRASCOS	1200	R\$ -	R\$ -
142	Suplementos para alimentação enteral adulto/idoso Dieta enteral líquida, nutricionalmente completa, polimérica, isenta de sacarose, lactose e glúten com 1,5 kcal/ml e 5,6 a 6,5 gramas de proteína 100 ml de dieta, osmolalidade de 320 a 630 mosmkg de água, sistema aberto, embalagem de 1 litro.	FRASCOS	1200	R\$ -	R\$ -
143	Suplementos para alimentação enteral adulto/idoso - Utilizado na nutrição de pacientes com diabetes ou intolerância a glicose, Nutri Diabetic 1.0 pode ser usado em nutrição oral ou enteral. Dieta para situações metabólicas especiais, disponível no sabor de baunilha e embalagem 1L. Normocalórica (1,0 Kcal/ml), hiperlipídica (46%), normoprotéica (15%) e hipoglicídica (39%), à base de proteína de origem animal, com 16g de fibras por litro de dieta (70% solúveis e 30% insolúveis) e enriquecido com Carnitina e Taurina. Além disso, proporciona uma dieta com uma mistura de carboidratos e fibras que proporcionam absorção lenta, auxiliando no controle da resposta glicêmica. Indicado para Diabetes Tipo I e II, Diabetes Gestacional, Síndrome Metabólica, Intolerância a Glicose. Isento de	FRASCOS	1200	R\$ -	R\$ -




144	sacarose, lactose e glúten. Suplementos para alimentação enteral infantil - Fórmula infantil para lactentes e de seguimento para lactentes e crianças de primeira infância destinada a necessidades dietoterápicas específicas com 1kcal/ml. Infatrini é uma fórmula polimérica, hipercalórica e nutricionalmente completa indicada para alimentação oral ou enteral de lactentes e crianças de primeira infância. Infatrini é adicionado de LCPufas (ARA/DHA), nucleotídeos, beta-caroteno e prebióticos (GOS/FOS). Indicado Cardiopatias congênitas, fibrose cística, insuficiência respiratória, déficit pondero-estatural ou desaceleração do crescimento, pré e pós operatório, aceitação oral insuficiente, restrição hídrica, intolerância a aumento de volume. Crianças de 0 a 3 anos de idade. Não contém glúten. Não contém sacarose.	LATA	1200	R\$ -	R\$ -
145	Suplementos para alimentação enteral infantil - Fórmula pediátrica para nutrição enteral ou oral para crianças em pó, nutricionalmente completa e rica em vitaminas e minerais. Permite preparo nas diluições 1,0kcal/ml, 1,25kcal/ml e 1,5kcal/ml. Indicações: Crianças em risco nutricional, desnutridas ou com desaceleração do crescimento; com doenças crônicas (ex. fibrose cística, cardiopatias, doença celíaca, câncer, etc), anorexia, estomatite, restrição hídrica, em pré ou pós operatório. Não contém glúten. Não contém lactose.	LATA	1200	R\$ -	R\$ -
146	Suplementos para alimentação enteral infantil - Fórmula infantil elementar para lactentes e de seguimento para lactentes e crianças de primeira infância para necessidades dietoterápicas específicas, nutricionalmente completa e isenta de proteína láctea, lactose, sacarose, frutose, galactose e ingredientes de origem animal. Contém aminoácidos livres e sintéticos, xarope de glicose, óleos vegetais e TCM. Adicionada de LCPufas (ARA e DHA) e nucleotídeos. Atendendo a todas as legislações pertinentes. Alergia alimentar (ao leite de vaca, à soja, a hidrolisados e a múltiplas proteínas). Lactentes e crianças de primeira infância, até 36 meses de vida. Não contém glúten. Não contém sacarose. Não contém lactose.	LATA	3000	R\$ -	R\$ -
147	Suplementos para alimentação infantil - Fórmula pediátrica para nutrição enteral e oral em pó, nutricionalmente completa, normocalórica (1,0kcal/ml) com alto teor de vitaminas e minerais, fonte de fibras e sem	LATA	1200	R\$ -	R\$ -



	adição de sacarose. Crianças com dificuldades alimentares, caracterizada por deficiência no consumo de qualidade, quantidade e/ou variedade de alimentos, que possam se beneficiar com uma complementação alimentar. Crianças menores de 10 anos. Não contém glúten. Sem adição de sacarose.					
148	Suplementos para alimentação infantil - Alimento para Situações Metabólicas Especiais para Nutrição Enteral/ Oral, sabor artificial de baunilha formulado para portadores de alergia às proteínas do leite de vaca. É indicado para crianças de 3 a 10 anos de idade, portadores de alergias a proteína do leite de vaca. Não contém glúten. Contém Fenilalanina.	LATA	1200	R\$ -	R\$ -	
149	Fórmula infantil de partida e segmento em pó - Fórmula infantil de partida e segmento em pó, a base de proteínas lácteas intactas, adicionada de Exclusivos Prebióticos Danone Nutricia 0,8g/100ml de scGOS/cfOS (9:1). Contém adequada relação ômega 6: ômega 3 e presença de LCPUFAs (DHA e ARA), além da presença de nucleotídeos. Teor de vitaminas A e C e dos minerais Ferro e Zinco adaptados aos achados do Estudo Nutriplanet Brasil. Alimentação de lactentes desde o nascimento até os 6 meses de vida. Não contém glúten. Não contém sacarose.	LATA	1200	R\$ -	R\$ -	
150	Fórmula infantil de partida e segmento em pó - Fórmula infantil sem lactose para pessoas com restrição lactose 400g Fórmula infantil sem lactose, destinada a necessidades dietoterápicas específicas com restrição de lactose. Com prebióticos, DHA e ARA e nucleotídeos. Não Contém Glúten.	LATA	2000	R\$ -	R\$ -	
151	Fórmula infantil de partida e segmento em pó - Dieta semi-elementar e hipoalergênica Lata 400g para crianças desde o nascimento com distúrbios da digestão e absorção de nutrientes ou alergias alimentares. Contém proteína extensamente hidrolisada do soro de leite (100%), 100% de maltodextrina e as gorduras são compostas por óleos vegetais, tcm e óleo de peixe. Isento de lactose, galactose, sacarose, frutose e glúten. Isenta de aminoácidos livres.	LATA	1200	R\$ -	R\$ -	
152	Fórmula infantil de partida e segmento em pó - Fórmula extensamente hidrolisada e hipoalergênica lata 450g Melhora os sintomas associados à alergia à proteína do leite de vaca (APLV), ou seja, eczema, cólicas, vômitos, diarreia e obstipação. Contém lactose, é nutricionalmente completa e concebida para se assemelhar à composição do leite materno e às	LATA	1200	R\$ -	R\$ -	



	fórmulas infantis normais, o que permite um crescimento e desenvolvimento normal. Adequada a partir do nascimento, o sabor e palatabilidade facilitam a sua utilização para o tratamento a longo prazo da alergia à proteína do leite de vaca.				
153	Suplementos para alimentação infantil - Fórmula infantil para lactentes e de seguimento - Lata 400g para lactentes e crianças de primeira infância destinada a necessidades dietoterápicas específicas com restrição de lactose e à base de aminoácidos. Com DHA e ARA. Recomendado para lactentes e crianças de primeira infância, 0-36 meses de idade. Fórmula infantil constituída 100% de aminoácidos livres com TCM, β -Palmitatos, DHA e ARA, sem adição de lactose. Para lactentes e crianças de primeira infância com alergia a múltiplos alimentos ou alergia a hidrolisados proteicos com comprometimento do trato gastrointestinal. 10% de proteínas (100% aminoácidos livres) 45% de carboidrato (88,4% xarope de milho, 10,2% amido de batata, 1,4% maltodextrina) 45% de gorduras (25% TCM, 22% óleo de girassol de alto teor oleico, 20% óleo de canola, 16% óleo de girassol, 10% oleína de palma, 6% ésteres de mono e diglicérides de ácidos graxos com citroco, 0,5% óleo de C. cohnii rico em DHA, 0,5% óleo de M. alpina rico em ARA). Lactose 0g/100mL. Sem sabor. Não contém glúten.	LATA	1200	R\$ -	R\$ -
154	Bandeja Clínica - Média. Dimensões 23cm x 13cm. Aço inox. Autoclavável.	UND	180	R\$ -	R\$ -
155	Sonda Exploradora N°5; Embalagem com 1 unidade. Cabo fino (n° 5) Aço Immunity. Autoclavável. Validade Indeterminada.	UND	200	R\$ -	R\$ -
156	Cabo Para Espelho Bucal; Aço Inox. Autoclavável. Tamanho mínimo: 13 cm.	UND	190	R\$ -	R\$ -
157	Sonda North Carolina; Aço inox; Cabo oco de 8mm. Marcação a laser. Marcação até 15mm. Embalagem com 1 unidade.	UND	130	R\$ -	R\$ -
158	Piça Clínica Para Algodão; Aço inoxidável. Autoclavável. Embalagem com 1 unidade.	UND	190	R\$ -	R\$ -
159	Seringa Carpule Com Refluxo; Fabricada em aço inoxidável. Utilizada para aplicação de anestésias. Garantia de 10 anos contra defeito de fabricação comprovado. Tamanho mínimo: 12,5 cm. Embalagem com 1 unidade.	UND	230	R\$ -	R\$ -
160	Contra Ângulo Intra T10 1:1; Unidade. Latch Type (Trava). Fixação da broca: Através de trava (lâmina). Spray único externo: Direcionado para a ponta da broca. Corpo confeccionado em alumínio anodizado: Peso reduzido. Possui camadas de anodização dura,	UND	15	R\$ -	R\$ -



	garantindo resistência aos processos de autoclavagem. Cabeça em liga metálica de cobre e zinco: Maior resistência mecânica a impactos, como quedas ou batidas. Rotação: Até 20.000 rpm. Autoclaváveis até 135°C. Cor Prata acetinado. Acoplamento: Intra (universal), com giro de 360 graus. Rotação: 5.000 a 20.000 rpm. Relação de transmissão: 1:1. Baixa Rotação. Brocas: Haste tipo 1 AR Standard.					
161	Avental de Borracha Plumbífera Adulto com Protetor de Tireóide, Tamanho 76x60cm; Acabamento em corino	UND		3	R\$ -	R\$ -
162	Avental de Borracha Plumbífera Infantil c/ Protetor de Tireóide, Tamanho 60x50cm com 0,25mm pb; Acabamento em corino	UND		3	R\$ -	R\$ -
163	Câmara Escura c/ Iluminação, Angulação para entrada das mãos, tornando fácil o acesso às cubas, evitando o mau posicionamento do operador; Design moderno com caixa moldada em polipropileno (PP). Fácil remoção das luvas para assepsia. Base removível, facilitando coleta de resíduos, limpeza e desinfecção. Possui alojamento para os recipientes que contém líquido evitando que os mesmos fiquem soltos; Visor acrílico destacável, com ótima transparência e total filtragem da luz. Luz com fio composta de LED, proporcionando luminosidade no interior do gabinete de revelação sem danificar a película radiográfica. Permite a visualização no interior possibilitando acompanhamento visual da revelação. Não utiliza energia elétrica. Dimensões mínimas: 230mm (altura), 340mm, (comprimento) e 230mm (largura). Corrente: 40 MA. Luz Led: 6000 candela. Bateria: 9 V. Acompanha 4 reservatórios para líquido (água, removedor, fixador e água).	UND		4	R\$ -	R\$ -
164	FÓRCEPS Nº 150 ADULTO; Embalagem c/ 1 unidade, Aço inox; Autoclavável; 18 cm de comprimento.	UND		80	R\$ -	R\$ -
165	FÓRCEPS Nº 151 ADULTO; Embalagem c/ 1 unidade, Aço inox; Autoclavável; 18 cm de comprimento.	UND		80	R\$ -	R\$ -
166	Fórceps Adulto Nº 18L - Mol. Superiores Lado Esquerdo, Embalagem c/ 1 unidade, Aço inox; Autoclavável;	UND		80	R\$ -	R\$ -
167	Fórceps Adulto Nº 18R - Mol. Superiores Lado Direito, Embalagem c/ 1 unidade, Aço inox; Autoclavável;	UND		80	R\$ -	R\$ -
168	Fórceps Adulto Nº 17 - Mol. Inferiores; Embalagem c/ 1 unidade, Aço inox; Autoclavável;	UND		95	R\$ -	R\$ -
169	Fórceps Adulto Nº 16 - Mol. Inferiores;	UND		90	R\$ -	R\$ -



	Embalagem c/ 1 unidade, Aço inox; Autoclavável;					
170	Fórceps Adulto Nº 69 - Mol. Inferiores; Embalagem c/ 1 unidade, Aço inox; Autoclavável;	UND		45	R\$ -	R\$ -
171	Fórceps Adulto Nº 65 - Mol. Inferiores; Embalagem c/ 1 unidade, Aço inox; Autoclavável;	UND		40	R\$ -	R\$ -
172	Fórceps Infantil Nº 150; Embalagem c/ 1 unidade, Aço inox; Autoclavável;	UND		60	R\$ -	R\$ -
173	Fórceps Infantil Nº 151; Embalagem c/ 1 unidade, Aço inox; Autoclavável;	UND		55	R\$ -	R\$ -
174	Fórceps Infantil Nº 18L - Molares Superiores Lado Esquerdo; Embalagem c/ 1 unidade, Aço inox; Autoclavável;	UND		20	R\$ -	R\$ -
175	Fórceps Infantil Nº 18L - Molares Superiores Lado Direito; Embalagem c/ 1 unidade, Aço inox; Autoclavável;	UND		20	R\$ -	R\$ -
176	Fórceps Infantil Nº 44; Molares Superiores Lado Direito; Embalagem c/ 1 unidade, Aço inox; Autoclavável;	UND		20	R\$ -	R\$ -
177	Alavanca Seldin Adulto Número 02 (RETA); Embalagem c/ 1 unidade, Aço inox; Autoclavável;	UND		190	R\$ -	R\$ -
178	Alavanca Seldin Adulto (Nº 1L Esquerda); Também conhecida como alavanca "Bandeirinha"; Embalagem c/ 1 unidade, Aço inox; Autoclavável;	UND		65	R\$ -	R\$ -
179	Alavanca Seldin Adulto (Nº 1R Direita); Também conhecida como alavanca "Bandeirinha"; Embalagem c/ 1 unidade, Aço inox; Autoclavável;	UND		65	R\$ -	R\$ -
180	Alveolótomo Luer Goiva Curva; Aço inox; Autoclavável, Tamanho: 16cm. (Também conhecida como Pinça Goiva.)	UND		38	R\$ -	R\$ -
181	Jogo Alavancas Apicais 3 Peças, Adulto (Reta, Direita e Esquerda). Aço inox; Autoclavável. Instrumentos de cabo grosso. Possuem lâminas afiadas (retas e anguladas) finas e côncavas.	UND		50	R\$ -	R\$ -
182	Porta Agulha MayoHegar 16cm; Aço inox; Autoclavável.	UND		135	R\$ -	R\$ -
183	Pinça Halstead Mosquito Curva 12,5cm; Aço inox; Autoclavável.	UND		45	R\$ -	R\$ -
184	Cabo p/ Bisturi Nº 3; Aço inox; Autoclavável, Cabo de chapa para lâmina nº 3. Cabo de chapa para lâminas 11 /12 /15 e 15c;	UND		70	R\$ -	R\$ -
185	AFASTADOR MINESSOTA; Aço inox; Autoclavável, Tamanho: 14cm.	UND		60	R\$ -	R\$ -
186	Sindesmótomo Duplo Nº 1; Embalagem com 1 unidade. Aço inox. Autoclavável.	UND		175	R\$ -	R\$ -
187	Lima Dupla Seldin Nº 11; Confeccionada em Aço Inoxidável, cabo oco de 8mm, Embalagem com 1 unidade. Autoclavável.	UND		35	R\$ -	R\$ -
188	Tesoura Cirúrgica Curva, 15cm de Diâmetro;	UND		170	R\$ -	R\$ -



	Aço inox. Autoclavável.				
189	Broca Carbide Cônica Cirurgica Zekrya FG nº151, Diâmetro de 23mm. Autoclavável. Alta rotação. 100% carbide. Broca de formato tronco-cônico e com ponta ativa para alta rotação;	UND	66	R\$ -	R\$ -
190	Cureta Lucas Modelo nº 85; Aço inox. Autoclavável. Embalagem com 1 unidade.	UND	35	R\$ -	R\$ -
191	Broca Carbide Cirúrgica Esférica N 6; Autoclavável. Alta rotação, 100% carbide.	UND	56	R\$ -	R\$ -
192	Sugador Cirurgico Metálico (CURVO); Aço inox. Autoclavável.	UND	75	R\$ -	R\$ -
193	Ponta Ultrassônica G2; Confeccionado e usinado em aço de liga especial, protegido contra oxidação. Compatível com MICRODONT / EMS / Ortus / Alt / Cristofolientech / Mectron / Advance 1 / Advance / Advance View / Advance SEL / PM200 / PM 100 / Peison Master / UltraScaler Kavo / NAC / Emissionic MMO / Odontomedics / Driller	UND	10	R\$ -	R\$ -
194	Ponta Ultrassônica P4; Autoclavável. Confeccionado e usinado em aço de liga especial, protegido contra oxidação, com dureza. Pontas em Aço Inox para Caneta do Ultrassom Piezoelétrico, potência 60% média/alta. Uso com refrigeração.	UND	10	R\$ -	R\$ -
195	Ponta Ultrassônica G4; Autoclavável. Compatível com Microdont ADVANCE 1, Microdont ADVANCE 2, Microdont ADVANCE View, MicrodontAdvanced S, MicrodontAdvance SEL, ALT, EMS PM 200, EMS-PM 100, EMS PiezonMaster, Mectron, Kavo, Ortus, Kondortec, NAC, Emissionic (MMO), Odontomedics. Confeccionado e usinado em aço de liga especial, protegido contra oxidação; canal interno para refrigeração da parte ativa da ponta.	UND	10	R\$ -	R\$ -
196	Cureta de Gracey Número 07-08; Aço inox. Autoclavável. Cabo 8mm.	UND	50	R\$ -	R\$ -
197	Cureta de Gracey Número 11-12; Aço inox. Autoclavável. Cabo 8mm.	UND	40	R\$ -	R\$ -
198	Cureta de Gracey Número 13-14; Aço inox. Autoclavável. Cabo 8mm.	UND	40	R\$ -	R\$ -
199	Cureta de Gracey Número 15-16; Aço inox. Autoclavável. Cabo 8mm.	UND	40	R\$ -	R\$ -
200	Cureta de Gracey Número 17-18; Aço inox. Autoclavável. Cabo 8mm.	UND	40	R\$ -	R\$ -
201	Cureta Inox Mc Call Nº 11/12 Foice; Aço inox. Autoclavável. Cabo 8mm. Instrumento produzido em Aço Inoxidável.	UND	55	R\$ -	R\$ -
202	Foice Ponta Morse 0-00; Aço inox. Autoclavável. Confeccionada em Aço Inoxidável. Cabo de 8mm	UND	60	R\$ -	R\$ -
203	Pedra para afiar Arkansas; Pedra de Arkansas	UND	35	R\$ -	R\$ -




	com granulação fina. Dimensões: 10 cm x 2.5 cm x .6 cm.					
204	Colgadura Individual; Acessório Radiológico. Autoclavavel	UND		100	R\$ -	R\$ -
205	Espátula Dupla Silicato Nº1; Autoclavavel, Confeccionado em aço inoxidável AISI-420; Tamanho: 12cm;	UND		130	R\$ -	R\$ -
206	Espátula p/ Resina Thompson Calcador Nº 2; Produzido em liga de Aço Inoxidável de alta qualidade. Totalmente autoclavável. 17cm de comprimento. Cabo em alumínio anodizado.	UND		130	R\$ -	R\$ -
207	Calcador De Holleback Numero 01; Autoclavavel. É ideal em restaurações para esculpir e condensar.16cm. Produzida em Aço Inoxidável	UND		56	R\$ -	R\$ -
208	Calcador De Holleback Numero 03; Autoclavavel. É ideal em restaurações para esculpir e condensar. 16cm. Produzida em Aço Inoxidável	UND		50	R\$ -	R\$ -
209	Calcador De Holleback Numero 05; Autoclavavel. É ideal em restaurações para esculpir e condensar. 16cm. Produzida em Aço Inoxidável	UND		50	R\$ -	R\$ -
210	Calcador De Holleback Numero 06; Autoclavavel. É ideal em restaurações para esculpir e condensar. 16cm. Produzida em Aço Inoxidável	UND		55	R\$ -	R\$ -
211	Brunidor Numero 29 Oitavado Simples Condensador; Aço Inox; Autoclavavel Também conhecido com ovo de pomba ou brunidor ovóide, devido seu formato. 16cm.	UND		40	R\$ -	R\$ -
212	Escavador de Dentina Número 05; Escavador de dentina, também conhecido como Colher de Dentina; Comprimento: 16cm; Produzida em Aço Inoxidável AISI 304 e AISI 420; Autoclavavel	UND		65	R\$ -	R\$ -
213	Escavador de Dentina Número 11; Escavador de dentina, também conhecido como Colher de Dentina; Comprimento: 16cm; Produzida em Aço Inoxidável AISI 304 e AISI 420; Autoclavavel	UND		65	R\$ -	R\$ -
214	Escavador de Dentina Número 12; Escavador de dentina, também conhecido como Colher de Dentina; Comprimento: 16cm; Produzida em Aço Inoxidável AISI 304 e AISI 420; Autoclavavel	UND		65	R\$ -	R\$ -
215	Escavador de Dentina Número 17; Escavador de dentina, também conhecido como Colher de Dentina; Comprimento: 16cm; Produzida em Aço Inoxidável AISI 304 e AISI 420; Autoclavavel	UND		60	R\$ -	R\$ -
216	Placa de Vidro Despolida; Indicado para espátulação de materiais. Medidas 15x07x06mm. Placa despolida. Altoclavável	UND		50	R\$ -	R\$ -




217	Aplicador de Hidróxido de Cálcio Duplo; Material: Inox. Autoclavável. Comprimento: 16cm;	UND	80	R\$ -	R\$ -
218	Porta Algodão de Inox ; Composição do aço: aço-inox 304 , acabamento perfeito e livre de rebarbas; Autoclavável. Dimensões: 08x10c	UND	60	R\$ -	R\$ -
219	Espátula Simples N 24 ; Material em aço inox. Autoclavável.	UND	50	R\$ -	R\$ -
220	Porta Amálgama Metálico Simples; Tamanho: 14cm. Fabricado em aço Inoxidável AISI-420. Autoclavável.	UND	70	R\$ -	R\$ -
221	Porta Matriz Tofflemire Adulto; Aço Inox. Autoclavável. Diâmetro: 6 cm	UND	55	R\$ -	R\$ -
222	Pote Dappen de Vidro; Material: Vidro. Transparente. Cor: Incolor. Autoclavável. Medidas mínimas: Altura, 3cm; Concavidade superior: 2,5 cm; Capacidade máxima da concavidade superior: 3 ml. Concavidade inferior: 2,0 cm; Capacidade máxima da concavidade inferior: 2 ml. Peso do produto: 50 g;	UND	45	R\$ -	R\$ -
223	Alicate Perfurador Ainsworth; Totalmente autoclavável. Produzido em liga de Aço Inoxidável de alta qualidade. Perfura o lençol com 5 diâmetros diferentes. Alicate perfurador p/ auxílio na elaboração de dique de borracha; Tamanho 15 cm;	UND	10	R\$ -	R\$ -
224	Grampo p/ Isolamento Nº 206; Aço Inoxidável, Autoclavável;	UND	20	R\$ -	R\$ -
225	Grampo p/ Isolamento Nº 207; Aço Inoxidável, Autoclavável;	UND	20	R\$ -	R\$ -
226	Grampo p/ Isolamento Nº 209; Aço Inoxidável, Autoclavável;	UND	20	R\$ -	R\$ -
227	Grampo p/ Isolamento Nº 210; Aço Inoxidável, Autoclavável;	UND	20	R\$ -	R\$ -
228	Grampo p/ Isolamento Nº 200; Aço Inoxidável, Autoclavável;	UND	20	R\$ -	R\$ -
229	Grampo p/ Isolamento Nº 202; Aço Inoxidável, Autoclavável;	UND	20	R\$ -	R\$ -
230	Grampo p/ Isolamento Nº 201; Aço Inoxidável, Autoclavável;	UND	20	R\$ -	R\$ -
231	Grampo p/ Isolamento Nº W8A; Aço Inoxidável, Autoclavável;	UND	20	R\$ -	R\$ -
232	Arcos de Ostby Adulto	UND	15	R\$ -	R\$ -
233	Conjunto de Aspiração Endodôntico; Kit com 1 cânula + 3 agulhas com bisel. Três tamanhos de agulhas. Tamanho da cânula permite perfeita empunhadura. Produto autoclavável Autoclavável. MEDIDAS MINÍMAS DO PRODUTO: Agulha 4010: 32,4 mm x Ø 1 mm. Agulha 4015: 32 mm x Ø 1,5 mm. Agulha 5020: 40,9 mm x Ø 2 mm. Cânula: 100 mm x Ø 3,30 mm (interno)x Ø 6,35 mm (externo)	UND	15	R\$ -	R\$ -
234	Régua de Alumínio Milimetrada Endodôntica;	UND	20	R\$ -	R\$ -




	Esterilizável em autoclave. Utilizado para medir limas endodônticas.					
235	<p>Consultório Odontológico: Estrutura Construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo. Base com debrum antiderrapante Dispensa fixação no piso. Braço de apoio para o paciente. Pedal de Comandos. Sistema de elevação Eletromecânico acionado por moto-reductor de baixa tensão com 24 volts. Sistema eletrônico Integrado e de baixa voltagem: 24 volts. Tensão de alimentação 220V ~ 50/60Hz. Encosto de cabeça anatômico, removível, bi-articulável e com regulagem de altura, com movimentos anterior, posterior e longitudinal. Equipos Compostos: 01 Seringa tríplice; 01 terminal com spray para alta rotação; 01 terminal sem spray para micromotor pneumático. Pedal Progressivo para o acionamento das peças de mão nos terminais do equipo, o que possibilita o controle da velocidade e com acionamento em qualquer ponto do pedal. Seringa tríplice, Bico giratório removível e autoclavável. Suporte das pontas. Com acionamento pneumático individual; Pintura na cor branca, com tratamento anticorrosivo; Puxador bilateral. Unidade de Água: fluxo de água na cuspeira; Cuba profunda, removível e com ralo para retenção de sólidos e cobertura para evitar respingos. Filtro de detritos. Sistema de regulagem da vazão da água e permite a regulagem fina do fluxo de água; 01 Suctor de saliva a ar; Reservatórios translúcidos de 800 ml para: Água das peças de mão e seringa tríplice. Refletor Luz halógena. Puxadores bilaterais em forma de alça que possibilitam isolamento evitando o risco de contaminação cruzada. Cabeçote produzido em material resistente, com giro de 620°; Intensidade: 8.000 a 25.000 LUX (tolerância +/- 20%).</p>	UND	6	R\$ -	R\$ -	
236	<p>AUTOCLAVE: Câmaras de esterilização em aço inox, com muito mais resistência e durabilidade; Produto de fácil operação com controles simples e automáticos; Acompanhamento dos ciclos através de manômetro, termômetro e avisos visuais; Diversos sistemas de segurança que controlam todo o ciclo e previnem falhas de funcionamento, com desligamento automático em caso de excesso de temperatura, pressão ou falta de água; Tampa com construção especial e fecho de triplo estágio, muito mais segurança e praticidade no momento de utilizar</p>	UND	8	R\$ -	R\$ -	



	o equipamento; Secagem eficiente do material com opção de secagens extras; Informações Técnicas: Capacidade mínima 40 litros; Câmara de aço inox; Dimensões mínimas da câmara 30 X 56,6 cm (diâmetro x comprimento); Potência mínima 1600 w; Pressão de trabalho 1 kgf/cm ² ; Temperatura padrão O.M.S até 121°C; Ciclo de secagem de série Bandejas de alumínio				
237	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO: Isento de óleo, com pintura antimicrobiana interna e externa e padrões construtivos segundo as mais exigentes normas mundiais. Uso externo - Informações Técnicas: Deslocamento teórico: 5pcm- 141 l/m; Tensão: 220V - Monofásico; Pressão de operação: Mínima: 80 Libras - 5.5 Bar; Máxima: 120 Libras - 8.3 Bar; Número de pistões: 2; Potência mínima: 1HP / 0.75 kW; Volume mínimo do reservatório: 30 l; Nível de Ruído máximo: 70 DB; Conexão: 1/4"	UND	8	R\$ -	R\$ -
238	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO: Push Button. Fixação da broca de forma fácil, prática e segura. Cabeça Standard. Diâmetro mínimo da cabeça: 11,3 mm. Spray Triplo Ventilado, rolamentos com esferas cerâmicas, rotor balanceado eletronicamente. Corpo e cabeça confeccionados em liga metálica de cobre e zinco resistência aos processos de autoclavagem. Autoclavável até 135°C. Deverá conter como acessórios: 01 Agulha de limpeza, 01 Guarnição Borden. Garantia: 12 Meses. Rotação deverá ser entre: 360.000 a 420.000 rpm. Brocas: Haste tipo 3 - FG Standard. Pressão média de trabalho (bar): 2,2 bar = 220 Kpa = 32 psi + 5% Diâmetro da cabeça: 11,3 mm	UND	10	R\$ -	R\$ -
239	CONTRA ÂNGULO (CANTE DE BAIXA ROTAÇÃO): Fixação da broca: Através de trava (lâmina). Spray único externo; Corpo confeccionado em alumínio anodizado; Cabeça em latão (metal duro): Autoclaváveis até 135°C; Cor Prata acetinado. contendo acessórios: 01 Adaptador de refrigeração. Informações Técnicas: Peso bruto c/ embalagem: 78 g; Garantia: 12 Meses; Peso: 43 g; Acoplamento: Intra (universal), com giro de 360 graus Rotação média: 5.000 a 20.000 rpm; Relação de transmissão: 1:1; Brocas: Haste tipo 2 - HP Standard	UND	20	R\$ -	R\$ -
240	MICRO MOTOR (MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO): Spray Externo. Corpo confeccionado em alumínio anodizado;	UND	12	R\$ -	R\$ -




	Acoplamento Intra (universal): Com giro de 360 graus. Rotação: Até 20.000 rpm * Regulagem da velocidade e sentido de giro (horário ou anti-horário) no corpo do micro motor. Autoclaváveis até 135°C. Cor: Prata; Conexão: Borden (2 furos). Acoplamento: Intra (universal), com giro de 360 graus. Rotação: 5.000 a 20.000 rpm. Pressão de trabalho (bar): 2,76 bar = 275,8 Kpa = 40 psi +/- 5%. Consumo de ar: 52 l/min. +/- 10%.				
241	FOTOPILIMERIZADOR (LED): Display digital. Profundidade de polimerização de 6 mm. Temporizador para Polimerização modo Contínuo: 05, 10, 15, 20 segundos; Temporizador para Polimerização modo High e Ortho: 03 segundos; Bip sonoro indicativo a cada 5 seg e no final da operação. Tempo máximo de uso contínuo: 300 segundos. Comandos de programação na própria caneta. Corpo confeccionado em ABS injetado. Intensidade de luz constante, independente do nível de carga da bateria. A solidificação (cura) da resina não é afetada pela diferença de carga da bateria. Silencioso, pois não necessita de ventilação forçada. Bivolt automático 100/240V. Ponteira removível e com giro de 360°. Lente da ponteira substituível. Sistema stand by. Desliga automaticamente após 2 minutos sem utilização. Informações Técnicas: Alimentação: Bivolt automático 100 - 240 V. Garantia de 12 Meses. Bateria: 3,7V 1400 mA; Potência de luz: 1250 mW, 1900 mW, 2500 mW.	UND	10	R\$ -	R\$ -
242	Seladora Manual Odontológica para Papel Grau Cirúrgico: Controle eletrônico de temperatura até 300°C, controle eletrônico do tempo de selagem com bip sonoro, alavanca de selagem, suporte e cortador de bobinas com faca de duplo corte; Dados técnicos mínimos: Largura da selagem: 13 mm; Largura da embalagem: 300 mm / 30 cm; Potência mínima: 150 watts. Tensão de alimentação: 220V / 60Hz	UND	19	R\$ -	R\$ -
243	Ponta Diamantada Cilíndrica Extremidade Plana 1092, Alta Rotação, Confeccionada em aço e impregnada com diamantes naturais. Autoclavável.	UND	1440	R\$ -	R\$ -
244	Broca Carbide Cirúrgica esférica Nº 06, Embalagem com 1 unidade. Características: Broca autoclavável; Referência da broca: 6; Tipo de ponta: Esférica; Tipo de Broca: Alta Rotação (FG); Comprimento total: 25 mm.	UND	144	R\$ -	R\$ -
245	Broca Carbide Cirúrgica esférica Nº 08, Embalagem com 1 unidade. Características: Broca autoclavável; Referência da broca: 8;	UND	144	R\$ -	R\$ -




	Tipo de ponta: Esférica; Tipo de Broca: Alta Rotação (FG); Comprimento total: 25 mm.					
246	Ponta Diamantada Cônica Extremidade Ogival - Ponta Diamantada Nº 3227F, * Haste em aço inoxidável; Granulação; Fina (F) Vermelho - 46µm; Alta rotação.	UND		144	R\$ -	R\$ -
247	Broca Carbide Esférica CA 3 (Baixa Rotação). Modelo: CA 3, Autoclavável. Características: Haste: CA; Família: Esférica; Granulometria: Média; Característica: Baixa Rotação; Diâmetro Parte Ativa: 1,2 mm.	UND		144	R\$ -	R\$ -
248	Broca Carbide Esférica CA 6. Modelo: CA 6, Autoclavável. Características; Haste: CA; Família: Esférica; Granulometria: Média; Característica: Baixa Rotação; Diâmetro Parte Ativa: 1,8 mm.	UND		144	R\$ -	R\$ -
249	Broca Carbide Esférica CA 8 (Baixa Rotação), Modelo: CA 8, Autoclavável. Características: Haste: CA; Família: Esférica; Granulometria: Média; Característica: Baixa Rotação; Diâmetro Parte Ativa: 2,3 mm.	UND		144	R\$ -	R\$ -
250	Broca Esf. Nº 1012 diamantada, alta rotação, Comprimento da haste: 19 mm, Diâmetro da haste: 1,6 mm, Velocidade de uso recomendada: 300.000 rpm	UND		1440	R\$ -	R\$ -
251	Broca Esf. Nº 1014 diamantada, alta rotação, Broca autoclavável, Referência da broca: 1014, Tipo de ponta: Esférica, Granulometria: Média, Tipo de Broca: Alta Rotação (FG), Diâmetro máximo da parte ativa (Ø ISO): 014, Comprimento da parte ativa: 1,4 mm, Comprimento total: 19,0 mm	UND		1440	R\$ -	R\$ -
252	Broca Esf. Nº 1015 diamantada, alta rotação, Broca autoclavável, Referência da broca: 1015, Tipo de ponta: Esférica, Granulometria: Média, Tipo de Broca: Alta Rotação (FG), Diâmetro máximo da parte ativa (Ø ISO): 016, Comprimento da parte ativa: 1,6 mm, Comprimento total: 19,0 mm.	UND		1440	R\$ -	R\$ -
253	Broca Esf. Nº 1017 diamantada, alta rotação, Broca autoclavável, Referência da broca: 1017, Tipo de ponta: Esférica, Granulometria: Média, Tipo de Broca: Alta Rotação (FG), Diâmetro máximo da parte ativa (Ø ISO): 021, Comprimento da parte ativa: 2,1 mm, Comprimento total: 19,0 mm.	UND		1440	R\$ -	R\$ -
254	Broca Aço Mult-Set CA (BAIXA ROTAÇÃO). Indicado para acabamento em Amálgama; Broca CA em aço Vanádio; Broca Aço Mult-Set CA Multilaminada; Kit com Brocas de 12 Lâminas.	KIT		60	R\$ -	R\$ -
255	Ponta Diamantada Cônica Pontaguda Nº 2200F, Broca autoclavável; Referência da broca: 2200F; Tipo de ponta: Cônica	UND		1440	R\$ -	R\$ -



	Pontiaguda; Granulometria: Fina; Tipo de Broca: Alta Rotação (FG); Diâmetro máximo da parte ativa (Ø ISO): 010; Comprimento da parte ativa: 8,0 mm; Comprimento total: 22,0 mm.					
256	Ponta Diamantada Cônica Invertida 1047, Broca autoclavável; Referência da broca: 1047; Tipo de ponta: Cônica Invertida Dupla; Granulometria: Média; Tipo de Broca: Alta Rotação (FG); Diâmetro máximo da parte ativa (Ø ISO): 018; Comprimento da parte ativa: 2,2 mm; Comprimento total: 19,0 mm.	UND		400	R\$ -	R\$ -
257	Ponta Diamantada Cônica Pontiaguda Nº 2200FF, Broca autoclavável; Referência da broca: 2200FF; Tipo de ponta: Cônica Pontiaguda; Granulometria: Extra Fina; Tipo de Broca: Alta Rotação (FG); Diâmetro máximo da parte ativa (Ø ISO): 010; Comprimento da parte ativa: 8,0 mm; Comprimento total: 22,0 mm.	UND		1440	R\$ -	R\$ -
258	Ponta Diamantada Cônica Extremidade em Chama 3195F, amíliã: Cônica Topo Chama; Granulometria: Média; Característica: Alta Rotação; Diâmetro Parte Ativa: 1,6 mm; Comprimento Parte Ativa: 10,0 mm.	UND		500	R\$ -	R\$ -
259	Ponta Diamantada Chama 3118F, Broca autoclavável; Referência da broca: 3118; Tipo de ponta: Chama; Granulometria: Média; Tipo de Broca: Alta Rotação (FG); Diâmetro máximo da parte ativa (Ø ISO): 023; Comprimento da parte ativa: 5,0 mm; Comprimento total: 19,0 mm.	UND		500	R\$ -	R\$ -
260	Broca Zecrya Longa 21 mm, Broca de formato tronco-cônico e com ponta ativa. Tamanho Longa. Alta rotação.	UND		150	R\$ -	R\$ -
261	Ponta Diamantada Pêra 3168F, Broca autoclavável; Referência da broca: 3168F; Tipo de ponta: Pêra; Granulometria: Fina; Tipo de Broca: Alta Rotação (FG); Diâmetro máximo da parte ativa (Ø ISO): 023; Comprimento da parte ativa: 4,0 mm; Comprimento total: 19,0 mm; Aplicação.	UND		400	R\$ -	R\$ -
262	Broca Carbide Cirúrgica Cônica de Corte Cruzado FG 25mm - Nº 702, ENVOLP C/01 UND, Broca autoclavável; Broca Carbide cônica de corte cruzado; 702, 25mm; Alta rotação (Fg)100% carbide; Sem soldagem.	UND		150	R\$ -	R\$ -
263	Fio Retrator 000, O fio Ultrapak é feito de 100% algodão entrelaçado em milhares de laços minúsculos que formam longas cadeias entrelaçadas; Fio 000 preto e roxo.	UND		96	R\$ -	R\$ -
264	Abridor de Boca Adulto e Infantil - CARACTERÍSTICAS: O instrumento perfeitamente encaixado entre a arcada superior e inferior do paciente promove maior conforto por manter a boca aberta por mais	KIT		60	R\$ -	R\$ -



	tempo, facilitando o desempenho do trabalho do profissional; Possibilita conforto ao paciente; Mantém a boca aberta; Facilita procedimentos odontológicos; Esterilização em Autoclave á 134°C; Cores azul e rosa; Desenvolvido com 100% de silicone. DIMENSÕES: Adulto: 40 x 30 x 20 mm; Infantil: 30x 25x18 mm.				
265	AFASTADOR LABIAL ARCFLEX Tamanho M: Confeccionado em material com força elástica que permite comprimir e deformar o arco para diminuir seu tamanho e facilitar sua introdução na cavidade bucal. Esta mesma força elástica força a abertura das conchas e promove o afastamento dos lábios de forma confortável e segura; Encaixes rápidos: produto totalmente desmontável para facilitar a desinfecção e esterilização; Identificação rápida: as aletas laterais, bem como o controlador de língua possuem identificação do tamanho do produto para que a seleção seja simplificada, além de indicação correta do posicionamento; Esterilizável em autoclave (até 134°C).	UND	60	R\$ -	R\$ -
266	Removedor de Manchas, Embalagem com 1 seringa com 2g + 10 ponteiros para a aplicação + 1 espátula.	UND	180	R\$ -	R\$ -
267	Restaurador Provisório, Embalagem com 25g, Com Flúor, Maleável, fácil manipulação e remoção; Vedação hermética; Não contém eugenol; Manter o pote fechado em local seco e fresco; Validade 24 meses a partir da data de fabricação.	UND	120	R\$ -	R\$ -
268	Ionômero de Vidro Restaurador, Embalagem com 5g de pó + 2,5ml de líquido + 2ml de primer + 2ml de glaze. Tripla Presa Fotopolimerizável, Autopolimerizável E Reação Ácido-Base Do Ionômero De Vidro Polimerização Garantida em Qualquer Situação Clínica, Mesmo Com Ausência De Luz, Aplicação Em Único Incremento: Rapidez, Ideal Para Odontopediatra; Liberação De Flúor: Evita O Aparecimento De Cárie; Adesivo com Nanotecnologia: contém partícula de carga de 5nm que proporciona uma excelente adesão à dentina e ao esmalte; Adesivo com 10% de peso em carga. Devido ao pequeno tamanho da carga, não é necessário agitar o frasco antes do uso; Exclusiva tampa "flip top": evita desperdício e pode ser manuseada apenas com uma mão; Alto rendimento; Aplicações: 36 restaurações.	CX	30	R\$ -	R\$ -
269	Selamento de fóssulas e fissuras, Embalagem com 1g. Libera flúor, Apresenta menor viscosidade, Ambos possuem pontas aplicadoras superfinais em ângulo que facilitam	EMBALAGEM	150	R\$ -	R\$ -



	o controle a extrusão. Bio compatível: A baixa solubilidade do Conseqal f à água minimiza a quebra do selante no meio oral. Altamente Resistente: é composto por 7% de substância submicrons com tamanho de 0.04 micron para suportar o desgaste da superfície; Fotopolimerizável.				
270	Cunha Anatômica de Madeira, Embalagem com 100 unidades. Sortida. As cunhas são feitas de madeira sicômoro, livre de farpas; Estão disponíveis em 5 modelos diferentes codificados por cores; Cunhas anatômicas com excelente acabamento e que não soltam farpas. Menos agressão a gengiva, maior facilidade no procedimento e conforto para o paciente; Otimização formato anatômico ideal com lado côncavo para adaptar-se a morfologia interdental; Cores: Turquesa, laranja, branca, verde e amarela; Validade 2 anos	EMBALAGEM	60	R\$ -	R\$ -
271	Resina Microhíbrida, Cor B2, Composição: BisGMA, TEGDMA, Bisfenol A polietileno glicol diéter dimetacrilato, UDMA, Cerâmica silanizada tratada e sílica tratada de silano; Resina microhíbrida com nanopartículas; Validade: 3 anos; Seringa com 4g	UND	50	R\$ -	R\$ -
272	Escudo Facial Standard Transparente, Embalagem com 1 unidade. Proteção até as orelhas; É fechado na cabeça, protegendo contra aerossóis contaminados suspensos; Ergonômico para uso contínuo sem provocar dores de cabeça; Área de contato lisa e de fácil assepsia; Reutilizável; Visor resistente, protegido e cristal de 0,50mm; Mantém ser fixo à cabeça sem soltar-se com tira de ajuste passível de assepsia e para diferentes tamanhos de cabeça; Dimensões: 31x20x24	UND	35	R\$ -	R\$ -
273	Pedra para Afilar Arkansas, Embalagem com 1 unidade. Dimensões: 10 cm x 2,5 cm x 0,6 cm. Lubrificar a pedra com óleo. Qualidade, durabilidade e eficiência na realização de procedimentos odontológicos; Pedra natural, ao ser extraída pode sair com varias tonalidades.	UND	24	R\$ -	R\$ -
274	Filme Radiográfico, Caixa com 150 unidades. Tamanho 3x4. Compatível com todos os aparelhos de raios-X do mercado, pode ser processado com qualquer químico padrão (revelador e fixador), de maneira manual ou automática. Plástico extra macio, resistente à saliva e desinfetável; Velocidade E; Cor azul; Validade: 2 anos após sua fabricação.	CX	80	R\$ -	R\$ -
275	Fita Para Autoclave; A Fita Autoclave é composta de papel crepado branco; Fácil manuseio; Tinta termoreativa e adesivo á base de borracha natural e resina acrílica;	UND	250	R\$ -	R\$ -



	Dimensões 19mmX30m; Validade: 5 anos.				
276	Lâmina de Bisturi de Aço Carbono Estéril 15; Embalagem com 100 unidades. Lâmina de bisturi descartável de aço carbono. Validade: 5 anos após a data de fabricação.	PCT		15	R\$ - R\$ -
277	Lamina de bisturi nº 12. Embalagem com 100 unidades. Lâmina de bisturi descartável de aço carbono. Validade: 5 anos após a data de fabricação.	PCT		10	R\$ - R\$ -
278	Bobina Papel Grau Cirúrgico 150mm x 100 metros: Bobinas lisas, produzidas em papel grau cirúrgico e filme laminado (Poliéster/Polipropileno); Indicado para esterilização em autoclave a vapor ou óxido de etileno; Permeável ao vapor e ao ar, impermeável a microorganismo, resistentes ao calor, livres de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos; A alta transparência do filme azul permite a visualização do material embalado; Possui selagem tripla Multilínea que proporciona maior segurança ao material esterilizado; Dotado de indicadores químicos que mudam de cor após o processo de esterilização; Possui indicador de sentido correto de abertura na embalagem; Toda a impressão do envelope situa-se na área externa de esterilização evitando assim a migração de tinta ao conteúdo a ser esterilizado; Apresentação em bobinas com 100 metros de comprimento.	UND		100	R\$ - R\$ -
279	Bobina Papel Grau Cirúrgico 200mm x 100 metros: Bobinas lisas, produzidas em papel grau cirúrgico e filme laminado (Poliéster/Polipropileno); Indicado para esterilização em autoclave a vapor ou óxido de etileno; Permeável ao vapor e ao ar, impermeável a microorganismo, resistentes ao calor, livres de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos; A alta transparência do filme azul permite a visualização do material embalado; Possui selagem tripla Multilínea que proporciona maior segurança ao material esterilizado; Dotado de indicadores químicos que mudam de cor após o processo de esterilização; Possui indicador de sentido correto de abertura na embalagem; Toda a impressão do envelope situa-se na área externa de esterilização evitando assim a migração de tinta ao conteúdo a ser esterilizado; Apresentação em bobinas com 100 metros de comprimento.	UND		180	R\$ - R\$ -
280	Bobina Papel Grau Cirúrgico 300mm x 100 metros: Bobinas lisas, produzidas em papel grau cirúrgico e filme laminado	UND		100	R\$ - R\$ -



	<p>(Poliéster/Polipropileno); Indicado para esterilização em autoclave a vapor ou óxido de etileno; Permeável ao vapor e ao ar, impermeável a microorganismo, resistentes ao calor, livres de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos; A alta transparência do filme azul permite a visualização do material embalado; Possui selagem tripla Multilínea que proporciona maior segurança ao material esterilizado; Dotado de indicadores químicos que mudam de cor após o processo de esterilização; Possui indicador de sentido correto de abertura na embalagem; Toda a impressão do envelope situa-se na área externa de esterilização evitando assim a migração de tinta ao conteúdo a ser esterilizado; Apresentação em bobinas com 100 metros de comprimento.</p>			
281	<p>Bobina Papel Grau Cirúrgico 100mm x 100 metros; Bobinas lisas produzidas em papel grau cirúrgico e filme laminado (Poliéster/Polipropileno) indicado para esterilização em autoclave a vapor ou óxido de etileno; Permeável ao vapor e ao ar, impermeável a microorganismo, resistentes ao calor, livres de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos; A alta transparência do filme azul permite a visualização do material embalado; Possui selagem tripla Multilínea que proporciona maior segurança ao material esterilizado; Dotado de indicadores químicos que mudam de cor após o processo de esterilização; Possui indicador de sentido correto de abertura na embalagem; Toda a impressão do envelope situa-se na área externa de esterilização evitando assim a migração de tinta ao conteúdo a ser esterilizado; Apresentação em bobinas com 100 metros de comprimento.</p>	UND	100	R\$ - R\$ -
R\$ -				

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA R\$ _____

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

A PROPOSTA ELETRÔNICA NÃO DEVE CONTER NENHUM TIPO DE IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE, CASO CONTRÁRIO SERÁ DESCLASSIFICADA.

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS - FÍSICA (IMPRESSA)

Deverá ser enviada impressa conforme determina o edital.



(PAPEL TIMBRADO DA PROPONENTE)

Local de Data

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
BOA VIAGEM/CE

Prezados Senhores,

Apresentamos a Vossas Senhorias nossa proposta de preços, conforme planilha abaixo, referente ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2022.03.03.001, cujo objeto é a Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de equipamentos e materiais médico hospitalares, odontológicos, leites e suplementos alimentares para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Boa Viagem/CE conforme especificações em anexo, parte integrante deste processo.

Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento do objeto desta licitação; que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	MARCA	QTD	UNIT	TOTAL
1	Abaixador de língua - Abaixador de língua (espátula de madeira) descartável, formato convencional, liso, superfície e bordas perfeitamente acabadas, espessura e largura uniforme em toda a sua extensão, medindo aproximadamente 14 cm de comprimento, 1,4 cm de largura, 0,5 mm de espessura.	UND		24000	R\$ -	R\$ -
2	Ácido acético 2% glacial 1000ml - Usado na prevenção do câncer ginecológico - detecção de lesões precursoras.	UND		500	R\$ -	R\$ -
3	Água destilada 10ml injetável - Estéril e apirogênica, seu uso objetiva a diluição e solubilização de medicamentos injetáveis.	UND		2400	R\$ -	R\$ -
4	Água oxigenada 10 vol. 1000ml - Antisséptico tópico, utilizado para assepsia de ferimentos e em gargarejos ou bochechos. Cada 10 ml contém: - peróxido de hidrogênio = 3,0g; veículo qsp = 1000ml.	UND		300	R\$ -	R\$ -
5	Agulha descartável 20x5,5 - A agulha hipodérmica descartável foi desenvolvida para aplicação de soluções em diferentes vias injetáveis de administração: endovenosa, intramuscular, subcutânea e intradérmica Possui canhão identificado por código de cores de acordo com a ISO, que permite o acoplamento nas seringas de bico luer slip e luer lock. Cânula com bisel tri facetado em aço inoxidável, siliconada, permitindo um deslize suave e perfeito.cx/ com 100und.	UND		12000	R\$ -	R\$ -
6	Agulha descartável 25x7 - A agulha hipodérmica descartável foi desenvolvida para aplicação de soluções em diferentes vias	UND		12000	R\$ -	R\$ -

PREFEITURA DE BOA VIAGEM

CNPJ Nº 07.963.515/0001-36 | CGF Nº 06.920.307-5

Praça Monsenhor José Cândido, 100 | Centro | Boa Viagem/CE | CEP 63.870-000

Tel.: 88 3427-7001 | E-mail: pmbv_oficial@boaviagem.ce.gov.br | Site: www.boaviagem.ce.gov.br




	injetáveis de administração: endovenosa, intramuscular, subcutânea e intradérmica. Possui canhão identificado por código de cores de acordo com a que permite o acoplamento nas seringas de bico luer slip e luer lock. Cânula com bisel tri facetado em aço inoxidável, siliconada, permitindo um deslize suave e perfeito. cx/ com 100und.				
7	Agulha descartável 25x8 - A agulha hipodérmica descartável foi desenvolvida para aplicação de soluções em diferentes vias injetáveis de administração: endovenosa, intramuscular, subcutânea e intradérmica. Possui canhão identificado por código de cores de acordo com a que permite o acoplamento nas seringas de bico luer slip e luer lock. Cânula com bisel tri facetado em aço inoxidável, siliconada, permitindo um deslize suave e perfeito. cx/ com 100und.	UND	12000	R\$ -	R\$ -
8	Agulha descartável 40x12 - A agulha hipodérmica descartável foi desenvolvida para aplicação de soluções em diferentes vias injetáveis de administração: endovenosa, intramuscular, subcutânea e intradérmica. Possui canhão identificado por código de cores de acordo com a que permite o acoplamento nas seringas de bico luer slip e luer lock. Cânula com bisel tri facetado em aço inoxidável, siliconada, permitindo um deslize suave e perfeito. cx/ com 100und.	UND	12000	R\$ -	R\$ -
9	Agulha descartável p/ insulina 13x4,5 - Agulha hipodérmica descartável 22g 1 1/2 13x0,45mm Desenvolvidas para aplicação de soluções e medicamentos em diferentes vias de administração: endovenosa, intramuscular, intradérmica e subcutânea. Estéril; fabricada em aço inoxidável; possui canhão identificado por código de cores universal.	UND	24000	R\$ -	R\$ -
10	Agulha p/ insulina com caneta curta comprimento 8mm (5/16") Calibre 0,25mm(31g) - Agulha para caneta de aplicação de insulina, Caixa com 100 unidades, Agulha 8mm (5/16") x 0,25mm(31g) Compatível com todas as agulhas Lacre e protetores externos e internos da agulha garantem a esterilidade, Rosca no cone externo, proporciona adaptação e fixação segura na caneta com maior capacidade de penetração, Agulha integralmente siliconada, deslizamento suave e contínuo, reduz a dor e o desconforto.	UND	12000	R\$ -	R\$ -
11	Álcool 70% 1000ml - O álcool líquido 70° de uso geral elaborado especialmente para limpar	UND	15600	R\$ -	R\$ -




	superfícies fixas em geral, como fórmica, plástico, vidro, metais e etc. Atrelado ao seu poder de limpeza, seu poder higienizante e saneante são os diferenciais na eficácia do combate às bactérias e vírus do dia-dia. Embalagem: frasco com 1000 ml.					
12	Álcool absoluto 99,5% 1000ml - Produto para uso profissional, destinado à assistência à saúde, usado em testes laboratoriais e limpeza de superfícies. Álcool absoluto 99,5° INPM embalagem: 1000l	UND	1200	R\$ -	R\$ -	
13	Álcool gel 1 litro - Feito com álcool etílico hidratado a 70, Álcool etílico hidratado 70° INPM higienizante, Antisséptica limpeza uso geral multiuso.	UND	5600	R\$ -	R\$ -	
14	Algodão hidrófilo 500g - O algodão hidrófilo indicado para uso hospitalar, na higienização da pele, em curativos, na absorção de líquidos, limpeza de bebês, assepsia e em procedimentos médicos e dentários.	UND	1700	R\$ -	R\$ -	
15	Atadura de crepom 10x4 cm - Modelo: 13 fios por centímetro quadrado (alta elasticidade) larguras: 10 cm (vide título do anúncio) comprimento: 1,80 metros (padrão ABNT) composição de 90 por cento algodão, 9 por cento poliéster / 1 por cento elastano	UND	21200	R\$ -	R\$ -	
16	Atadura de crepom 15cm - Atadura de crepom 15cm x 1,8m 13 fios. Utilização em terapia compressiva. Aplicações ortopédicas como imobilizações e enfaixamentos. Fixação de curativos. Prevenção de contusões em atividades esportivas.	UND	21200	R\$ -	R\$ -	
17	Atadura de crepom 20x3 cm - Atadura de crepom 20cm x 1,8m 13 fios Utilização em terapia compressiva. Aplicações ortopédicas como imobilizações e enfaixamento. Fixação de curativos. Prevenção de contusões em atividades esportivas	UND	21200	R\$ -	R\$ -	
18	Aspirador Cirúrgico - O Aspirador Cirúrgico é um aparelho eletromecânico que possui como elemento principal uma bomba de vácuo com acionamento elétrico, acoplada a dispositivos mecânicos, que em funcionamento permite gerar uma pressão negativa proporcionando a formação de vácuo no interior de um recipiente, conectado a um tubo de sucção e a entrada da bomba de vácuo.	UND	100	R\$ -	R\$ -	
19	Avental TNTPTCT c/10 - 100% polipropileno, Atóxico, Não estéril, Hipoalérgico, Uso individual e descartável, Uso individual e descartável, TNT semipermeável não é de uso cirúrgico. Tem elástico nos punhos, duas fitas p amarrar atrás, Indicado para área da estética, serviços de saúde, indústria alimentícia, refeitórios e	UND	20000	R\$ -	R\$ -	




	serviços em geral que necessitem de proteção de contato.					
20	Bolsa coletora sistema aberto - Coletor de urina sistema aberto não estéril 2000ml c/100 und. Utilizado para o sistema de coleta de urina de pacientes com incontinência urinaria. Uso adulto	UND		30000	R\$ -	R\$ -
21	Bolsa de colostomia (caixa com 20) - Bolsa de colostomia 4009 com placa integrada. BCDM 003 Caixa com 20 UND com: Adesivo micro poroso, Pré-cortada em 19 mm, Recortável de 25 a 70 mm, Com filtro de carvão ativado (diminui odores), Transparente e opaca, Bolsa transparente com forro de perfurado, Bolsa opaca com forro de TNT. Bolsa com placa integrada (sistema de uma peça). Bolsa drenável (sistema aberto). Fechamento por clipe, Acompanha régua de medida de abertura de estoma, Selo com número do lote	CX		450	R\$ -	R\$ -
22	Bolsa Colostomia e Ileostomia PEDIÁTRICA Peça DRENÁVEL TRANSPARENTE Recorte 10-35mm CX c/100 UND - Bolsa Colostomia e Ileostomia PEDIÁTRICA DRENÁVEL TRANSPARENTE Recorte 10-35mm é indicada para cuidado de estoma em bebês e crianças	CX		350	R\$ -	R\$ -
23	Coletor de urina infantil feminino - Coletor de urina transparente feminino em PEDB indicado para coleta de urina em unidades de saúde. O coletor de urina infantil feminino é confeccionado com abertura no formato elíptico (3,8cm de comprimento x 2,3cm de largura superior x 1,2cm de largura inferior) e possui uma fita adesiva antialérgica garantindo segurança para o usuário. Contém campo para preenchimento de identificação de pacientes. Produto não estéril, atóxico e apirogênico. Possui capacidade de 100ml. O coletor possui tamanho único (17x10cm) e marcações aproximadas com intervalos graduais de 10ml até 100 ml. Atóxico; - adesivo dupla face antialérgico; - capacidade de 100ml; - tamanho único	UND		1500	R\$ -	R\$ -
24	Coletor de urina infantil masculino - Coletor infantil masculino com furo redondo, com fita adesiva dupla face, hipoalérgica, resistente e que não desprende do conjunto, Ação/ativos: composto por saco com comprimento de 17 cm e largura de 10 cm, com um furo pré-cortado e com película protetora não aderente e destacável. A parte adesiva não se desprende do coletor e não deixa resíduo na pele do usuário. Confeccionadas em polietileno de baixa densidade, transparente, atóxico e	UND		1000	R\$ -	R\$ -




	maleável com capacidade para 100ml; com selagem de alta resistência nas bordas assegurando a integridade do saco para que não provoquem lesão ao paciente ou vazamento.				
25	Coletor de urina sistema fechado - Sistema fechado com válvula anti refluxo. Com capacidade para 2000ml e graduada a cada 100ml. Com capacidade para 2000ml e graduada a cada 100ml. Tamanho: altura 29,5 cm e largura 22cm, possui suporte de fixação com haste rígida e com alça cordão. Pinça corta fluxo do tipo clamp. Tubo extensor em PVC de 120cm, transparente, atóxico, flexível e sem efeito memória, conector universal com ajuste para sondas vesicais, com tampa protetora. Esterilizado por óxido de etileno. Esterilizado por óxido de etileno. Produto látex-free	UND	2000	R\$ -	R\$ -
26	Copo p/ escarro - Coletor de universal 80ml, com tampa - esteril, finalidade indicados para coleta de amostras de fezes, urina, escarro e esperma. Sem pá individual.	UND	4000	R\$ -	R\$ -
27	Cuba cirúrgica - Indicado para assepsia. Características: cuba para assepsia em aço inoxidável, dimensões: 9x5cm, capacidade: 200 ml; material: aço inoxidável.	UND	50	R\$ -	R\$ -
28	Cuba rim - Indicações: utilizadas para acondicionamento de medicação, resíduos, soro, álcool iodado, etc. Características: composição do aço: aço-inox 304 (18/8); composição do aço: aço-inox 304 (18/8); cuba rim medindo: 26 x 12 cm - capacidade 740ml.	UND	50	R\$ -	R\$ -
29	Eletrodos - Indicado para eletrocardiograma e monitorização cardíaca em UTI's, procedimentos cirúrgicos, serviços de emergência e testes ergométricos. Procedimentos em hospitais, consultórios, clínicas e laboratórios.	UND	50	R\$ -	R\$ -
30	Equipo macro gotas com rig. P/ soro - Desenvolvido para administração de medicamentos e soluções pela via endovenosa em hospitais e clínicas. Possui a finalidade de entremear a ligação do dispositivo venoso periférico (ligado ao paciente) ao recipiente que contém líquido a ser infundido (que pode ter ou não medicação), fabricado em PVC flexível e incolor; provido de pinça rolete, injetor lateral com membrana auto cicatrizante, câmara gotejadora com dispositivo para entrada de ar com filtro hidrófobo e bacteriológico e filtro de partículas de 15µm; conector luer slip universal; tubo com 1,5m com ponta perfurante e tampa	UND	2000	R\$ -	R\$ -




	protetora; atóxico e apirogênico; descartável e de uso único; estéril.					
31	EQUIPO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL - O Equipamento para nutrição enteral possui ponta perfurante e conector escalonado com conexões universais. Regulador de fluxo, tipo pinça rolete, com excelente precisão no controle do gotejamento e tubo flexível atóxico na cor azul (específico para nutrição enteral)	UND	10000	R\$ -	R\$ -	
32	Escova cervical descartável - Escova descartável cervical não estéril - pacote com 100 unidades, ideal para coleta de material endocervical, sem traumatismos e falsos trajetos, cabo em poliestireno, com eixo sustentável em aço inoxidável, altamente resistente à trações, formato cônico com micro cerdas macias, em nylon.	UND	20000	R\$ -	R\$ -	
33	Esfigmomanômetro c/ estetoscópio adulto Aparelho de pressão esfigmomanômetro com estetoscópio simples para a medição da pressão arterial; braçadeira com manguito em PVC; recomendado para uso doméstico e hospitalar; acompanha estojo para viagem, verificado e aprovado pelo Inmetro; acompanha braçadeira com fecho em velcro.	UND	500	R\$ -	R\$ -	
34	Esfigmomanômetro c/ estetoscópio adulto grande para obeso - Esfigmomanômetro aneróide adulto obeso. O esfigmomanômetro é um equipamento de alta precisão, indicado para a medição da pressão arterial sanguínea. É um aparelho de extrema qualidade e fácil de usar, indispensável no dia-a-dia daquelas pessoas que se preocupam em cuidar da saúde. A pressão arterial é registrada em duas medidas: a mais alta chama-se sistólica (medida quando o coração está bombeando), a mais baixa chama-se diastólica (medida quando o coração está relaxado). Alguns fatores podem causar uma elevação na pressão arterial, como por exemplo, ansiedade, nervosismo, etc. Para prever alguns riscos, deve-se monitorar constantemente os níveis de pressão arterial, pois, deste modo, será possível diagnosticar o mais cedo a hipertensão arterial, que poderá oferecer, sérios riscos à saúde como derrames e ataques cardíacos prematuros. Para a medição da pressão arterial, manômetro de alta precisão com tecnologia japonesa, braçadeira com manguito em PVC (circunferência de 35 até 51 cm, braçadeira grande em nylon com fecho de velcro na cor azul marinho, recomendado para uso doméstico hospitalar. Conteúdo da embalagem: 01 manômetro 0 - 300 mmHg, 01 braçadeira, 01	UND	70	R\$ -	R\$ -	




	válvula de deflação,01 Pêra,01 estojo para viagem,01 esteto.				
35	Esfigmomanômetro c/ estetoscópio infantil - Esfigmomanometro para criança infantil com estetoscópio braçadeira 10 x 18 centímetros.O kit esfigmomanômetro infantil com estetoscópio é indicado para a medição e acompanhamento da pressão arterial sanguínea no ambiente hospitalar, clínicas, triagem de pronto atendimentos, consultórios e no uso residencial. São livres de látex e com excelente durabilidade.É ideal para a monitorização da pressão arterial, arritmia cardíaca e para auscultação de sons cardiorrespiratórios. Extremamente importante no controle da hipertensão e outras doenças do coração e pulmão. Indicado para profissionais da saúde, estudantes e para se ter em casa.	UND	70	R\$ -	R\$ -
36	Esparadrapo 10 x 4,5 cm - Esparadrapo impermeável - branco,esparadrapo de tecido 100% algodão com tratamento acrílico, adesivo branco à base de borracha natural e resina de ótima aderência e extra flexível.Linha hospitalar: 10 cm x 4,5 m flexível,largura 10 cm,comprimento 4,5 m.	UND	12100	R\$ -	R\$ -
37	Espátula de Ayres c/100 - Espátula de ayre de madeira, resistentes, pontas arredondadas, descartáveis utilizadas para coleta de exames ginecológicos, medindo 18 cm de comprimento, embalagem em pacote contendo 100 unidades.	PCT	2000	R\$ -	R\$ -
38	Espéculo descartável tamanho g - O espéculo g vaginal. Com o parafuso inserido, facilitando a realização do exame	UND	7000	R\$ -	R\$ -
39	Espéculo descartável tamanho m - O espéculo m vaginal. Com o parafuso inserido, facilitando a realização do exame	UND	7000	R\$ -	R\$ -
40	Espéculo descartável tamanho p - O espéculovaginal. Com o parafuso inserido, facilitando a realização do exame	UND	7000	R\$ -	R\$ -
41	Éter sulfúrico 1lt - Éter sulfúrico 50% removedor de curativos, acondicionado em frasco. Especificação: acondicionado em frasco de vidro cor âmbar com tampa de rosca. 1 LT	LT	100	R\$ -	R\$ -
42	Fio CATGUT 2.0 - Material: colágeno derivado de gado bovino.Comprimento do fio: 70 cm / 75 cm / 90 cm (agulhado) ou 1,5 m (sem agulha). Diâmetro do fio/número cirúrgico: 2-0,material da agulha: aço inox,descrição da agulha: 3/8 circ. Cilíndrica,indicação:cirurgias em geral; - ginecologia/obstetria; - aparelho digestivo; - urologia; - cirurgias veterinárias.	CX	10	R\$ -	R\$ -
43	Fio CATGUT 3.0 - Material: colágeno derivado de gado bovino.Comprimento do fio: 70 cm / 75	CX	10	R\$ -	R\$ -



	cm / 90 cm (agulhado) ou 1,5 m (sem agulha). Diâmetro do fio/número cirúrgico:3-0;material da agulha: aço inox,descrição da agulha: 3/8 circ. Cilíndrica;indicação:cirurgias em geral; - ginecologia/obstetrícia; - aparelho digestivo; - urologia; - cirurgias veterinárias.				
44	FRASCO PARA DIETA ENTERAL(ETEROFIX) - FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL 300ML,Artigo médico-hospitalar de uso único, não estéril e higiênico, indicado para alimentação enteral para pacientes impossibilitados de deglutir o alimento.O material empregado na fabricação dos frascos e tampas é o polietileno (PE).Os frascos possuem graduação de 10 em 10 ml, facilitando na utilização de pequenos volumes ou de acordo com a necessidade e individualidade do paciente.As tampas possuem membranas perfuráveis, adaptáveis aos equipo de nutrição entera	UND	10000	R\$ -	R\$ -
45	Fita cirúrgicamicroporosa 5 cm x 10 - Fita/micro porosa da hipoalérgica, composta de não tecido a base de fibras de viscose com adesivo acrílico. Isento de látex.	UND	1200	R\$ -	R\$ -
46	Fita p/ autoclave - Utilizada para fechamento de pacotes de papel e de pano que serão esterilizados em autoclave. É um instrumento indicador de que a esterilização foi efetuada em condições ideais de pressão, temperatura e tempo, através da mudança de coloração das listras de cor amarela para a cor preta. 19mm x 30m.	UND	4000	R\$ -	R\$ -
47	Gaze hidrófila em pacote - Gaze compressa de gaze 13 fios 7,5x7,5cm,para curativos, não estéril,pacote c/ 500 unidades,compressa cirúrgica de gaze hidrófila	PCT	12000	R\$ -	R\$ -
48	Gaze hidrófila em rolo - A gaze em rolo, indicada para curativos ou procedimentos operatórios, inclusive no tratamento de queimaduras, devido a sua composição 100% algodão 9 fios.Possui um alto poder de absorção de sangue e outras secreções, procedimentos em geral como higiene, assepsia e curativo além da confecção de gazes vaselinadas ou fracionadas e chumaços de algodão(revestimento). Não estéril. Branqueada e livre de impurezas.	RL	500	R\$ -	R\$ -
49	Gel p/ ultrassom de 5000g - É um gel especialmente recomendado para uso como meio de contato para transmissão ultra-sônica, em aparelhos de ultrassonografia, ecógrafos e dopplers	UND	100	R\$ -	R\$ -
50	Glicerina - Ação hidratante e deslizante;para usos estéticos e em fisioterapia; sensação de	UND	100	R\$ -	R\$ -



	conforto em qualquer temperatura.					
51	Kit p/ aerosol adulto - Micro nebulizador (cabecote, anteparo e recipiente); 01máscara adulto,01tubo de ar 2,5 MTS;01 elástico	UND		100	R\$ -	R\$ -
52	Kit p/ aerosol infantil - Micro nebulizador (cabecote, anteparo e recipiente); 01máscara adulto,01tubo de ar 2,5 MTS;01 elástico	UND		100	R\$ -	R\$ -
53	Lâmina de prevenção ponta fosca 26x76 - Fabricada em vidro especial, com espessura de 1,0 a 1,2 mm,caixa revestida por embalagem plástica selada a vácuo. Contém seda entre as lâminas.	CX		600	R\$ -	R\$ -
54	Lâmina p/ bisturi nº 11 - As lâminas para bisturi descartáveis são indicadas para cortar tecidos do corpo humano durante procedimentos médicos, clínicos e/ou cirúrgicos e outros procedimentos aplicáveis.Especificações do item nome técnico: lâminas de bisturi descartáveis,composição: aço carbono t10,modelo: aço carbono - número 11,método de esterilização: esterilidade garantida por raios gama.	UND		10000	R\$ -	R\$ -
55	Lâmina p/ bisturi nº 15 - As lâminas para bisturi descartáveis são indicadas para cortar tecidos do corpo humano durante procedimentos médicos, clínicos e/ou cirúrgicos e outros procedimentos aplicáveis.Especificações do item,nome técnico: lâminas de bisturi descartáveis,composição: aço carbono t10,modelo: aço carbono - número 15,método de esterilização: esterilidade garantida por raios gama.	UND		10000	R\$ -	R\$ -
56	Lâmina p/ bisturi nº 22 - As lâminas para bisturi descartáveis são indicadas para cortar tecidos do corpo humano durante procedimentos médicos, clínicos e/ou cirúrgicos e outros procedimentos aplicáveis.Especificações do item:nome técnico: lâminas de bisturi descartáveis,composição: aço carbono t10,modelo: aço carbono - número 22,método de esterilização: esterilidade garantida por raios gama.	UND		10000	R\$ -	R\$ -
57	Lâmina para microscópio - Kit 100 lâminas + 100 lamínulas 24 x 24mm para microscopia,As lâminas são ideais para processos de microscopia,Características:lapidada,ponta fosca,embaladas a vácuo,intercaladas com papel lenço com tratamento antifúngico.	CX		150	R\$ -	R\$ -
58	Luva cirúrgica estéril 7.0 - Luva cirúrgica estéril com pó 7.0,desenvolvida para proteção do profissional da saúde em geral durante procedimentos cirúrgicos em geral e procedimento invasivos.Fabricada em látex,estérilestéril,atóxica e apirogênica,com pó	UND		2000	R\$ -	R\$ -



	bioabsorvível, formato anatômico, antiderrapante, aprovada pelo inmetro, aprovada pelo ministério do trabalho (C.A), descartável e de uso único, pares embalados individualmente.					
59	Luva cirúrgica estéril 7.5 - Luva cirúrgica estéril com pó 7.0, desenvolvida para proteção do profissional da saúde em geral durante procedimentos cirúrgicos em geral e procedimento invasivos. Fabricada em látex, estéril, atóxica e apirogênica, com pó bioabsorvível, formato anatômico, antiderrapante, aprovada pelo inmetro, aprovada pelo ministério do trabalho (C.A), descartável e de uso único, pares embalados individualmente.	UND		2000	R\$ -	R\$ -
60	Luva cirúrgica estéril 8.0 - Luva cirúrgica estéril com pó 8.0, desenvolvida para proteção do profissional da saúde em geral durante procedimentos cirúrgicos em geral e procedimento invasivos. Fabricada em látex, estéril, atóxica e apirogênica, com pó bioabsorvível, formato anatômico, antiderrapante, aprovada pelo inmetro, aprovada pelo ministério do trabalho (C.A), descartável e de uso único, pares embalados individualmente.	UND		2000	R\$ -	R\$ -
61	LUVA DE PROCEDIMENTO P G/ 100 UND - Com pó bioabsorvível, superfície lisa, ambidestra, não estéril, Tamanhos pequeno, CX com 100 UND	CX		2000	R\$ -	R\$ -
62	LUVA DE PROCED. XP C/ 100 UND - Com pó bioabsorvível, superfície lisa, ambidestra, não estéril, Tamanhos XP, CX com 100 UND	CX		2000	R\$ -	R\$ -
63	LUVA P/ PROCED. G C/ 100 UND - Com pó bioabsorvível, superfície lisa, ambidestra, não estéril, Tamanhos G, CX com 100 UND	CX		2000	R\$ -	R\$ -
64	LUVA P/ PROCED. M C/ 100 UND - Com pó bioabsorvível, superfície lisa, ambidestra, não estéril, Tamanhos M, CX com 100 UND	CX		2000	R\$ -	R\$ -
65	Máscara descartável C/ 50 UND - Máscara tipo cirúrgica possui clipe nasal para ajuste e segurança, hipoalergênico, antisséptico, isenta de fibra de vidro, sem látex, uso único e descartável, - atóxica e não estéril, especificações: 17,5cm x 9,5cm, pode ser usada em hospitais, laboratórios, clínicas, consultórios dentários e médicos, Indústrias químicas, farmacêuticas e alimentícias, área estética e gastronômica.	CX		14150	R\$ -	R\$ -
66	Máscara n95 (bico de pato) - Máscaras kn95, 5 camadas, n95, pff2, bico de pato.	UND		12200	R\$ -	R\$ -
67	Nylon nº 2.0 c/ agulha 3cm cortante - Fio nylon 2-0 com agulha 3/8 3cm TRG 45cm	CX		120	R\$ -	R\$ -



68	Nylon nº 3.0 c/ agulha 3cm cortante - Fio nylon 3-0 com agulha 3/8 3cm TRG 45cm	CX		120	R\$ -	R\$ -
69	Nylon nº 4.0 c/ agulha 3cm cortante - Fio nylon 4-0 com agulha 3/8 3cm TRG 45cm	CX		120	R\$ -	R\$ -
70	Nylon nº 5.0 c/ agulha 3cm cortante - Fio nylon 5-0 com agulha 3/8 3cm TRG 45cm	CX		120	R\$ -	R\$ -
71	Nylon nº 6.0 c/ agulha 3cm cortante - Fio nylon 6-0 com agulha 3/8 3cm TRG 45cm	CX		120	R\$ -	R\$ -
72	Otoscópio - Otoscópio para diagnósticos médicos, indicado para avaliar tanto a parte interna quanto a parte externa do ouvido.iluminação branca e de alto brilho, com excelente nitidez da imagem.conexão para pera de insuflação, possibilita avaliar a mobilidade da membrana timpânica (pera opcional) espéculos disponíveis em diversos tamanhos e modelos.fácil substituição da lâmpada ou LED,cabo em metal recartilhado para melhor ergonomia e segurança durante o exame, reostato para controle de intensidade da luz.alimentação através de 2 pilhas alcalinas tipo c.não contém latex.	UND		100	R\$ -	R\$ -
73	Óculos de proteção - Óculos de proteção EPI confeccionados em policarbonato óptico, com armação em polipropileno e hastes com 4 posições de regulagem para melhor ajuste.	UND		2000	R\$ -	R\$ -
74	Papel crepado 30x30 c/100 - Produto não estéril, Primeira geração, compatível e resistente as condições físicas de esterilização. Permite penetração e remoção do agente esterilizante, Não gera partículas, seguro e atóxico, repelência a líquidos, Caixa c/500 UND.	CX		500	R\$ -	R\$ -
75	Pinça anatômica para curativo - Pinça anatômica dissecação 16cm. Utilizada para prender e afastar o tecido. Também usada em dissecação. produzido em aço inoxidável. Possui ponta serrilhada.	UND		100	R\$ -	R\$ -
76	Pinça cheron descartável - Auxiliar nos exames ginecológicos (colposcopia), biópsias e coleta de material para o exame preventivo do câncer de colo de útero), exames em cavidades estreitas como o endocérvice e retirada de pólipos.	UND		25000	R\$ -	R\$ -
77	Pinça dente de rato - Pinça anatômica dente de rato 16cm, Pinça com função de promover a fixação dos tecidos durante a divulsão e/ou sutura. Os dentes evitam que a pele escape da pinça.	UND		50	R\$ -	R\$ -
78	Pinça kelly - Pinça kelly reta 14cm é usada para pinçamento (hemostasia). - Produto confeccionado em aço inoxidável aisi-420; - ponta reta, com serrilha.	UND		50	R\$ -	R\$ -
79	Pinça maynihan - Pinça moynihan 20cm para hysterectomia.	UND		50	R\$ -	R\$ -



80	Pinça pean de aço (usada para sonda vesical de demora) - A pinça pean é fabricada em aço inoxidável. Utilizada em procedimentos cirúrgicos para travar vasos sanguíneos. Ainda tem função de prender gazes para a realização de antissepsia.	UND	50	R\$ -	R\$ -
81	Preservativo masculino sem lubrificante - Preservativo masculino não lubrificado destina-se a recobrir as sondas de aparelhos de ultrassonografia transvaginal, Esse procedimento reduz a propagação de doenças infecciosas entre as pacientes que fazem seu uso. Proteção total para procedimentos médicos.	UND	3000	R\$ -	R\$ -
82	Preservativo masculino com lubrificante - Indicado como método contraceptivo	UND	30000	R\$ -	R\$ -
83	PVPI degermante 1000ml - PVPI degermante odopolividona degermante solução a 10% é um antisséptico indicado para antissepsia da pele, mãos e antebraços	UND	100	R\$ -	R\$ -
84	PVPI tópico 10% 1000ml - PVPI solução com tensoativos ou degermante é um antisséptico à base de PVPI solução com tensoativos ou degermante é um antisséptico à base de antissepsia das mãos e antebraços da equipe cirúrgica e descontaminação do campo operatório.	UND	2000	R\$ -	R\$ -
85	Propes p.c. C/100 - As sapatilhas propé descartáveis são fabricadas em 100% polipropileno atóxico, no tipo soldado, com acabamento em elástico na borda superior que permite melhor fixação no pé do usuário. Possui a finalidade de cobrir e envolver o calçado em ambientes hospitalares, ambulatoriais e clínicas médicas, evitando o desprendimento de partículas de sujeira em áreas especiais e restritas que tenham a necessidade de total controle sobre a higienização, visando a prevenção de infecção hospitalar durante os procedimentos cirúrgicos diversos. A caixa acompanha 100 unidades, com a gramatura 20, sendo descartável, de uso único e individual.	UND	1000	R\$ -	R\$ -
86	Protetor facial - O protetor facial é um equipamento de proteção individual, ajustável e reutilizável. Evita o contato com gotículas, salive e fluidos nasais que possam atingir o rosto, o nariz, a boca e os olhos prevenindo o contágio e outras contaminações. Oferece proteção e conforto aliados a um design moderno facilitando a conversação e entendimento de forma clara, sem causar ruídos no som da voz.	UND	300	R\$ -	R\$ -
87	Sabão líquido neutro 1000ml - Produto ideal para limpeza da pele. Retira sujeiras e outros	UND	500	R\$ -	R\$ -



	resíduos. Com sua fórmula balanceada, possui PH neutro e componentes suaves que não irritam a pele, podendo ser utilizado também por profissionais da saúde.					
88	Saco coletor sistema aberto - Produto destinado ao controle de fluxo de drenagem, quando se requer um controle aproximado na diurese do paciente. Não estéril.	UND		30000	R\$ -	R\$ -
89	Scalp nº 19 - Scalp número 19 caixa com 100und. Descrição: estéril,fabricado em aço inoxidável e PVC,tubo translúcido com 30 cm. De comprimento possui asas que auxiliam a venipuntura coloridas que identificam os calibres atóxico e apirogênico, Descartável e de uso único.	UND		1200	R\$ -	R\$ -
90	Scalp nº 21 - Scalp número 21 caixa com 100und. Descrição: estéril,fabricado em aço inoxidável e PVC,tubo translúcido com 30 cm. De comprimento possui asas que auxiliam a venipuntura coloridas que identificam os calibres, atóxico e apirogênico, Descartável e de uso único.	UND		5000	R\$ -	R\$ -
91	Scalp nº 23 - Scalp número 23 caixa com 100und. Descrição: estéril,fabricado em aço inoxidável e PVC,tubo TRANslúcido com 30 cm. De comprimento possui asas que auxiliam a venipuntura coloridas que identificam os calibres, atóxico e apirogênico, Descartável e de uso único.	UND		5000	R\$ -	R\$ -
92	Scalp nº 25 - Scalp número 25 caixa com 100und. Descrição: estéril,fabricado em aço inoxidável e PVC tubo TRANslúcido com 30 cm. De comprimento possui asas que auxiliam a venipuntura coloridas que identificam os calibres, atóxico e apirogênico, Descartável e de uso único.	UND		5000	R\$ -	R\$ -
93	Scalp nº 27 - Scalp número 25 caixa com 100und.Descrição: estéril,fabricado em aço inoxidável e PVC,tubo TRANslúcido com 30 cm. De comprimento possui asas que auxiliam a venipuntura coloridas que identificam os calibres, atóxico e apirogênico, Descartável e de uso único.	UND		5000	R\$ -	R\$ -
94	Seringa descartável 01 ml insulina c/ medidor - Seringa de insulina 1 ml com agulha 8 x 0,30mm. A seringa de insulina 1 ml foi desenvolvida para aplicação de insulina em pacientes portadores de diabetes pela via subcutânea em clínicas, hospitais, laboratórios, farmácias e domicílios.	UND		10000	R\$ -	R\$ -
95	Seringa descartável - 03 ml c/ agulha - Seringa descartável 03 ml com agulha 25 x 7 bicos slip. Detalhes do produto: seringa de uso único,	UND		20000	R\$ -	R\$ -




COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 650
e

	corpo lubrificado, com escala externa precisa e visível. Possui formato anatômico para apoio dos dedos, vem com anel de retenção de borracha que evita a entrada de ar. Para segurança é embalada individualmente, a selagem garante a integridade e a esterilização do produto. A seringa é destinada a infusão e coleta de líquidos em procedimentos médico-hospitalares e injeção de líquidos. seringa de uso único, corpo lubrificado, com escala externa precisa e visível. Possui formato anatômico para apoio dos dedos, vem com anel de retenção de borracha que evita a entrada de ar. Para segurança é embalada individualmente, a selagem garante a integridade e a esterilização do produto. A seringa é destinada a infusão e coleta de líquidos em procedimentos médico-hospitalares e injeção de líquidos.					
96	Seringa descartável - 05 ml sem agulha - Utilizada para inserir substâncias líquidas por via intravenosa, intramuscular, intra-cardíaca, subcutânea, intradérmica, intra-articular; retirar sangue; ou ainda, realizar uma punção aspirativa em um paciente.	UND	20000	R\$ -	R\$ -	
97	Seringa descartável - 10 ml sem agulha - Utilizada para inserir substâncias líquidas por via intravenosa, intramuscular, intra-cardíaca, subcutânea, intradérmica, intra-articular; retirar sangue; ou ainda, realizar uma punção aspirativa em um paciente.	UND	20000	R\$ -	R\$ -	
98	Seringa descartável - 20 ml sem agulha - Utilizada para inserir substâncias líquidas por via intravenosa, intramuscular, intra-cardíaca, subcutânea, intradérmica, intra-articular; retirar sangue; ou ainda, realizar uma punção aspirativa em um paciente.	UND	20000	R\$ -	R\$ -	
99	Solução de Iugol 2,0 % 1000ml - Solução para teste colposcópico para pesquisa de células displásicas ou carcinomatosas de colo uterino, servindo como diagnóstico de neoplasias uterinas.	UND	600	R\$ -	R\$ -	
100	Sonda de aspiração traqueal nº 10 - Indicado aos pacientes impossibilitados de eliminar as secreções do pulmão	UND	24000	R\$ -	R\$ -	
101	Sonda de aspiração traqueal nº 12 - Indicado aos pacientes impossibilitados de eliminar as secreções do pulmão	UND	24000	R\$ -	R\$ -	
102	Sonda de aspiração traqueal nº 04 - Indicado aos pacientes impossibilitados de eliminar as secreções do pulmão	UND	12000	R\$ -	R\$ -	
103	Sonda de aspiração traqueal nº 06 - Indicado aos pacientes impossibilitados de eliminar as secreções do pulmão	UND	12000	R\$ -	R\$ -	
104	Sonda de aspiração traqueal nº 08 - Indicado	UND	12000	R\$ -	R\$ -	



COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 651
0


	aos pacientes impossibilitados de eliminar as secreções do pulmão					
105	Sonda de aspiração traqueal nº 06 - Indicado aos pacientes impossibilitados de eliminar as secreções do pulmão	UND		12000	R\$ -	R\$ -
106	Sonda de aspiração traqueal nº 16 - Indicado aos pacientes impossibilitados de eliminar as secreções do pulmão	UND		12000	R\$ -	R\$ -
107	Sonda de aspiração traqueal nº 18 - Indicado aos pacientes impossibilitados de eliminar as secreções do pulmão	UND		12000	R\$ -	R\$ -
108	Sonda de aspiração traqueal nº 22 - Indicado aos pacientes impossibilitados de eliminar as secreções do pulmão	UND		12000	R\$ -	R\$ -
109	Sonda de aspiração traqueal nº 20 - Indicado aos pacientes impossibilitados de eliminar as secreções do pulmão	UND		12000	R\$ -	R\$ -
110	Sonda de aspiração traqueal nº 24 - Indicado aos pacientes impossibilitados de eliminar as secreções do pulmão	UND		12000	R\$ -	R\$ -
111	Sonda de foley nº 10 de 02 vias c/10 - A sonda foley é utilizada para procedimentos de drenagem no canal da uretra, permitindo o esvaziamento da urina que está na bexiga.	CX		150	R\$ -	R\$ -
112	Sonda de foley nº 12 de 02 vias c/10 - A sonda foley é utilizada para procedimentos de drenagem no canal da uretra, permitindo o esvaziamento da urina que está na bexiga.	CX		150	R\$ -	R\$ -
113	Sonda de foley nº 14 de 02 vias c/10 - A sonda foley é utilizada para procedimentos de drenagem no canal da uretra, permitindo o esvaziamento da urina que está na bexiga.	CX		150	R\$ -	R\$ -
114	Sonda de foley nº 16 de 02 vias c/10 - A sonda foley é utilizada para procedimentos de drenagem no canal da uretra, permitindo o esvaziamento da urina que está na bexiga.	CX		150	R\$ -	R\$ -
115	Sonda de foley nº 18 de 02 vias c/10 - A sonda foley é utilizada para procedimentos de drenagem no canal da uretra, permitindo o esvaziamento da urina que está na bexiga.	CX		150	R\$ -	R\$ -
116	Sonda de foley nº 20 de 02 vias c/10 - A sonda foley é utilizada para procedimentos de drenagem no canal da uretra, permitindo o esvaziamento da urina que está na bexiga.	CX		150	R\$ -	R\$ -
117	Sonda de foley nº 22 de 02 vias c/10 - A sonda foley é utilizada para procedimentos de drenagem no canal da uretra, permitindo o esvaziamento da urina que está na bexiga.	CX		150	R\$ -	R\$ -
118	Sonda nasogástrica nº 06 longa - A sonda é usada para remover líquidos e gases do trato gastrointestinal superior em adultos, obter uma amostra do conteúdo gástrico para estudos laboratoriais e administrar alimentos e medicamentos diretamente no trato	UND		2000	R\$ -	R\$ -



	gastrintestina.					
119	Sonda nasogástrica nº 14 longa - A sonda é usada para remover líquidos e gases do trato gastrintestinal superior em adultos, obter uma amostra do conteúdo gástrico para estudos laboratoriais e administrar alimentos e medicamentos diretamente no trato gastrintestinal.	UND	2000	R\$ -	R\$ -	
120	Sonda nasogástrica nº 16 longa - A sonda é usada para remover líquidos e gases do trato gastrintestinal superior em adultos, obter uma amostra do conteúdo gástrico para estudos laboratoriais e administrar alimentos e medicamentos diretamente no trato gastrintestinal.	UND	2000	R\$ -	R\$ -	
121	Sonda uretral nº 10 - Indicado quando ocorre a obstrução do trato urinário ou quando o paciente é incapaz de urinar e no pós-cirúrgico para drenar a urina retida ou promover uma forma de monitorizar o débito urinário horário em pacientes em estado crítico.	UND	2000	R\$ -	R\$ -	
122	Sonda uretral nº 12 - Indicado quando ocorre a obstrução do trato urinário ou quando o paciente é incapaz de urinar e no pós-cirúrgico para drenar a urina retida ou promover uma forma de monitorizar o débito urinário horário em pacientes em estado crítico.	UND	25000	R\$ -	R\$ -	
123	Sonda uretral nº 14 - Indicado quando ocorre a obstrução do trato urinário ou quando o paciente é incapaz de urinar e no pós-cirúrgico para drenar a urina retida ou promover uma forma de monitorizar o débito urinário horário em pacientes em estado crítico.	UND	24000	R\$ -	R\$ -	
124	Sonda uretral nº 06 - Indicado quando ocorre a obstrução do trato urinário ou quando o paciente é incapaz de urinar e no pós-cirúrgico para drenar a urina retida ou promover uma forma de monitorizar o débito urinário horário em pacientes em estado crítico.	UND	24000	R\$ -	R\$ -	
125	FISIOLOGICO 0,9 10 ML CX 200 UND - Solução Injetável, Cloreto de Sódio 0,9%; também utilizado para inalação, limpeza de pele e outros fins.	UND	2000	R\$ -	R\$ -	
126	SONDA GTT N ° 12 - Solução Injetável, Cloreto de Sódio 0,9%; também utilizado para inalação, limpeza de pele e outros fins.	UND	20	R\$ -	R\$ -	
127	SONDA GTT N ° 14 - Solução Injetável, Cloreto de Sódio 0,9%; também utilizado para inalação, limpeza de pele e outros fins.	UND	20	R\$ -	R\$ -	
128	SONDA GTT N° 16 - Solução Injetável, Cloreto de Sódio 0,9%; também utilizado para inalação, limpeza de pele e outros fins.	UND	20	R\$ -	R\$ -	
129	SONDA GTT N ° 18 - Solução Injetável, Cloreto de Sódio 0,9%; também utilizado para inalação,	UND	20	R\$ -	R\$ -	




	limpeza de pele e outros fins.					
130	SONDA GTT N ° 20 - Solução Injetável, Cloreto de Sódio 0,9%; também utilizado para inalação, limpeza de pele e outros fins.	UND		20	R\$ -	R\$ -
131	SONDA GTT N ° 22 - Solução Injetável, Cloreto de Sódio 0,9%; também utilizado para inalação, limpeza de pele e outros fins.	UND		20	R\$ -	R\$ -
132	SONDA GTT N ° 24 - Solução Injetável, Cloreto de Sódio 0,9%; também utilizado para inalação, limpeza de pele e outros fins.	UND		20	R\$ -	R\$ -
133	Termômetro clínico digital - Indicado para medir a temperatura e suas variações em situações patológicas. Funciona por contato direto com a pele, utilizando a ponta do sensor para medição.	UND		50	R\$ -	R\$ -
134	Termômetro digital para geladeira - Indicado para medir a temperatura de ambiente, como balcões frigoríficos, câmaras frias, adegas, armários, gabinetes, terrários, chocadeiras, depósitos, armazéns, escritórios, veículos, estufas, piscinas, aquários, e outras superfícies ou espaços relacionados.	UND		50	R\$ -	R\$ -
135	Termômetro interno para geladeira - Para ambientes que precisam ter uma certa regularidade em suas temperaturas, o termômetro para freezer ou geladeira ganha destaque por medir condições térmicas em qualquer espaço fechado, sendo um dos mais usados nessas especificações.	UND		50	R\$ -	R\$ -
136	Touca descartável PCT C/100 - Touca sanfonada descartável TNT branca 10g com 100 unidades segurança e higiene tanto para o profissional quanto para o paciente.	PCT		8000	R\$ -	R\$ -
137	Tubo de látex com 15m (garrote) - Os tubos de látex são indicados para procedimentos cirúrgicos e não cirúrgicos. Ação/ativos: os tubos de látex são utilizados principalmente como extensores de passagens para procedimentos de aspirações de fluidos. 100% látex liso e não estéril.	UND		50	R\$ -	R\$ -
138	Kit 10 Macacão Impermeável Proteção - Tecido: TNT Sintético, 100% Polipropileno, Atóxico (não tecido de polipropileno laminado com película impermeável) - Tecido Impermeável que repele líquido e fluidos corporais, Gramatura: Entre 45gm- b2 e 50gm-b2; Produzido de acordo com a ABNT; Manga com punho em elástico; Fechamento frontal fácil por contato; Ajuste do capuz por amarração; Tamanho p	UND		100	R\$ -	R\$ -
139	Kit 10 Macacão Impermeável Proteção - Tecido: TNT Sintético, 100% Polipropileno, Atóxico (não tecido de polipropileno laminado com película impermeável) - Tecido Impermeável que repele líquido e fluidos corporais, Gramatura: Entre	UND		100	R\$ -	R\$ -




	45gm- b2 e 50gm-b2; Produzido de acordo com a ABNT; Manga com punho em elástico; Fechamento frontal fácil por contato; Ajuste do capuz por amarração; Tamanho M				
140	Kit 10 Macacão Impermeável Proteção - Tecido: TNT Sintético, 100% Polipropileno, Atóxico (não tecido de polipropileno laminado com película impermeável) - Tecido Impermeável que repele líquido e fluidos corporais, Gramatura: Entre 45gm- b2 e 50gm-b2; Produzido de acordo com a ABNT; Manga com punho em elástico; Fechamento frontal fácil por contato; Ajuste do capuz por amarração; Tamanho G	UND	120	R\$ -	R\$ -
141	Suplementos para alimentação enteral adulto/idoso - Fórmula de dieta enteral 1,2 kcal dieta enteral líquida nutricionalmente completa, polimérica, isenta de sacarose, lactose e glúten, com 1,2 kcal/ml e 4,0 a 4,5 gramas de proteína a cada 100 ml. osmolaridade de 230 a 360 mosm/kg de água (sistema aberto) deve atingir 100% da idr em 1400 ml de dieta. apresentação em embalagem com 1 litro. Enteral classificação fórmula dieta enteral 1,2 kcal.	FRASCOS	1200	R\$ -	R\$ -
142	Suplementos para alimentação enteral adulto/idoso Dieta enteral líquida nutricionalmente completa, polimérica, isenta de sacarose, lactose e glúten, com 1,5 kcal/ml e 5,6 a 6,5 gramas de proteína 100 ml de dieta. osmolalidade de 320 a 630 mosmkg de água. sistema aberto. embalagem de 1 litro.	FRASCOS	1200	R\$ -	R\$ -
143	Suplementos para alimentação enteral adulto/idoso - Utilizado na nutrição de pacientes com diabetes ou intolerância a glicose. Nutri Diabetic 1.0 pode ser usado em nutrição oral ou enteral. Dieta para situações metabólicas especiais, disponível no sabor de baunilha e embalagem 1L. Normocalórica (1,0 Kcal/ml), hiperlipídica (46%), normoprotéica (15%) e hipoglicídica (39%), à base de proteína de origem animal, com 16g de fibras por litro de dieta (70% solúveis e 30% insolúveis) e enriquecido com Carnitina e Taurina. Além disso, proporciona uma dieta com uma mistura de carboidratos e fibras que proporcionam absorção lenta, auxiliando no controle da resposta glicêmica. Indicado para Diabetes Tipo I e II, Diabetes Gestacional, Síndrome Metabólica, Intolerância a Glicose. Isento de sacarose, lactose e glúten.	FRASCOS	1200	R\$ -	R\$ -
144	Suplementos para alimentação enteral infantil - Fórmula infantil para lactentes e de seguimento para lactentes e crianças de primeira infância destinada a necessidades dietoterápicas específicas com 1kcal/ml. Infatrini é uma	LATA	1200	R\$ -	R\$ -





	<p>fórmula polimérica, hipercalórica e nutricionalmente completa indicada para alimentação oral ou enteral de lactentes e crianças de primeira infância. Infatrini é adicionado de LCPufas (ARA/DHA), nucleotídeos, beta-caroteno e prebióticos (GOS/FOS). Indicado Cardiopatias congênitas, fibrose cística, insuficiência respiratória, déficit pondero-estatural ou desaceleração do crescimento, pré e pós operatório, aceitação oral insuficiente, restrição hídrica, intolerância a aumento de volume. Crianças de 0 a 3 anos de idade. Não contém glúten. Não contém sacarose.</p>				
145	<p>Suplementos para alimentação enteral infantil - Fórmula pediátrica para nutrição enteral ou oral para crianças, em pó nutricionalmente completa e rica em vitaminas e minerais. Permite preparo nas diluições 1,0kcal/ml, 1,25kcal/ml e 1,5kcal/ml. Indicações: Crianças em risco nutricional, desnutridas ou com desaceleração do crescimento, com doenças crônicas (ex. fibrose cística, cardiopatias, doença celíaca, câncer, etc), anorexia, estomatite, restrição hídrica, em pré ou pós operatório. Não contém glúten. Não contém lactose.</p>	LATA	1200	R\$ -	R\$ -
146	<p>Suplementos para alimentação enteral infantil - Fórmula infantil elementar para lactentes e de seguimento para lactentes e crianças de primeira infância para necessidades dietoterápicas específicas, nutricionalmente completa e isenta de proteína láctea, lactose, sacarose, frutose, galactose e ingredientes de origem animal. Contém aminoácidos livres e sintéticos, xarope de glicose, óleos vegetais e TCM. Adicionada de LCPufas (ARA e DHA) e nucleotídeos. Atendendo a todas as legislações pertinentes. Alergia alimentar (ao leite de vaca, à soja, a hidrolisados e a múltiplas proteínas). Lactentes e crianças de primeira infância, até 36 meses de vida. Não contém glúten. Não contém sacarose. Não contém lactose.</p>	LATA	3000	R\$ -	R\$ -
147	<p>Suplementos para alimentação infantil - Fórmula pediátrica para nutrição enteral e oral em pó, nutricionalmente completa, normocalórica (1,0kcal/ml) com alto teor de vitaminas e minerais, fonte de fibras e sem adição de sacarose. Crianças com dificuldades alimentares, caracterizada por deficiência no consumo de qualidade, quantidade e/ou variedade de alimentos, que possam se beneficiar com uma complementação alimentar. Crianças menores de 10 anos. Não contém</p>	LATA	1200	R\$ -	R\$ -




148	glúten. Sem adição de sacarose. Suplementos para alimentação infantil - Alimento para Situações Metabólicas Especiais para Nutrição Enteral/ Oral, sabor artificial de baunilha formulado para portadores de alergia às proteínas do leite de vaca. É indicado para crianças de 3 a 10 anos de idade, portadores de alergias a proteína do leite de vaca. Não contém glúten. Contém Fenilalanina.	LATA	1200	R\$ -	R\$ -
149	Fórmula infantil de partida e segmento em pó - Fórmula infantil de partida e segmento em pó, a base de proteínas lácteas intactas, adicionada de Exclusivos Prebióticos Danone Nutricia 0,8g/100ml de scGOS/lcFOS (9:1). Contém adequada relação ômega 6: ômega 3 e presença de LCPUFAs (DHA e ARA) além da presença de nucleotídeos. Teor de vitaminas A e C e dos minerais Ferro e Zinco adaptados aos achados do Estudo Nutriplanet - Brasil. Alimentação de lactentes desde o nascimento até os 6 meses de vida. Não contém glúten. Não contém sacarose.	LATA	1200	R\$ -	R\$ -
150	Fórmula infantil de partida e segmento em pó - Fórmula infantil sem lactose para pessoas com restrição lactose. 400g Fórmula infantil sem lactose, destinada a necessidades dietoterápicas específicas com restrição de lactose. Com prebióticos, DHA e ARA e nucleotídeos. Não contém Glúten.	LATA	2000	R\$ -	R\$ -
151	Fórmula infantil de partida e segmento em pó - Dieta semi-elementar e hipoalergênica Lata 400g para crianças desde o nascimento com distúrbios da digestão e absorção de nutrientes ou alergias alimentares. Contém proteína extensamente hidrolisada do soro de leite (100%), 100% de maltodextrina e as gorduras são compostas por óleos vegetais, tcm e óleo de peixe. Isento de lactose, galactose, sacarose, frutose e glúten. Isenta de aminoácidos livres.	LATA	1200	R\$ -	R\$ -
152	Fórmula infantil de partida e segmento em pó - Fórmula extensamente hidrolisada e hipoalergênica lata 450g Melhora os sintomas associados à alergia à proteína do leite de vaca (APLV), ou seja, eczema, cólicas, vômitos, diarreia e obstipação. Contém lactose, é nutricionalmente completa e concebida para se assemelhar à composição do leite materno e às fórmulas infantis normais, o que permite um crescimento e desenvolvimento normal. Adequada a partir do nascimento, o sabor e palatabilidade facilitam a sua utilização para o tratamento a longo prazo da alergia à proteína do leite de vaca.	LATA	1200	R\$ -	R\$ -



COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 657
0

153	Suplementos para alimentação infantil - Fórmula infantil para lactentes e de seguimento - Lata 400g para lactentes e crianças de primeira infância destinada a necessidades dietoterápicas específicas com restrição de lactose e à base de aminoácidos. Com DHA e ARA. Recomendado para lactentes e crianças de primeira infância, 0-36 meses de idade. Fórmula infantil constituída 100% de aminoácidos livres com TCM, β -Palmitatos, DHA e ARA, sem adição de lactose. Para lactentes e crianças de primeira infância com alergia a múltiplos alimentos ou alergia a hidrolisados proteicos com comprometimento do trato gastrointestinal. 10% de proteínas (100% aminoácidos livres) 45% de carboidrato (88,4% xarope de milho, 10,2% amido de batata, 1,4% maltodextrina) 45% de gorduras (25% TCM, 22% óleo de girassol de alto teor oleico, 20% óleo de canola, 16% óleo de girassol, 10% oleína de palma, 6% ésteres de mono e diglicérides de ácidos graxos com citroco, 0,5% óleo de C. conhil rico em DHA, 0,5% óleo de M. alpina rico em ARA). Lactose 0g/100mL. Sem sabor. Não contém glúten.	LATA	1200	R\$ -	R\$ -
154	Bandeja Clínica - Média. Dimensões: 23cm x 13cm. Aço inox. Autoclavável.	UND	180	R\$ -	R\$ -
155	Sonda Exploradora N°5 - Embalagem com 1 unidade. Cabo fino, (n° 5). Aço Immunity. Autoclavável. Validade Indeterminada.	UND	200	R\$ -	R\$ -
156	Cabo Para Espelho Bucal; Aço inox. Autoclavável. Tamanho mínimo: 13 cm.	UND	190	R\$ -	R\$ -
157	Sonda North Carolina; Aço inox; Cabo oco de 8mm. Marcação a laser; Marcação até 15mm; Embalagem com 1 unidade.	UND	130	R\$ -	R\$ -
158	Pinça Clínica Para Algodão; Aço inoxidável. Autoclavável. Embalagem com 1 unidade.	UND	190	R\$ -	R\$ -
159	Seringa Carpulê Com Refluxo; Fabricada em aço inoxidável. Utilizada para aplicação de anestésias. Garantia de 10 anos contra defeito de fabricação comprovado. Tamanho mínimo: 12,5 cm. Embalagem com 1 unidade.	UND	230	R\$ -	R\$ -
160	Contra Ângulo Intra T10 1:1; Unidade. Latch Type (Trava). Fixação da broca: Através de trava (lâmina). Spray único externo: Direcionado para a ponta da broca. Corpo confeccionado em alumínio anodizado: Peso reduzido. Possui camadas de anodização dura, garantindo resistência aos processos de autoclavagem. Cabeça em liga metálica de cobre e zinco: Maior resistência mecânica a impactos, como quedas ou batidas. Rotação: Até 20.000 rpm. Autoclaváveis até 135°C. Cor Prata acetinado. Acoplamento: Intra (universal),	UND	15	R\$ -	R\$ -



	com giro de 360 graus. Rotação: 5.000 a 20.000 rpm. Relação de transmissão: 1:1. Baixa Rotação. Brocas: Haste tipo 1 AR Standard.					
161	Avental de Borracha Plumbífera Adulto com Protetor de Tireóide, Tamanho 76x60cm; Acabamento em corino	UND		3	R\$ -	R\$ -
162	Avental de Borracha Plumbífera Infantil c/ Protetor de Tireóide, Tamanho 60x50cm com 0,25mm pb; Acabamento em corino.	UND		3	R\$ -	R\$ -
163	Câmara Escura c/ Iluminação; Ângulagem para entrada das mãos, tornando fácil o acesso às cubas, evitando o mau posicionamento do operador; Design moderno com caixa moldada em polipropileno (PP); Fácil remoção das luvas para assepsia; Base removível, facilitando coleta de resíduos, limpeza e desinfecção; Possui alojamento para os recipientes que contém líquido evitando que os mesmos fiquem soltos; Visor acrílico destacável, com ótima transparência e total filtragem da luz; Luz com fio composta de LED, proporcionando luminosidade no interior do gabinete de revelação sem danificar a película radiográfica; Permite a visualização no interior possibilitando acompanhamento visual da revelação. Não utiliza energia elétrica; Dimensões mínimas: 230mm (altura), 340mm (comprimento) e 230mm (largura); Corrente: 40 MA; Luz Led: 6000 candela; Bateria: 9 V. Acompanha 4 reservatórios para líquido (água, removedor, fixador e água).	UND		4	R\$ -	R\$ -
164	FÓRCEPS Nº 150-ADULTO; Embalagem c/ 1 unidade, Aço inox; Autoclavável; 18 cm de comprimento.	UND		80	R\$ -	R\$ -
165	FÓRCEPS Nº 151-ADULTO; Embalagem c/ 1 unidade, Aço inox; Autoclavável; 18 cm de comprimento.	UND		80	R\$ -	R\$ -
166	Fórceps Adulto Nº 18L - Mol. Superiores Lado Esquerdo, Embalagem c/ 1 unidade, Aço inox; Autoclavável;	UND		80	R\$ -	R\$ -
167	Fórceps Adulto Nº 18R - Mol. Superiores Lado Direito, Embalagem c/ 1 unidade, Aço inox; Autoclavável;	UND		80	R\$ -	R\$ -
168	Fórceps Adulto Nº 17 - Mol. Inferiores; Embalagem c/ 1 unidade, Aço inox; Autoclavável;	UND		95	R\$ -	R\$ -
169	Fórceps Adulto Nº 16 - Mol. Inferiores; Embalagem c/ 1 unidade, Aço inox; Autoclavável;	UND		90	R\$ -	R\$ -
170	Fórceps Adulto Nº 69 - Mol. Inferiores; Embalagem c/ 1 unidade, Aço inox; Autoclavável;	UND		45	R\$ -	R\$ -
171	Fórceps Adulto Nº 65 - Mol. Inferiores;	UND		40	R\$ -	R\$ -




	Embalagem c/ 1 unidade, Aço inox; Autoclavável;					
172	Fórceps Infantil Nº 150; Embalagem c/ 1 unidade, Aço inox; Autoclavável;	UND		60	R\$ -	R\$ -
173	Fórceps Infantil Nº 151; Embalagem c/ 1 unidade, Aço inox; Autoclavável;	UND		55	R\$ -	R\$ -
174	Fórceps Infantil Nº 18L - Molares Superiores Lado Esquerdo; Embalagem c/ 1 unidade, Aço inox; Autoclavável;	UND		20	R\$ -	R\$ -
175	Fórceps Infantil Nº 18L - Molares Superiores Lado Direito; Embalagem c/ 1 unidade, Aço inox; Autoclavável;	UND		20	R\$ -	R\$ -
176	Fórceps Infantil Nº 44; Molares Superiores Lado Direito; Embalagem c/ 1 unidade, Aço inox; Autoclavável;	UND		20	R\$ -	R\$ -
177	Alavanca Seldin Adulto Número 02 (RETA); Embalagem c/ 1 unidade, Aço inox; Autoclavável;	UND		190	R\$ -	R\$ -
178	Alavanca Seldin Adulto (Nº 1L Esquerda); Também conhecida como alavanca "Bandeirinha"; Embalagem c/ 1 unidade, Aço inox; Autoclavável;	UND		65	R\$ -	R\$ -
179	Alavanca Seldin Adulto (Nº 1R Direita); Também conhecida como alavanca "Bandeirinha"; Embalagem c/ 1 unidade, Aço inox; Autoclavável;	UND		65	R\$ -	R\$ -
180	AlveólotoMoLuer Goiva Curva; Aço inox; Autoclavável, Tamanho: 16cm. (Também conhecida como Pinça Goiva.)	UND		38	R\$ -	R\$ -
181	Jogo Alavancas Aplicais 3 Peças, Adulto (Reta, Direita e Esquerda). Aço inox, Autoclavável. Instrumentos de cabo grosso. Possuem lâminas afiadas (retas e anguladas) finas e côncavas.	UND		50	R\$ -	R\$ -
182	Porta Agulha MayoHegar 16cm; Aço inox; Autoclavável.	UND		135	R\$ -	R\$ -
183	Pinça Halstead Mosquito Curva 12,5cm; Aço inox; Autoclavável.	UND		45	R\$ -	R\$ -
184	Cabo p/ Bisturi Nº 3; Aço inox; Autoclavável; Cabo de chapa para lâmina nº 3. Cabo de chapa para lâminas 11/12/15 e 15c;	UND		70	R\$ -	R\$ -
185	AFASTADOR MINESSOTA; Aço inox; Autoclavável, Tamanho: 14cm.	UND		60	R\$ -	R\$ -
186	Sindesmótomo Duplo Nº 1; Embalagem com 1 unidade. Aço inox. Autoclavável.	UND		175	R\$ -	R\$ -
187	Lima Dupla Seldin Nº 11; Confeccionada em Aço Inoxidável, cabo oco de 8mm, Embalagem com 1 unidade. Autoclavável.	UND		35	R\$ -	R\$ -
188	Tesoura Cirúrgica Curva, 15cm de Diâmetro; Aço inox. Autoclavável.	UND		170	R\$ -	R\$ -
189	Broca Carbide Cônica Cirurgica Zekrya FG nº151, Diâmetro de 23mm. Autoclavável. Alta rotação. 100% carbide. Broca de formato tronco-cônico e com ponta ativa para alta rotação;	UND		66	R\$ -	R\$ -



190	Cureta Lucas Modelo nº 85; Aço inox. Autoclavável. Embalagem com 1 unidade.	UND	35	R\$ -	R\$ -
191	Broca Carbide Cirúrgica Esférica N 6; Autoclavável. Alta rotação, 100% carbide.	UND	56	R\$ -	R\$ -
192	Sugador Cirurgico Metálico (CURVO); Aço inox. Autoclavável.	UND	75	R\$ -	R\$ -
193	Ponta Ultrassônica G2; Confeccionado e usinado em aço de liga especial, protegido contra oxidação. Compatível com MICRODONT / EMS / Ortus / Alt / Cristofolientech / Mectron / Advance 1 / Advance / Advance View / Advance SEL / PM200 /PM 100 / Peison Master / UltraScaler Kavo / NAC / Emissionic MMO / Odontomedics / Driller.	UND	10	R\$ -	R\$ -
194	Ponta Ultrassônica P4; Autoclavável. Confeccionado e usinado em aço de liga especial, protegido contra oxidação, com dureza. Pontas em Aço Inox para Caneta do Ultrassom Piezoelétrico, potência 60% média/alta. Uso com refrigeração.	UND	10	R\$ -	R\$ -
195	Ponta Ultrassônica G4; Autoclavável. Compatível com Microdont ADVANCE 1, Microdont ADVANCE 2, Microdont ADVANCE View, Microdont Advanced S, Microdont Advance SEL, ALT, EMS, PM 200, EMS PM 100, EMS PiezonMaster, Mectron, Kavo, Ortus, Kondortec, NAC, Emissionic (MMO), Odontomedics. Confeccionado e usinado em aço de liga especial, protegido contra oxidação; canal interno para refrigeração da parte ativa da ponta.	UND	10	R\$ -	R\$ -
196	Cureta de Gracey Número 07-08; Aço inox. Autoclavável. Cabo 8mm.	UND	50	R\$ -	R\$ -
197	Cureta de Gracey Número 11-12; Aço inox. Autoclavável. Cabo 8mm.	UND	40	R\$ -	R\$ -
198	Cureta de Gracey Número 13-14; Aço inox. Autoclavável. Cabo 8mm.	UND	40	R\$ -	R\$ -
199	Cureta de Gracey Número 15-16; Aço inox. Autoclavável. Cabo 8mm.	UND	40	R\$ -	R\$ -
200	Cureta de Gracey Número 17-18; Aço inox. Autoclavável. Cabo 8mm.	UND	40	R\$ -	R\$ -
201	Cureta Inox Mc Call N° 11/12 Foice; Aço inox. Autoclavável. Cabo 8mm. Instrumento produzido em Aço Inoxidável.	UND	55	R\$ -	R\$ -
202	Foice Ponta Morse 0-00; Aço inox. Autoclavável. Confeccionada em Aço Inoxidável. Cabo de 8mm	UND	60	R\$ -	R\$ -
203	Pedra para afiar Arkansas; Pedra de Arkansas com granulação fina. Dimensões: 10 cm x 2.5 cm x .6 cm.	UND	35	R\$ -	R\$ -
204	Colgadura Individual; Acessório Radiológico. Autoclavavel	UND	100	R\$ -	R\$ -
205	Espátula Dupla Silicato Nº1; Autoclavavel, Confeccionado em aço inoxidável AISI-420;	UND	130	R\$ -	R\$ -




	Tamanho: 12cm;					
206	Espátula p/ Resina Thompson Calcador Nº 2; Produzido em liga de Aço Inoxidável de alta qualidade. Totalmente autoclavável. 17cm de comprimento. Cabo em alumínio anodizado.	UND		130	R\$ -	R\$ -
207	Calcador De Hollemback Numero 01; Autoclavavel. É ideal em restaurações para esculpir e condensar.16cm. Produzida em Aço Inoxidável	UND		56	R\$ -	R\$ -
208	Calcador De Hollemback Numero 03; Autoclavavel. É ideal em restaurações para esculpir e condensar. 16cm. Produzida em Aço Inoxidável	UND		50	R\$ -	R\$ -
209	Calcador De Hollemback Numero 05; Autoclavavel. É ideal em restaurações para esculpir e condensar. 16cm. Produzida em Aço Inoxidável	UND		50	R\$ -	R\$ -
210	Calcador De Hollemback Numero 06; Autoclavavel. É ideal em restaurações para esculpir e condensar. 16cm. Produzida em Aço Inoxidável	UND		55	R\$ -	R\$ -
211	Brunidor Numero 29 Oitavado Simples Condensador Aço Inox Autoclavavel Também conhecido com ovo de pomba ou brunidor ovóide, devido seu formato. 16cm	UND		40	R\$ -	R\$ -
212	Escavador de Dentina Número 05; Escavador de dentina, também conhecido como Colher de Dentina; Comprimento: 16cm; Produzida em Aço Inoxidável AISI 304 e AISI 420; Autoclavavel	UND		65	R\$ -	R\$ -
213	Escavador de Dentina Número 11; Escavador de dentina, também conhecido como Colher de Dentina; Comprimento: 16cm; Produzida em Aço Inoxidável AISI 304 e AISI 420; Autoclavavel	UND		65	R\$ -	R\$ -
214	Escavador de Dentina Número 12; Escavador de dentina, também conhecido como Colher de Dentina; Comprimento: 16cm; Produzida em Aço Inoxidável AISI 304 e AISI 420; Autoclavavel	UND		65	R\$ -	R\$ -
215	Escavador de Dentina Número 17; Escavador de dentina, também conhecido como Colher de Dentina; Comprimento: 16cm; Produzida em Aço Inoxidável AISI 304 e AISI 420; Autoclavavel	UND		60	R\$ -	R\$ -
216	Placa de Vidro Despolida; Indicado para espatulação de materiais. Medidas 15x07x06mm. Placa despolida. Altoclavável	UND		50	R\$ -	R\$ -
217	Aplicador de Hidróxido de Cálcio Duplo; Material: Inox. Autoclavável. Comprimento: 16cm;	UND		80	R\$ -	R\$ -
218	Porta Algodão de Inox ; Composição do aço: aço-inox 304 , acabamento perfeito e livre de rebarbas; Altoclavável. Dimensões: 08x10c	UND		60	R\$ -	R\$ -



219	Espátula Simples N. 24 ; Material em aço inox. Autoclavável.	UND	50	R\$ -	R\$ -
220	Porta Amálgama Metálico Simples; Tamanho: 14cm. Fabricado em aço Inoxidável AISI-420. Autoclavável.	UND	70	R\$ -	R\$ -
221	Porta Matriz Tofflemire Adulto; Aço Inox. Altoclavável. Diâmetro: 6 cm	UND	55	R\$ -	R\$ -
222	Pote Dappen de Vidro; Material: Vidro. Transparente. Cor: Incolor; Autoclavável; Medidas mínimas: Altura: 3cm; Concavidade superior: 2,5 cm; Capacidade máxima da concavidade superior: 3 ml; Concavidade inferior: 2,0 cm; Capacidade máxima da concavidade inferior: 2 ml. Peso do produto: 50 g;	UND	45	R\$ -	R\$ -
223	Alicate Perfurador Ainsworth; Totalmente autoclavável. Produzido em liga de Aço Inoxidável de alta qualidade. Perfura o lençol com 5 diâmetros diferentes. Alicate perfurador p/ auxílio na elaboração de dique de borracha; Tamanho 15 cm;	UND	10	R\$ -	R\$ -
224	Grampo p/ Isolamento Nº 206; Aço Inoxidável. Autoclavável;	UND	20	R\$ -	R\$ -
225	Grampo p/ Isolamento Nº 207; Aço Inoxidável. Autoclavável;	UND	20	R\$ -	R\$ -
226	Grampo p/ Isolamento Nº 209; Aço Inoxidável. Autoclavável;	UND	20	R\$ -	R\$ -
227	Grampo p/ Isolamento Nº 210; Aço Inoxidável. Autoclavável;	UND	20	R\$ -	R\$ -
228	Grampo p/ Isolamento Nº 200; Aço Inoxidável. Autoclavável;	UND	20	R\$ -	R\$ -
229	Grampo p/ Isolamento Nº 202; Aço Inoxidável. Autoclavável;	UND	20	R\$ -	R\$ -
230	Grampo p/ Isolamento Nº 201; Aço Inoxidável. Autoclavável;	UND	20	R\$ -	R\$ -
231	Grampo p/ Isolamento Nº W8A; Aço Inoxidável. Autoclavável;	UND	20	R\$ -	R\$ -
232	Arcos de Ostby Adulto	UND	15	R\$ -	R\$ -
233	Conjunto de Aspiração Endodôntico; Kit com 1 cânula + 3 agulhas com bisel. Três tamanhos de agulhas. Tamanho da cânula permite perfeita empunhadura. Produto autoclavável Autoclavável. MEDIDAS MÍNIMAS DO PRODUTO: Agulha 4010: 32,4 mm x Ø 1 mm. Agulha 4015: 32 mm x Ø 1,5 mm. Agulha 5020: 40,9 mm x Ø 2 mm. Cânula: 100 mm x Ø 3,30 mm (interno)x Ø 6,35 mm (externo)	UND	15	R\$ -	R\$ -
234	Régua de Alumínio Milimetrada Endodôntica; Esterilizável em autoclave. Utilizado para medir limas endodônticas.	UND	20	R\$ -	R\$ -
235	Consultório Odontológico: Estrutura Construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo. Base com debrum antiderrapante Dispensa fixação no piso. Braço de apoio para o paciente.	UND	6	R\$ -	R\$ -



	<p>Pedal de Comandos. Sistema de elevação Eletromecânico acionado por moto-redutor de baixa tensão com 24 volts. Sistema eletrônico Integrado e de baixa voltagem: 24 volts. Tensão de alimentação 220V ~ 50/60Hz. Encosto de cabeça anatômico, removível, bi-articulável e com regulagem de altura, com movimentos anterior, posterior e longitudinal. Equipo Composto: 01 Seringa tríplex; 01 terminal com spray para alta rotação; 01 terminal sem spray para micromotor pneumático. Pedal Progressivo para o acionamento das peças de mão nos terminais do equipo, o que possibilita o controle da velocidade e com acionamento em qualquer ponto do pedal. Seringa tríplex; Bico giratório removível e autoclavável. Suporte das pontas: Com acionamento pneumático individual. Pintura na cor branca, com tratamento anticorrosivo. Puxador bilateral. Unidade de Água: fluxo de água na cuspidora. Cuba profunda, removível e com ralo para retenção de sólidos e cobertura para evitar respingos. Filtro de detritos. Sistema de regulagem da vazão da água e permite a regulagem fina do fluxo de água. 01 Suctor de saliva a ar. Reservatórios translúcidos de 800 ml para: Água das peças de mão e seringa tríplex. Refletor Luz halógena; Puxadores bilaterais em forma de alça que possibilitam isolamento, evitando o risco de contaminação cruzada. Cabeçote produzido em material resistente, com giro de 620°. Intensidade: 8.000 a 25.000 LUX (tolerância +/- 20%).</p>				
236	<p>AUTOCLAVE. Câmaras de esterilização em aço inox, com muito mais resistência e durabilidade; Produto de fácil operação com controles simples e automáticos; Acompanhamento dos ciclos através de manômetro-termostato e avisos visuais; Diversos sistemas de segurança que controlam todo o ciclo e previnem falhas de funcionamento, com desligamento automático em caso de excesso de temperatura, pressão ou falta de água; Tampa com construção especial e fecho de triplo estágio, muito mais segurança e praticidade no momento de utilizar o equipamento; Secagem eficiente do material com opção de secagens extras; Informações Técnicas: Capacidade mínima 40 litros; Câmara de aço inox; Dimensões mínimas da câmara 30 X 56,6 cm (diâmetro x comprimento); Potência mínima 1600 w; Pressão de trabalho 1 kgf/cm²;</p>	UND	8	R\$ -	R\$ -




	Temperatura padrão O.M.S até 121°C; Ciclo de secagem de série Bandejas de alumínio				
237	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO: Isento de óleo, com pintura antimicrobiana interna e externa e padrões construtivos segundo as mais exigentes normas mundiais. Uso externo - Informações Técnicas: Deslocamento teórico: 5pcm- 141 l/m; Tensão: 220V – Monofásico; Pressão de operação: Mínima: 80 Libras - 5.5 Bar; Máxima: 120 Libras - 8.3 Bar; Número de pistões: 2; Potência mínima: 1HP / 0,75 kW; Volume mínimo do reservatório: 30 l; Nível de Ruído máximo: 70 DB; Conexão: 1/4"	UND	8	R\$ -	R\$ -
238	CANETA DE ALTA ROTACÃO: Push Button: Fixação da broca de forma fácil, prática e segura. Cabeça Standard. Diâmetro mínimo da cabeça: 11,3 mm. Spray Triplo Ventilado, rolamentos com esferas cerâmicas, rotor balanceado eletronicamente, Corpo e cabeça confeccionados em liga metálica de cobre e zinco resistência aos processos de autoclavagem. Autoclavável até 135°C. Deverá conter como acessórios: 01 Agulha de limpeza, 01 Guarnição Borden. Garantia: 12 Meses. Rotação deverá ser entre: 360.000 à 420.000 rpm. Brocas: Haste tipo 3 - FG (Standard). Pressão média de trabalho (bar): 2,2 bar = 220 Kpa = 32 psi + 5%. Diâmetro da cabeça: 11,3 mm.	UND	10	R\$ -	R\$ -
239	CONTRA ÂNGULO (CANETE DE BAIXA ROTACÃO): Fixação da broca: Através de trava (lâmina). Spray único externo. Corpo confeccionado em alumínio anodizado; Cabeça em latão (metal duro); Autoclaváveis até 135°C; Cor: Prata acetinado. contendo acessórios: 01 Adaptador de refrigeração. Informações Técnicas: Peso bruto c/ embalagem: 78 g; Garantia: 12 Meses; Peso: 43 g; Acoplamento: Intra (universal), com giro de 360 graus. Rotação média: 5.000 a 20.000 rpm; Relação de transmissão: 1:1; Brocas: Haste tipo 2 - HP Standard	UND	20	R\$ -	R\$ -
240	MICRO MOTOR (MOTOR DE BAIXA ROTACÃO): Spray Externo. Corpo confeccionado em alumínio anodizado; Acoplamento Intra (universal): Com giro de 360 graus. Rotação: Até 20.000 rpm * Regulagem da velocidade e sentido de giro (horário ou anti-horário) no corpo do micro motor. Autoclaváveis até 135°C. Cor: Prata; Conexão: Borden (2 furos). Acoplamento: Intra	UND	12	R\$ -	R\$ -



	(universal), com giro de 360 graus. Rotação: 5.000 a 20.000 rpm. Pressão de trabalho (bar): 2,76 bar = 275,8 Kpa = 40 psi +- 5%. Consumo de ar: 52 l/min. +- 10%.				
241	FOTOPILIMERIZADOR (LED): Display digital. Profundidade de polimerização de 6 mm. Temporizador para Polimerização modo Contínuo: 05, 10, 15, 20 segundos; Temporizador para Polimerização modo High e Ortho: 03 segundos; Bip sonoro indicativo a cada 5 seg e no final da operação. Tempo máximo de uso contínuo: 300 segundos. Comandos de programação na própria caneta. Corpo confeccionado em ABS injetado. Intensidade de luz constante independente do nível de carga da bateria. A solidificação (cura) da resina não é afetada pela diferença de carga da bateria. Silencioso pois não necessita de ventilação forçada. Bivolt automático 100/240V. Ponteira removível e com giro de 360°. Lente da ponteira substituível. Sistema stand by. Desliga automaticamente após 2 minutos sem utilização. Informações Técnicas: Alimentação: Bivolt automático 100 - 240 V. Garantia de 12 Meses. Bateria: 3.7V 1400 mA. Potência de luz: 1250 mW, 1900 mW, 2500 mW.	UND	10	R\$ -	R\$ -
242	Seladora Manual Odontológica para Papel Grau Cirúrgico: Controle eletrônico de temperatura até 300°C, controle eletrônico do tempo de selagem com bip sonoro, alavanca de selagem, suporte e cortador de bobinas com faca de duplo corte; Dados técnicos mínimos: Largura da selagem: 13 mm; Largura da embalagem: 300 mm / 30 cm; Potência mínima: 150 watts. Tensão de alimentação: 220V / 60Hz.	UND	19	R\$ -	R\$ -
243	Ponta Diamantada Cilíndrica Extremidade Plana 1092, Alta Rotação, Confeccionada em aço e impregnada com diamantes naturais. Autoclavável.	UND	1440	R\$ -	R\$ -
244	Broca Carbide Cirúrgica esférica Nº 06, Embalagem com 1 unidade. Características: Broca autoclavável; Referência da broca: 6; Tipo de ponta: Esférica; Tipo de Broca: Alta Rotação (FG); Comprimento total: 25 mm.	UND	144	R\$ -	R\$ -
245	Broca Carbide Cirúrgica esférica Nº 08, Embalagem com 1 unidade. Características: Broca autoclavável; Referência da broca: 8; Tipo de ponta: Esférica; Tipo de Broca: Alta Rotação (FG); Comprimento total: 25 mm.	UND	144	R\$ -	R\$ -
246	Ponta Diamantada Cônica Extremidade Ogival - Ponta Diamantada Nº 3227F, * Haste em aço inoxidável; Granulação; Fina (F) Vermelho - 46µm; Alta rotação.	UND	144	R\$ -	R\$ -



247	Broca Carbide Esférica CA 3 (Baixa Rotação). Modelo: CA 3, Autoclavável. Características: Haste: CA; Família: Esférica; Granulometria: Média; Característica: Baixa Rotação; Diâmetro Parte Ativa: 1,2 mm.	UND	144	R\$ -	R\$ -
248	Broca Carbide Esférica CA 6. Modelo: CA 6, Autoclavável. Características; Haste: CA; Família: Esférica; Granulometria: Média; Característica: Baixa Rotação; Diâmetro Parte Ativa: 1,8 mm.	UND	144	R\$ -	R\$ -
249	Broca Carbide Esférica CA 8 (Baixa Rotação). Modelo: CA 8, Autoclavável. Características: Haste: CA; Família: Esférica; Granulometria: Média; Característica: Baixa Rotação; Diâmetro Parte Ativa: 2,3 mm.	UND	144	R\$ -	R\$ -
250	Broca Esf. Nº 1012 diamantada, alta rotação. Comprimento da haste: 19 mm; Diâmetro da haste: 1,6 mm; Velocidade de uso recomendada: 300.000 rpm	UND	1440	R\$ -	R\$ -
251	Broca Esf. Nº 1014 diamantada, alta rotação. Broca autoclavável. Referência da broca: 1014. Tipo de ponta: Esférica. Granulometria: Média. Tipo de Broca: Alta Rotação (FG). Diâmetro máximo da parte ativa (Ø ISO): 014. Comprimento da parte ativa: 1,4 mm. Comprimento total: 19,0 mm.	UND	1440	R\$ -	R\$ -
252	Broca Esf. Nº 1015 diamantada, alta rotação. Broca autoclavável. Referência da broca: 1015. Tipo de ponta: Esférica. Granulometria: Média. Tipo de Broca: Alta Rotação (FG). Diâmetro máximo da parte ativa (Ø ISO): 016. Comprimento da parte ativa: 1,6 mm. Comprimento total: 19,0 mm.	UND	1440	R\$ -	R\$ -
253	Broca Esf. Nº 1017 diamantada, alta rotação. Broca autoclavável. Referência da broca: 1017. Tipo de ponta: Esférica. Granulometria: Média. Tipo de Broca: Alta Rotação (FG). Diâmetro máximo da parte ativa (Ø ISO): 021. Comprimento da parte ativa: 2,1 mm. Comprimento total: 19,0 mm.	UND	1440	R\$ -	R\$ -
254	Broca Aço Mult-Set CA (BAIXA ROTAÇÃO). Indicado para acabamento em Amálgama; Broca CA em aço Vanádio; Broca Aço Mult-Set CA Multilaminada; Kit com Brocas de 12 Lâminas.	KIT	60	R\$ -	R\$ -
255	Ponta Diamantada Cônica Pontaguda Nº 2200F, Broca autoclavável; Referência da broca: 2200F; Tipo de ponta: Cônica Pontaguda; Granulometria: Fina; Tipo de Broca: Alta Rotação (FG); Diâmetro máximo da parte ativa (Ø ISO): 010; Comprimento da parte ativa: 8,0 mm; Comprimento total: 22,0 mm.	UND	1440	R\$ -	R\$ -
256	Ponta Diamantada Cônica Invertida 1047, Broca autoclavável; Referência da broca: 1047;	UND	400	R\$ -	R\$ -



	Tipo de ponta: Cônica Invertida Dupla; Granulometria: Média; Tipo de Broca: Alta Rotação (FG); Diâmetro máximo da parte ativa (Ø ISO): 018; Comprimento da parte ativa: 2,2 mm; Comprimento total: 19,0 mm.					
257	Ponta Diamantada Cônica Pontaguda Nº 2200FF, Broca autoclavável; Referência da broca: 2200FF; Tipo de ponta: Cônica Pontaguda; Granulometria: Extra Fina; Tipo de Broca: Alta Rotação (FG); Diâmetro máximo da parte ativa (Ø ISO): 010; Comprimento da parte ativa: 8,0 mm; Comprimento total: 22,0 mm.	UND		1440	R\$ -	R\$ -
258	Ponta Diamantada Cônica Extremidade em Chama 3195F, amíliã: Cônica Topo Chama; Granulometria: Média; Característica: Alta Rotação; Diâmetro Parte Ativa: 1,6 mm; Comprimento Parte Ativa: 10,0 mm.	UND		500	R\$ -	R\$ -
259	Ponta Diamantada Chama 3118F Broca autoclavável; Referência da broca: 3118; Tipo de ponta: Chama; Granulometria: Média; Tipo de Broca: Alta Rotação (FG); Diâmetro máximo da parte ativa (Ø ISO): 023; Comprimento da parte ativa: 5,0 mm; Comprimento total: 19,0 mm.	UND		500	R\$ -	R\$ -
260	Broca Zecrya Longa 21 mm Broca de formato tronco-cônico e com ponta ativa Tamanho Longa. Alta rotação.	UND		150	R\$ -	R\$ -
261	Ponta Diamantada Pêra 3168F Broca autoclavável; Referência da broca: 3168F; Tipo de ponta: Pêra; Granulometria: Fina; Tipo de Broca: Alta Rotação (FG); Diâmetro máximo da parte ativa (Ø ISO): 023; Comprimento da parte ativa: 4,0 mm; Comprimento total: 19,0 mm; Aplicação.	UND		400	R\$ -	R\$ -
262	Broca Carbide Cirúrgica Cônica de Corte Cruzado FG 25mm - Nº 702, ENVOLP C/01 UND, Broca autoclavável; Broca Carbide cônica de corte cruzado; 702, 25mm; Alta rotação (Fg)100% carbide; Sem soldagem.	UND		150	R\$ -	R\$ -
263	Fio Retrator 000, O fio Ultrapak é feito de 100% algodão entrelaçado em milhares de laços minúsculos que formam longas cadeias entrelaçadas; Fio 000 preto e roxo.	UND		96	R\$ -	R\$ -
264	Abridor de Boca Adulto e Infantil - CARACTERÍSTICAS: O instrumento perfeitamente encaixado entre a arcada superior e inferior do paciente promove maior conforto por manter a boca aberta por mais tempo, facilitando o desempenho do trabalho do profissional; Possibilita conforto ao paciente; Mantém a boca aberta; Facilita procedimentos odontológicos; Esterilização em Autoclave á 134°C; Cores azul e rosa; Desenvolvido com 100% de silicone. DIMENSÕES: Adulto: 40 x 30	KIT		60	R\$ -	R\$ -



	x 20 mm; Infantil: 30x 25x18 mm.				
265	AFASTADOR LABIAL ARCFLEX Tamanho M; Confeccionado em material com força elástica que permite comprimir e deformar o arco para diminuir seu tamanho e facilitar sua introdução na cavidade bucal. Esta mesma força elástica força a abertura das conchas e promove o afastamento dos lábios de forma confortável e segura; Encaixes rápidos: produto totalmente desmontável para facilitar a desinfecção e esterilização; Identificação rápida: as aletas laterais, bem como o controlador de língua possuem identificação do tamanho do produto para que a seleção seja simplificada, além de indicação correta do posicionamento; Esterilizável em autoclave (até 134°C)	UND	60	R\$ -	R\$ -
266	Removedor de Manchas, Embalagem com 1 seringa com 2g + 10 ponteiros para a aplicação + 1 espátula.	UND	180	R\$ -	R\$ -
267	Restaurador Provisório, Embalagem com 25g; Com Flúor; Maleável, fácil manipulação e remoção; Vedação hermética; Não contém eugenol; Manter o pote fechado em local seco e fresco; Validade 24 meses a partir da data de fabricação.	UND	120	R\$ -	R\$ -
268	Ionômero de Vidro Restaurador, Embalagem com 5g de pó + 2,5ml de líquido + 2ml de primer + 2ml de glaze. Tripla Presa, Fotopolimerizável, Autopolimerizável E Reação Ácido-Base Do Ionômero De Vidro. Polimerização Garantida em Qualquer Situação Clínica, Mesmo Com Ausência De Luz; Aplicação Em Único Incremento: Rapidez, Ideal Para Odontopediatra; Liberação De Flúor Evita O Aparecimento De Cárie; Adesivo com Nanotecnologia; contém partícula de carga de 5nm que proporciona uma excelente adesão à dentina e ao esmalte; Adesivo com 10% de peso em carga. Devido ao pequeno tamanho da carga, não é necessário agitar o frasco antes do uso; Exclusiva tampa "flip top": evita desperdício e pode ser manuseada apenas com uma mão; Alto rendimento; Aplicações: 36 restaurações.	UND	30	R\$ -	R\$ -
269	Selamento de fôssulas e fissuras, Embalagem com 1g. Libera flúor, Apresenta menor viscosidade, Ambos possuem pontas aplicadoras superfinais em ângulo que facilitam o controle a extrusão. Bio compatível: A baixa solubilidade do Conseal f à água minimiza a quebra do selante no meio oral. Altamente Resistente: é composto por 7% de substância submicrons com tamanho de 0.04 micron para suportar o desgaste da superfície;	EMBALAGEM	150	R\$ -	R\$ -




	Fotopolimerizável.					
270	Cunha Anatômica de Madeira, Embalagem com 100 unidades. Sortida. As cunhas são feitas de madeira sicômoro, livre de farpas; Estão disponíveis em 5 modelos diferentes codificados por cores; Cunhas anatômicas com excelente acabamento e que não soltam farpas. Menos agressão a gengiva, maior facilidade no procedimento e conforto para o paciente; Otimização formato anatômico ideal com lado côncavo para adaptar-se à morfologia interdental; Cores: Turquesa, laranja, branca, verde e amarela; Validade 2 anos.	EMBALAGEM		60	R\$ -	R\$ -
271	Resina Microhíbrida, Cor B2, Composição: BisGMA, TEGDMA, Bisfenol A, polietileno glicol diéter dimetacrilato, UDMA, Cerâmica silanizada tratada e sílica tratada de síano; Resina microhíbrida com nanopartículas; Validade: 3 anos; Seringa com 4g.	UND		50	R\$ -	R\$ -
272	Escudo Facial Standard Transparente; Embalagem com 1 unidade. Proteção até as orelhas; É fechado na cabeça protegendo contra aerossóis contaminados suspensos; Ergonômico para uso contínuo sem provocar dores de cabeça; Área de contato lisa e de fácil assepsia; Reutilizável; Visor resistente, protegido e cristal de 0,50mm; Mantém ser fixo à cabeça sem soltar-se, com tira de ajuste passível de assepsia e para diferentes tamanhos de cabeça; Dimensões: 31x20x24.	UND		35	R\$ -	R\$ -
273	Pedra para Afilar Arkansas; Embalagem com 1 unidade. Dimensões: 10 cm x 2,5 cm x 0,6 cm. Lubrificar a pedra com óleo. Qualidade, durabilidade e eficiência na realização de procedimentos odontológicos; Pedra natural, ao ser extraída pode sair com várias tonalidades.	UND		24	R\$ -	R\$ -
274	Filme Radiográfico; Caixa com 150 unidades. Tamanho 3x4. Compatível com todos os aparelhos de raios-X do mercado, pode ser processado com qualquer químico padrão (revelador e fixador), de maneira manual ou automática. Plástico extra macio, resistente à saliva e desinfetável; Velocidade E; Cor azul; Validade: 2 anos após sua fabricação.	CX		80	R\$ -	R\$ -
275	Fita Para Autoclave; A Fita Autoclave é composta de papel crepado branco; Fácil manuseio; Tinta termoreativa e adesivo á base de borracha natural e resina acrílica; Dimensões 19mmX30m; Validade: 5 anos.	UND		250	R\$ -	R\$ -
276	Lâmina de Bisturi de Aço Carbono Estéril 15; Embalagem com 100 unidades. Lâmina de bisturi descartável de aço carbono. Validade: 5 anos após a data de fabricação.	PCT		15	R\$ -	R\$ -
277	Lamina de bisturi nº 12. Embalagem com 100	PCT		10	R\$ -	R\$ -



COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 670
e

	unidades. Lâmina de bisturi descartável de aço carbono. Validade: 5 anos após a data de fabricação.					
278	Bobina Papel Grau Cirúrgico 150mm x 100 metros: Bobinas lisas, produzidas em papel grau cirúrgico e filme laminado (Poliéster/Polipropileno); Indicado para esterilização em autoclave a vapor ou óxido de etileno; Permeável ao vapor e ao ar, impermeável a microorganismo, resistentes ao calor, livres de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos; A alta transparência do filme azul permite a visualização do material embalado; Possui selagem tripla Multilínea que proporciona maior segurança ao material esterilizado; Dotado de indicadores químicos que mudam de cor após o processo de esterilização; Possui indicador de sentido correto de abertura na embalagem; Toda a impressão do envelope situa-se na área externa de esterilização evitando assim a migração de tinta ao conteúdo a ser esterilizado; Apresentação em bobinas com 100 metros de comprimento.	UND	100	R\$ -	R\$ -	
279	Bobina Papel Grau Cirúrgico 200mm x 100 metros: Bobinas lisas, produzidas em papel grau cirúrgico e filme laminado (Poliéster/Polipropileno); Indicado para esterilização em autoclave a vapor ou óxido de etileno; Permeável ao vapor e ao ar, impermeável a microorganismo, resistentes ao calor, livres de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos; A alta transparência do filme azul permite a visualização do material embalado; Possui selagem tripla Multilínea que proporciona maior segurança ao material esterilizado; Dotado de indicadores químicos que mudam de cor após o processo de esterilização; Possui indicador de sentido correto de abertura na embalagem; Toda a impressão do envelope situa-se na área externa de esterilização evitando assim a migração de tinta ao conteúdo a ser esterilizado; Apresentação em bobinas com 100 metros de comprimento.	UND	180	R\$ -	R\$ -	
280	Bobina Papel Grau Cirúrgico 300mm x 100 metros: Bobinas lisas, produzidas em papel grau cirúrgico e filme laminado (Poliéster/Polipropileno); Indicado para esterilização em autoclave a vapor ou óxido de etileno; Permeável ao vapor e ao ar, impermeável a microorganismo, resistentes ao calor, livres de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos; A alta transparência do filme	UND	100	R\$ -	R\$ -	



	<p>azul permite a visualização do material embalado; Possui selagem tripla Multilínea que proporciona maior segurança ao material esterilizado; Dotado de indicadores químicos que mudam de cor após o processo de esterilização; Possui indicador de sentido correto de abertura na embalagem; Toda a impressão do envelope situa-se na área externa de esterilização evitando assim a migração de tinta ao conteúdo a ser esterilizado; Apresentação em bobinas com 100 metros de comprimento.</p>				
281	<p>Bobina Papel Grau Cirúrgico 100mm x 100 metros: Bobinas lisas, produzidas em papel grau cirúrgico e filme laminado (Poliéster/Polipropileno); Indicado para esterilização em autoclave a vapor ou óxido de etileno; Permeável ao vapor e ao ar, impermeável a microorganismo, resistentes ao calor, livres de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos; A alta transparência do filme azul permite a visualização do material embalado; Possui selagem tripla Multilínea que proporciona maior segurança ao material esterilizado; Dotado de indicadores químicos que mudam de cor após o processo de esterilização; Possui indicador de sentido correto de abertura na embalagem; Toda a impressão do envelope situa-se na área externa de esterilização evitando assim a migração de tinta ao conteúdo a ser esterilizado; Apresentação em bobinas com 100 metros de comprimento.</p>	UND	100	R\$ -	R\$ -
					R\$ -

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA R\$ _____

PROPONENTE:

CNPJ Nº:


REPRESENTANTE DA EMPRESA:

CPF Nº:

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

Nome do Representante Legal _____

CPF nº _____



ANEXO III
MODELO DE DECLARAÇÃO
(Juntar aos documentos requeridos para habilitação)


DECLARAÇÃO

(NOME E QUALIFICAÇÃO DO(A) PROPONENTE)

a) DECLARA, para os devidos fins que, em cumprimento ao estabelecido na Lei Federal nº 9.854, de 27/10/1999, publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo 7º, da Constituição Federal, não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesesseis) anos em trabalho algum, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

b) DECLARA, Sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006 e Lei 147/2014, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao Município de Boa Viagem/CE, ser **MICROEMPRESA-ME E/OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE-EPP**, nos termos da legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no § 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006. (opcional)

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.

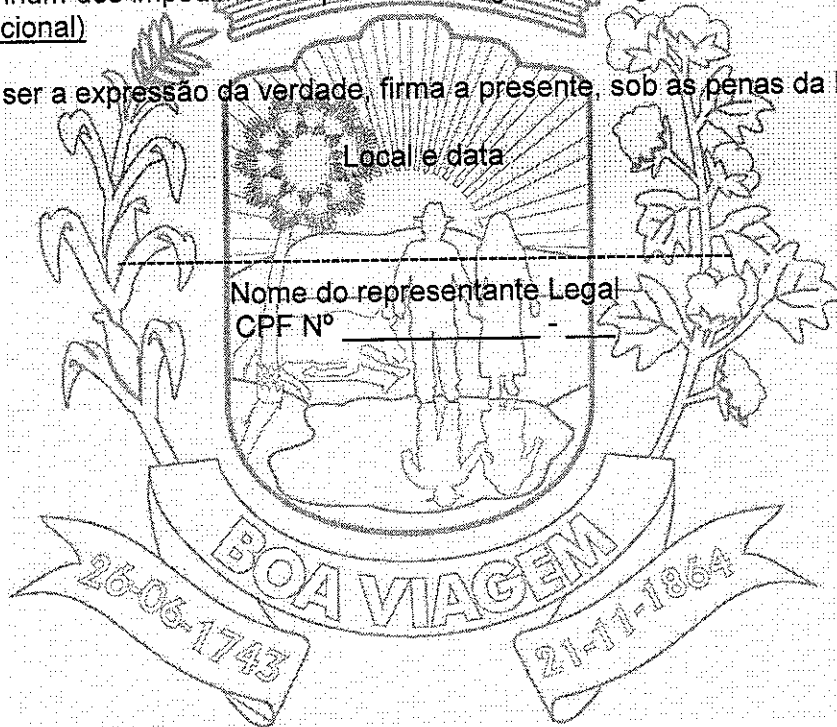



ANEXO IV - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2022.03.03.001
PROCESSO Nº 2022.03.03.001
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2022.03.03.001
VALIDADE: 01 (um) ano

Aos ____ (____) dias do mês de _____ do ano de _____, na sala da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Boa Viagem, localizada na Praça Monsenhor José Cândido, 100 - Centro - Boa Viagem/CE, nos termos constantes na Lei de Licitações nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, na Lei do Pregão nº 10.520, de 10 de julho de 2002 e no Decreto Municipal nº 108/2017, de 08 de março de 2017, de acordo com o resultado da classificação das propostas apresentadas no PREGÃO ELETRÔNICO n.º 2022.03.03.001 foram registrados os preços da(s) empresa(s) ao final qualificada(s), de acordo com a classificação por tela(s) alcançada(s), observadas as condições do edital que integra este instrumento de registro de preços e aquelas enunciadas nas cláusulas que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1- A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de equipamentos e materiais médico hospitalares, odontológicos, leites e suplementos alimentares para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Boa Viagem/CE, conforme especificações em anexo, parte integrante deste processo de PREGÃO ELETRÔNICO n.º 2022.03.03.001, que passa a fazer parte, para todos os efeitos, desta Ata, juntamente com as propostas das licitantes vencedoras bem como com os mapas de apuração de lances ofertados e/ou verbais apresentados pelas licitantes.

CÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1- O registro de preços formalizado na presente Ata terá validade de 01 (um) ano, contados a partir da data de sua assinatura.

2.2- A partir da vigência da Ata de Registro de Preços, o licitante se obriga a cumprir integralmente todas as condições estabelecidas, sujeitando-se, inclusive, às penalidades pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas.

2.3- As quantidades previstas no Anexo I - Especificações dos Produtos são estimativas máximas para o período de validade da Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA ADMINISTRAÇÃO DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1- O gerenciamento da presente Ata caberá ao Ordenador(a) de Despesas da Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Boa Viagem, na forma que a lei estabelece.

CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

4.1- A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada pela Secretaria de Saúde, na condição de órgão gerenciador e pelas demais Unidades Administrativas, ambas, da Prefeitura Municipal de Boa Viagem, na condição de órgãos participantes, e por



qualquer outro órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta à Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Boa Viagem, desde que devidamente comprovada a vantagem.

4.2- Os órgãos e entidades que não participaram do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços deverão manifestar o seu interesse junto à Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Boa Viagem, que indicará as possíveis licitantes e respectivos preços registrados.

4.3- Caberá a empresa adjudicatária beneficiária da Ata de Registro de Preços, observada as condições nela estabelecidas, optar ou não pelo fornecimento dos produtos, independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

4.4- As aquisições adicionais a que se refere o item anterior não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços.

4.5- O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem.

4.6- A existência de preços registrados não obriga aos órgãos ou entidades Participantes, a adquirir o objeto licitado, sendo facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO E ESPECIFICAÇÃO

5.1. Os preços ofertados, especificações, quadro classificatório com preços propostos das licitantes, da empresa vencedora e das que se dispuserem a ter seus preços registrados ao preço da primeira colocada, empresa(s) e representante(s) legal(ais), encontram-se enunciados, em anexo, na presente Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA SEXTA - DO LOCAL E DO PRAZO DE ENTREGA

6.0- Os produtos serão entregues diretamente no Almoxarifado central da Prefeitura Municipal de Boa Viagem, mediante solicitação prévia da CONTRATANTE, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento da respectiva Ordem de Compra, tudo de acordo com as especificações constantes da proposta apresentada.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO

7.1- O pagamento será efetuado, no prazo de até 30 (trinta) dias após a entrega do objeto licitado, mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura contendo o atesto do recebimento, diretamente pela Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Boa Viagem.

7.1.1- Para fins de pagamento a empresa contratada deverá manter as mesmas condições de habilitação, cuja confirmação será feita através de consulta ao CRC ou através da internet nos respectivos sites dos órgãos emissores das certidões de regularidade fiscal.

7.2- Havendo erro na nota fiscal/fatura, ou outra circunstância que desaprove a liquidação da despesa, o pagamento será susado até que a Contratada providencie as medidas



saneadoras necessárias, não ocorrendo, neste caso, quaisquer ônus para a Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Boa Viagem.

7.3- A Contratante poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a eventuais multas e/ou indenizações devidas pela Contratada, assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa.

CLÁUSULA OITAVA - DO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS

8.1- Entregar os produtos diretamente no almoxarifado central da Prefeitura Municipal de Boa Viagem, mediante solicitação prévia da CONTRATANTE, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento da respectiva Ordem de Compra, tudo de acordo com as especificações constantes da proposta apresentada.

CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

9.1- Ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que:

- a) Ensejar retardamento da realização do certame.
- b) Cometer fraude fiscal.
- c) Deixar de apresentar documento exigido para participação no certame.
- d) Apresentar documento ou declaração falsa.
- e) Não mantiver a proposta de menor preço ofertado em qualquer fase do certame.
- f) Comportar-se de modo injútil.
- g) Cometer fraude na entrega dos produtos, e
- h) Descumprir prazos.

9.2- As penalidades serão obrigatoriamente registradas no CRC da Prefeitura Municipal de Boa Viagem e, no caso de suspensão de licitar, a licitante deverá ser descredenciada por igual período, sem prejuízo das multas previstas no edital e no contrato e das demais cominações legais.

9.3- A contratada sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, a advertências, suspensões e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, sem prejuízo das sanções legais na esfera cível e criminal, além de multas estipuladas na forma a seguir.

a) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor homologado, em caso de recusa da licitante em assinar a Ata de Registro de Preços em 05 (cinco) dias úteis, contados da data de sua convocação.

b) Multa de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso na entrega dos produtos, sobre o valor global do Contrato.

c) Multa de 10 % (dez por cento) do valor residual do contrato, em caso de:

c.1) Atraso, superior a trinta dias na entrega dos produtos.

c.2) Desistência de entregar os produtos.

9.4- As multas previstas nas alíneas anteriores, não serão aplicadas de modo cumulativo.



9.5- O valor da multa aplicada será deduzido pela Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Boa Viagem, por ocasião do pagamento, momento em que a unidade responsável pelo mesmo comunicará à CONTRATADA.

9.6 - As suspensões referentes aos direitos de licitar e contratar com a Administração Pública serão aplicadas à CONTRATADA pelo prazo de até 05 (cinco) anos, nos casos em que a inadimplência acarretar prejuízos para a Administração.

9.7- A declaração de Inidoneidade para licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Boa Viagem será aplicada à CONTRATADA que der causa, por duas vezes, à suspensão prevista no item anterior.

9.8- As sanções previstas no item 9.7 poderão ser aplicadas à CONTRATADA que:

- a) Praticar atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da Licitação.
- b) Demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a Administração Pública, em virtude de atos ilícitos praticados.

9.9- A inexecução total ou parcial do Contrato, inclusive a sua transferência total ou parcial a outra Empresa, sem prévio assentimento do Órgão/Entidade, enseja sua rescisão com as consequentes penalidades previstas legalmente e contratualmente.

9.10- Para aplicação das sanções previstas neste tópico a licitante será submetida a processo administrativo para apuração dos fatos, garantidos sempre os direitos prévios da citação, da ampla defesa e do contraditório, assegurados pela Constituição Federal de 1.988.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO CONTRATUAL


10.1- A inexecução parcial ou total do Contrato dará ensejo a sua rescisão, atendido o disposto nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93 e suas posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS ALTERAÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DOS CONTRATOS DE LA DECORRENTES

11.1- Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.2- O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo à Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Boa Viagem promover as necessárias negociações junto às licitantes.

11.3- Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, a Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Boa Viagem convocará a licitante visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado no mercado.



11.4- Frustrada a negociação, a licitante será liberada do compromisso assumido e a Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Boa Viagem convocará as demais licitantes visando igual oportunidade de negociação.

11.5- Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e a licitante não puder cumprir o compromisso, deverá apresentar à Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Boa Viagem requerimento com as devidas justificativas e comprovações acerca do assunto.

11.6- A Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Boa Viagem, após análise do requerimento, poderá liberar a licitante do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, caso confirmada a veracidade justificativas e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento.

11.7- Ocorrendo a liberação da licitante conforme o item acima, a Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Boa Viagem convocará as demais licitantes visando igual oportunidade de negociação.

11.8- Não havendo êxito nas negociações, a Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Boa Viagem procederá com a revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de ajuste mais vantajoso.

11.9- É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666 de 1993.

11.10- A vigência dos contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços será definida nos instrumentos convocatórios, observado o disposto no art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.11- Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.12- O contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

12.1- A Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Boa Viagem poderá cancelar o registro de preços, sem prejuízo das sanções cabíveis.

12.1.1- Quando a Licitante:

- a) Não manter, ou deixar de comprovar que mantém as condições de habilitação e qualificação exigidas neste Edital;
- b) Não atender, ou atender parcialmente, os preços e as condições estipuladas;
- c) Reincidir em faltas no cumprimento das obrigações que decorrerem do Edital e da Ata de Registro de Preços;
- d) Recusar-se à revisão de preços proposta pela Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Boa Viagem, com o intuito de adequá-los aos praticados no mercado;



e) Demonstrar, comprovadamente, a impossibilidade de atender às solicitações de fornecimento em razão dos preços registrados, pela indisponibilidade do bem no mercado, ou, ainda, em decorrência de caso fortuito ou força maior.

12.1.2- Quando a Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Boa Viagem:

- a) Verificar que os preços praticados no mercado são mais vantajosos no que se refere ao item 11.4 acima.
- b) Entender, motivadamente, conveniente e oportuno por razões de interesse público;
- c) Constatar fato impeditivo à manutenção dos preços registrados.

12.2- A licitante poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preços na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução do ajustado, decorrentes de caso fortuito ou força maior, devidamente comprovados.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA FISCALIZAÇÃO

13.1- A execução da Ata de Registro de Preços será objeto de acompanhamento, fiscalização e avaliação por intermédio da Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Boa Viagem.

13.2- A fiscalização de que trata o subitem anterior será exercida no interesse da Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Boa Viagem.

13.3- Quaisquer exigências de fiscalização inerentes ao objeto da Ata de Registro de Preços deverão ser prontamente atendidas pelo licitante, sem qualquer ônus para a Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Boa Viagem.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA CONTRATAÇÃO

14.1- Durante o prazo de validade do registro de preços, as empresas detentoras poderão ser convidadas a firmar contratações de fornecimento, observadas as condições fixadas neste Edital e nas determinações contidas na legislação pertinente.


14.2- Aplica-se às contratações de fornecimento decorrentes de registro de preços o disposto no Capítulo III da Lei Federal n.º 8.666/93, com suas respectivas alterações posteriores, no que couber.

14.3- Na hipótese de a licitante primeira classificada ter seu registro cancelado e/ou não firmar a contratação no prazo e condições estabelecidos, poderá ser firmada contratação com as demais licitantes, convocadas pela ordem crescente de suas classificações, até que uma delas demonstre interesse, desde que nas mesmas condições propostas pela primeira colocada e atendidas as especificações e prazos exigidos neste Edital.

14.4- A contratação resultante do objeto deste Edital reger-se-á ainda pelas normas fixadas pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei n. 8.078, de 11.09.90.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO

25.1- Fica eleito o foro da Comarca de Boa Viagem, Estado do Ceará, para dirimir toda e qualquer controvérsia oriunda do presente edital, que não possa ser resolvida pela via administrativa, renunciando-se, desde já, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.



E por estarem assim justos e compromissados, foi lavrado este instrumento que após lido conferido e achado conforme, vai assinado pelas partes.

Boa Viagem/CE, ___ de _____ de 20__.

Nome do(a) Ordenador(a) de Despesas
Ordenador(a) de Despesas da Secretaria de Saúde
ÓRGÃO GERENCIADOR

Nome do Representante Legal
NOME DA EMPRESA

Nome do Representante Legal
NOME DA EMPRESA

Nome do Representante Legal
NOME DA EMPRESA

Nome do Representante Legal
NOME DA EMPRESA


TESTEMUNHAS:


1. _____

Nome:
CPF:

2. _____

Nome:
CPF:

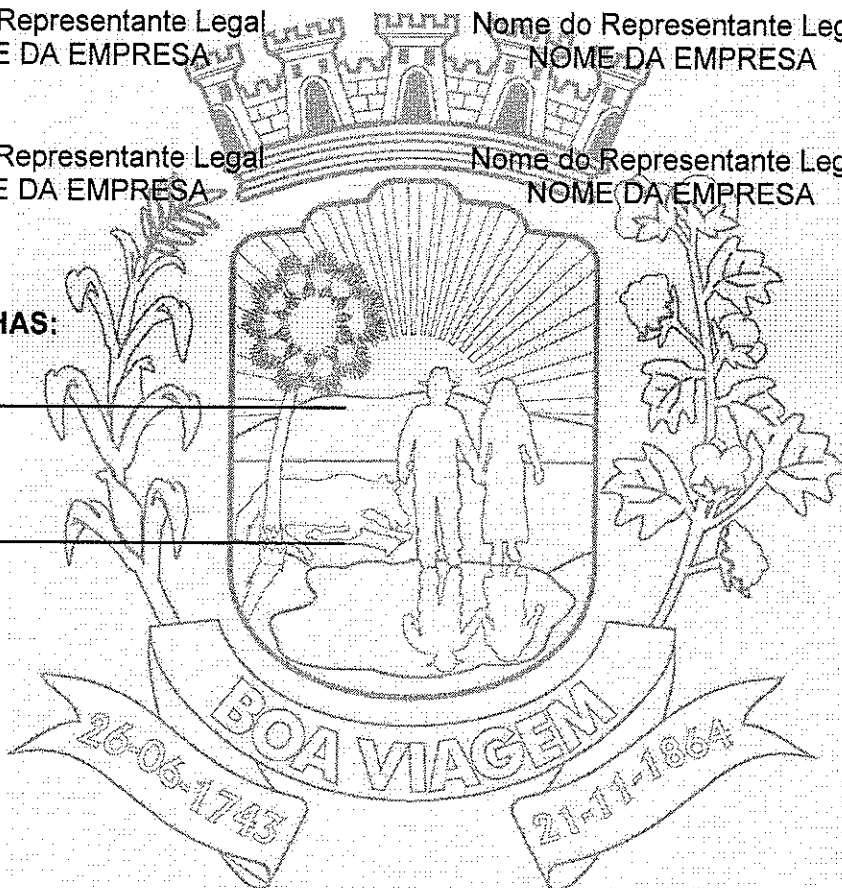





ANEXO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2022.03.03.001.

Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços nº 2022.03.03.001, celebrada entre o Município de Boa Viagem, através da Secretaria de Saúde e a(s) empresa(s) abaixo indicadas, cujos preços estão a seguir registrados, demonstrado nas planilhas seguintes, conforme resultado extraído dos mapas de lances ofertados no Pregão Eletrônico nº 2022.03.03.001.

EMPRESA : _____
 ENDEREÇO : _____
 CNPJ Nº : _____

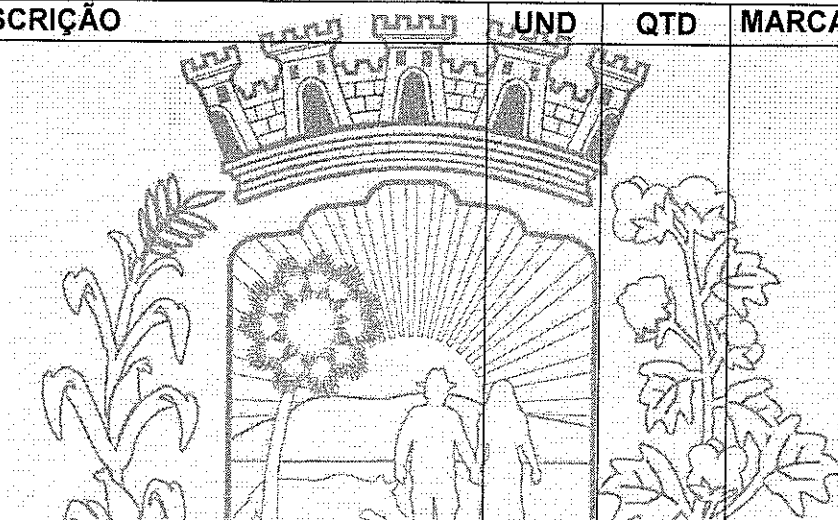ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	MARCA	UNIT	TOTAL
						



ANEXO V - MINUTA DE CONTRATO

**CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI O
MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM, ATRAVÉS DO(A)
SECRETARIA _____ DE
COM
_____, PARA O FIM QUE A
SEGUIR SE DECLARA.**

O Município de Boa Viagem, pessoa jurídica de direito público interno, através do(a) Secretaria de _____, em sua sede no(a) Praça Monsenhor José Cândido, 100 - Centro Boa Viagem/CE, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º _____/_____, neste ato representado(a) pelo(a) Ordenador de Despesas da _____ Sr(a) _____, doravante denominado de **CONTRATANTE**, no final assinado(a) e do outro lado, com endereço na _____, inscrita no CNPJ/MF n.º _____, representada pelo(a) Sr(a) _____, inscrita no CPF/MF n.º _____, no final assinado(a), doravante denominada de **CONTRATADO(A)**, de acordo com a Pregão Eletrônico n.º 2022.03.03.001, Processo n.º 2022.03.03.001, em conformidade com o que preceitua a Lei Federal n.º 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, a Lei Federal n.º 10.520/02, de 17 de julho de 2002, sujeitando-se os contratantes as suas normas e as cláusulas e condições a seguir ajustadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1- O presente Contrato tem por objeto a Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de equipamentos e materiais médico hospitalares, odontológicos, leites e suplementos alimentares para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Boa Viagem/CE, conforme especificações em anexo parte integrante deste processo.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO FUNDAMENTO LEGAL

2.1- Processo de Licitação, na modalidade Pregão, em conformidade com a Lei Federal N.º 8.666/93 - Lei das Licitações Públicas c/c os termos da **Lei Federal n.º 10.520, de 17/07/2002 - Lei que Regulamenta o Pregão**, devidamente homologado pelo(a) Ordenador(a) de Despesas da Secretaria de _____ do Município de Boa Viagem/CE.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO

3.1- A CONTRATANTE pagará ao(à) CONTRATADO(A) pela execução do objeto deste contrato o valor global de R\$ _____ (_____), conforme planilha em anexo.

CLAÚSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

4.1- O(A) CONTRATANTE se obriga a proporcionar à CONTRATADA todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores;

PREFEITURA DE BOA VIAGEM

CNPJ N.º 07.963.515/0001-36 | CGF N.º 06.920.307-5

Praça Monsenhor José Cândido, 100 | Centro | Boa Viagem/CE | CEP 63.870-000

Tel.: 88 3427-7001 | E-mail: pmbv_oficial@boaviagem.ce.gov.br | Site: www.boaviagem.ce.gov.br



- 4.2- Fiscalizar e acompanhar a entrega do objeto contratual;
- 4.3- Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a entrega do objeto contratual, diligenciando nos casos que exigirem providências corretivas;
- 4.4- Providenciar os pagamentos à CONTRATADA, à vista das Notas Fiscais /Faturas devidamente atestadas pela _____, conforme o acordado.

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

5.1-Entregar o objeto do Contrato, no almoxarifado no município de Boa Viagem, de conformidade com as condições e prazos estabelecidos no Edital, no Termo Contratual e na proposta vencedora do certame, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do recebimento da Ordem de Compra, a partir de sua assinatura até 31 de dezembro do ano corrente à sua assinatura, podendo ser prorrogado nos termos da Lei nº 8.666/93 e suas alterações;

5.2-Manter durante toda a duração do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de HABILITAÇÃO e qualificação exigidas na licitação;

5.3-Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pela CONTRATANTE, arcando com eventuais prejuízos causados a CONTRATANTE e/ou terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidade cometida por seus empregados e/ou prepostos envolvidos na entrega do objeto contratual;

5.4-Os pedidos de prorrogação de prazo de entrega serão dirigidos à Comissão de Licitação, até 05(cinco) dias corridos, antes da data do término do prazo de entrega, explicitadas as razões e devidamente fundamentadas;

5.5-Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que notificado o prazo de 48 (quarenta e oito) horas e aceito pela _____, não serão considerados como inadimplemento contratual.

CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO DO CONTRATO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO


6.1-O contrato terá o prazo de vigência a partir de sua assinatura até 31 de dezembro do ano corrente à sua assinatura, podendo ser prorrogado nos casos e formas previstos na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

6.2-O objeto da licitação será recebido pelo liquidante da _____, mediante a apresentação dos respectivos recibos (em duas vias), fatura e nota fiscal, nos termos do Edital.

CLAÚSULA SÉTIMA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1- Os pagamentos serão realizados mediante a apresentação da Nota Fiscal e Fatura correspondente. A Fatura deverá ser aprovada, obrigatoriamente, pela _____ do Município de Boa Viagem, que atestará a entrega do objeto licitado;

7.2- Caso a fatura seja aprovada pela _____, o pagamento será efetuado até o 30º (trigésimo) dia após o protocolo da Fatura pela Contratada



CLAÚSULA OITAVA - DA FONTE DE RECURSOS

8.1- As despesas decorrentes da contratação correrão por conta, dos recursos oriundos do Tesouro Municipal, estadual e federal, sob a dotação orçamentária nº _____, elemento de despesa _____.

CLAÚSULA NONA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇO

9.1-Os preços são reajustáveis;

CLAÚSULA DÉCIMA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

10.1-A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões no quantitativo do objeto contratado, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, conforme o disposto no § 1º, art. 65, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

CLAÚSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - DAS SANÇÕES

11.1-O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas previstas no edital e no termo de contrato e das demais cominações legais.

11.2- A Contratada ficará ainda, sujeita às seguintes penalidades, em caso de inexecução total ou parcial do contrato, erro de execução, execução imperfeita, mora de execução, inadimplemento contratual ou não veracidade das informações prestadas, garantida a prévia defesa:

I - Advertência, sanção de que trata o inciso I do art. 87, da Lei n.º 8.666/93, poderá ser aplicada nos seguintes casos:

- a) descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas na licitação;
- b) outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento das atividades do(a) CONTRATANTE, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave.

II - Multas (que poderão ser recolhidas em qualquer agência integrante da Rede Arrecadadora de Receitas Municipais, por meio de Documento de Arrecadação Municipal – DAM, a ser preenchido de acordo com instruções fornecidas pela Contratante):

- a) de **1,0%** (um por cento) sobre o valor total do contrato, por dia de atraso na entrega dos produtos ou indisponibilidade dos mesmos, limitada a 10% (dez por cento) do mesmo valor;
- b) de **2,0%** (dois por cento) sobre o valor total do contrato, por infração a qualquer cláusula ou condição contratual, não especificada nas demais alíneas deste inciso, aplicada em dobro na reincidência;
- c) de **5,0%** (cinco por cento) do valor total do contrato, pela recusa em substituir qualquer produto rejeitado, caracterizando-se a recusa, caso a substituição não se efetive nos 05



(cinco) dias que se seguirem à data da comunicação formal da rejeição;

III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município de Boa Viagem, por prazo não superior a 05 (cinco) anos;

IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade, depois do ressarcimento à Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.7

11.3 - No processo de aplicação de penalidades é assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, garantida nos prazos de 05 (cinco) dias úteis para as sanções previstas nos incisos I, II e III do item 11.2 supra e 10 (dez) dias corridos para a sanção prevista no inciso IV do mesmo item.

11.4 - O valor da multa aplicada deverá ser recolhido ao Tesouro Municipal no prazo de 05 (cinco) dias a contar da notificação ou decisão do recurso. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado do pagamento a que a Contratada fizer jus. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da Contratada, o valor devido será cobrado administrativamente ou inscrito como Dívida Ativa do Município e cobrado mediante processo de execução fiscal, com os encargos correspondentes.

11.5- As sanções previstas nos incisos III e IV do item 11.2 supra, poderão ser aplicadas às empresas que, em razão do contrato objeto desta licitação:

- a) praticarem atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;
- b) demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração Pública, em virtude de atos ilícitos praticados;
- c) sofrerem condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos.

11.6- As sanções previstas nos incisos I, III e IV do item 11.2 supra poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II do mesmo item, facultada a defesa prévia do interessado no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

11.7- A licitante adjudicatária que se recusar, injustificadamente, em firmar o Contrato dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis a contar da notificação que lhe será encaminhada, estará sujeita à multa de 5,0% (cinco por cento) do valor total adjudicado, sem prejuízo das demais penalidades cabíveis, por caracterizar descumprimento total da obrigação assumida.

11.8- As sanções previstas no item 11.7 supra não se aplicam às demais licitantes que, apesar de não vencedoras, venham a ser convocadas para celebrarem o Termo de Contrato, de acordo com este edital, e no prazo de 48 (quarenta e oito) horas comunicarem seu desinteresse.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - DA RESCISÃO

12.1-A rescisão contratual poderá ser:

- a) Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93;



b) Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja conveniência da Administração;

12.2-Em caso de rescisão prevista nos incisos XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93, sem que haja culpa do CONTRATADO, será esta ressarcida dos prejuízos regulamentares comprovados, quando os houver sofrido;

12.3-A rescisão contratual de que trata o inciso I do art. 78 acarreta as consequências previstas no art. 80, incisos I a IV, ambos da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

13.1- Declaram as partes que este Contrato corresponde à manifestação final, completa e exclusiva, do acordo entre elas celebrado;

13.2- Obrigação da Contratada de manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA - DO FORO

14.1-Fica eleito o foro da Comarca de Boa Viagem, para conhecimento das questões relacionadas com o presente Contrato que não forem resolvidos pelos meios administrativos.

E, assim, inteiramente acordados nas cláusulas e condições retro-estipuladas, as partes contratantes assinam o presente instrumento, em duas vias, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos.

Boa Viagem/CE, de de

Ordenador(a) de Despesa
Cargo do Ordenador(a) de Despesa
CONTRATANTE

Nome do Representante da Empresa
Nome da Empresa
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1. _____
Nome:
CPF:

2. _____
Nome:
CPF: